

RAZPISNA DOKUMENTACIJA

PREDMET JAVNEGA NAROČILA: BLAGO

MEDICINSKI POTROŠNI MATERIAL 2

Javno naročilo je bilo objavljeno na portalu javnih naročil, datum objave 26.10.2015, številka objave JN7526/2015 in v Uradnem listu EU, datum objave 30.10.2015, številka objave 2015/S 211-382425.

Vsebina:

- A) Povabilo k predložitvi ponudbe
- B) Navodila ponudnikom za izdelavo ponudbe
- C) Navodila za delo s programom "Javna naročila UKC"
- D) Obrazec za ocenjevanje ponudnika
- OBR-1 Izjava o sprejemanju zahtev razpisne dokumentacije
- OBR-2 Izjava o nezavajajočih podatkih
- OBR-3 Obrazec ponudbe
- OBR-4 Specifikacija zahtev naročnika
- OBR-4.1 Tehnični opisi razpisanih vrst blaga iz specifikacije zahtev naročnika
- OBR-5 Specifikacija ponudbe s cenami
- OBR-6 Vzorec okvirnega sporazuma
- OBR-7 Vzorec kupoprodajne pogodbe
- OBR-8 Izjava o izpolnjevanju pogojev
- OBR-8.1 Izjava o izpolnjevanju pogojev podizvajalcev
- OBR-9 Soglasje ponudnika za pridobitev osebnih podatkov
- OBR-10 Garancija za resnost ponudbe

Matična številka: 5054150
ID Davčna številka: SI56644817
Podračun enotnega zakladniškega računa – EZR: 01100-6030278185

Kontakt:
Telefon: 00386 (0)2 321 25 66
Faks: 00386 (0)2 331 15 33
e-pošta: dejan.simic@ukc-mb.si
Internetni naslov: <http://www.ukc-mb.si>

Številka povabila: V1-88/16-DeS
Datum: 26.10.2015

A) POVABILO K PREDLOŽITVI PONUDBE

Vabimo vas, da predložite ponudbo za javno naročilo za dobavo blaga:

MEDICINSKI POTROŠNI MATERIAL 2

Ponudbo je treba izdelati v skladu z navodili te razpisne dokumentacije.

Javno naročilo je bilo objavljeno na portalu javnih naročil, datum objave 26.10.2015, številka objave JN7526/2015 in v Uradnem listu EU, datum objave 30.10.2015, številka objave 2015/S 211-382425.

Direktor UKC:
prim. doc. dr. Gregor PIVEC, dr. med.

Javno naročilo:
MEDICINSKI POTROŠNI MATERIAL 2

B) NAVODILA PONUDNIKOM ZA IZDELAVO PONUDBE

KAZALO

I	SPLOŠNO	3
1.1	Vrsta postopka	3
1.2	Predmet javnega naročila	3
1.3	Trajanje javnega naročila	4
1.4	Razpisane količine	4
1.5	Sodelovanje	4
1.5.1	Tuji ponudniki	4
1.5.2	Podizvajalci	4
1.5.3	Skupna ponudba	5
1.6	Pojasnila razpisne dokumentacije	6
1.7	Dopolnitev in spremembe razpisne dokumentacije	6
1.8	Sestanek s potencialnimi ponudniki	7
II	PONUDBA	7
2.1	Jezik	7
2.2	Popolnost ponudbe	7
2.3	Izpolnitev razpisne dokumentacije oziroma celotne ponudbe	9
2.4	Listine v ponudbi	9
2.5	Predložitev ponudbe	9
2.6	Rok za predložitev ponudbe	10
2.7	Dopolnitev, sprememba in umik ponudbe	10
2.8	Popravljanje napak	10
2.9	Dopustne dopolnitve ponudbe	10
2.10	Navedba zavajajočih podatkov	11
2.11	Stroški priprave ponudbe, prospektnega materiala in vzorcev	11
2.12	Obvezni pogoji	11
2.13	Izločitev ponudb	13
2.14	Ponudbena vrednost	13
2.15	Merilo	14
2.16	Izbira ponudnika	14
2.17	FINANČNA ZAVAROVANJA	15
2.17.1	Vrste finančnih zavarovanj	15
2.17.2	Unovčenje garancije za resnost ponudbe	15
2.17.3	Vračilo garancije za resnost ponudbe	15
2.18	Veljavnost ponudbe	16
2.19	Variantne ponudbe	16
III	JAVNO ODPIRANJE PONUDB	16
IV	SKLENITEV OKVIRNEGA SPORAZUMA IN KUPOPRODAJNE POGODBE	16
4.1	Sklenitev okvirnega sporazuma	16
4.2	Predvidena obdobja	16
4.3	Sklenitev kupoprodajne pogodbe	17
4.4	Sklenitev dogovora	17
V	KONČNA DOLOČILA	17
VI	PRAVNO VARSTVO	18

I SPLOŠNO

1.1 Vrsta postopka

Naročnik bo v skladu s 25. členom Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 12/13, 19/14 in 90/14 - ZDU-11; v nadaljevanju: ZJN-2) izvedel odprti postopek z namenom sklenitve okvirnega sporazuma v skladu s šestim odstavkom 32. člena ZJN-2.

Naročnik bo odpiral konkurenco med sklenitelji okvirnega sporazuma vsakih dvanajst mesecev, in sicer predvidoma v obdobjih, kot je opredeljeno v točki 4.2 teh navodil. Naročilo za posamezno obdobje bo oddano, na podlagi merila iz točke 2.15 teh navodil, tistemu ponudniku (enemu ponudniku), ki bo za posamezne razpisane skupine blaga med sklenitelji okvirnega sporazuma najugodnejši. Naročnik bo z najugodnejšim ponudnikom v posameznem obdobju sklenil kupoprodajno pogodbo.

V primeru, da bo naročnik za posamezno skupino blaga prejel samo eno popolno ponudbo, bo naročnik s tem ponudnikom sklenil okvirni sporazum za obdobje od 01.01.2016 do 31.12.2018. Naročnik v tem primeru ne bo odpiral konkurence.

Naročnik je iz centralne cenovne evidence (CCE), kjer so zajete nabavne cene potrošnih materialov sedmih slovenskih bolnišnic, in sicer: Univerzitetni klinični center Maribor, Splošna bolnišnica Celje, Splošna bolnišnica Jesenice, Univerzitetni klinični center Ljubljana, Splošna bolnišnica Nova Gorica, Splošna bolnišnica Ptuj in Splošna bolnišnica Slovenj Gradec pridobil podatek, kateri od navedenih zavodov nabavlja posamezne artikole najugodnejše. Cene iz CCE so pridobljene na podlagi Zakona o dostopu do informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 51/06 – uradno prečiščeno besedilo, 117/06 – ZdavP-2 in 23/14).

Vsled predhodno navedenega je naročnik za vsako razpisano skupino blaga določil maksimalno dopustno vrednost (cena je z DDV). Naročnik je maksimalno dopustno vrednost za posamezno skupino blaga za leto 2016 določil tako, da je upošteval najnižjo ceno posamezne vrste blaga iz CCE.

Za blago, za katerega nabavne cene v CCE niso zajete, je naročnik kot MDC določil svojo zadnjo nabavno ceno.

V fazi analize in ocenjevanja ponudb bo naročnik pri ugotavljanju sprejemljivosti ponudb za posamezno skupino blaga vse tiste ponudbe, ki bodo presegale maksimalno dopustno vrednost za posamezno skupino blaga, ocenil kot nesprejemljive.

Če bodo pri posamezni skupini blaga vse ponudbe presegale maksimalno dopustno vrednost, bo naročnik postopek oddaje javnega naročila zaključil, ter v tem delu predvidoma izvedel postopek s pogajanji. V primeru, da bo naročnik tudi v ponovljenem postopku prejel ponudbe, ki bodo presegale maksimalne dopustne vrednosti za posamezno skupino blaga, bo naročnik razpisane količine zmanjšal do nivoja razpoložljivih sredstev in posledično zmanjšal program svojih storitev.

1.2 Predmet javnega naročila

Predmet javnega naročila je dobava medicinskega potrošnega materiala. Okvirne količine in vrste blaga so podane v specifikaciji zahtev naročnika.

1.3 Trajanje javnega naročila

Naročnik bo oddal predmetno javno naročilo za obdobje treh (3) let, in sicer od 01.01.2016 do 31.12.2018. Znotraj tega obdobja bo naročnik med sklenitlji okvirnega sporazuma odpiral konkurenco vsakih dvanajst mesecev, in sicer predvidoma v obdobjih, opredeljenih v točki 4.2 teh navodil.

V primeru, da naročnik ne bi imel zagotovljenih finančnih sredstev za preostala obdobja oz. bi imel potrjen nižji znesek, izbrani ponudnik ne more terjati od naročnika izpolnitev obveznosti v višini iz njegove ponudbe.

1.4 Razpisane količine

V »Specifikaciji zahtev naročnika« in v »Specifikaciji ponudbe s cenami« so podane okvirne količine.

V kolikor obdobje ne bo trajalo predviden čas, bo naročnik količine, navedene v specifikaciji ponudbe s cenami, ustrezno – linearno – zmanjšal.

1.5 Sodelovanje

Kot ponudnik lahko v tem postopku javnega naročanja konkurira vsaka pravna ali fizična oseba, ki je registrirana za dejavnost, ki je predmet tega javnega naročila in ima za opravljanje te dejavnosti vsa predpisana dovoljenja za izvedbo tega javnega naročila.

1.5.1 Tuji ponudniki

Ponudniki s sedežem v tuji državi morajo izpolnjevati enake pogoje kot ponudniki s sedežem v Republiki Sloveniji.

Če država, v kateri ima ponudnik svoj sedež, ne izdaja dokumentov iz točke 2.12 Navodil ponudnikom za izdelavo ponudbe, lahko ponudnik da zapriseženo izjavo prič ali zapriseženo izjavo zakonitega zastopnika ponudnika. Ta izjava mora biti podana pred pravosodnim ali upravnim organom, notarjem ali pristojnim organom poklicnih ali gospodarskih subjektov v državi, v kateri ima ponudnik svoj sedež.

Tuji ponudniki morajo v RS imenovati **pooblaščenca za vročitve v RS**. Dokazilo o imenovanju pooblaščenca za vročitve, morajo tuji ponudniki predložiti k ponudbi.

1.5.2 Podizvajalci

Ponudnik lahko v celoti sam izvede predmetno javno naročilo ali pa ga izvede s podizvajalci. V primeru izvedbe predmetnega naročila s podizvajalci, je treba v ponudbi navesti:

- vse podizvajalce (naziv, polni naslov, matična številka, davčna številka in transakcijski račun),
- predmet, količino, vrednost, kraj in rok izvedbe teh del,
- vsako vrsto del, ki jih bo izvedel in vsako vrsto blaga, ki ga bo dobavil podizvajalec.

Podatki o podizvajalcih iz prejšnjega odstavka te točke so sestavina okvirnega sporazuma oz./in kupoprodajne pogodbe o izvedbi javnega naročila.

Ponudnik je seznanjen, da so neposredna plačila podizvajalcem s strani naročnika obvezna v skladu z osmim odstavkom 71. člena ZJN-2. Za izvedbo neposrednih plačil mora ponudnik svojemu računu obvezno priložiti račune podizvajalcev, ki jih je predhodno potrdil.

Ponudnik mora v ponudbi predložiti **pooblastilo** s katerim pooblašča naročnika, da na podlagi potrjenega računa, neposredno plačuje podizvajalcem, ter **soglasje podizvajalca**, na podlagi katerega naročnik namesto glavnega izvajalca (ponudnika) poravna podizvajalčevo terjatev do glavnega izvajalca (ponudnika).

Kadar namerava ponudnik izvesti javno naročilo s podizvajalci, mora pogoj iz tretje točke točke 2.12 teh navodil izpolnjevati tudi podizvajalec, ki sodeluje pri izvedbi javnega naročila.

Navedeni obvezni pogoj, ki ga ZJN-2 predvideva za podizvajalce, velja tudi za vse podizvajalce, ki jih ponudnik uvede v posel po sklenitvi okvirnega sporazuma in/oz. kupoprodajne pogodbe z naročnikom (podizvajalci, ki niso bili navedeni v ponudbi). Naročnik ima pravico, da za vse nove podizvajalce, ki niso bili navedeni v ponudbi (zamenjava podizvajalcev ali uvedba novih podizvajalcev v delo), kasneje preveri izpolnjevanje navedenega pogoja. V kolikor podizvajalci pogoja ne izpolnjujejo, jih ponudnik (izvajalec) ne sme angažirati. V kolikor to vseeno naredi, je to razlog za krivdno razvezo okvirnega sporazuma in/oz. kupoprodajne pogodbe.

Ponudnik, ki izvaja javno naročilo z enim ali več podizvajalci, mora imeti ob sklenitvi okvirnega sporazuma in/oz. kupoprodajne pogodbe z naročnikom ali med njegovim izvajanjem, sklenjene pogodbe s podizvajalci. Podizvajalec mora naročniku posredovati kopijo pogodbe, ki jo je sklenil s svojim naročnikom (ponudnikom), v petih dneh od sklenitve te pogodbe.

Če se po sklenitvi okvirnega sporazuma in/oz. kupoprodajne pogodbe o izvedbi javnega naročila z izbranim ponudnikom zamenja podizvajalec ali če ponudnik sklene pogodbo z novim podizvajalcem mora izbrani ponudnik v 5 dneh po spremembi naročniku predložiti:

- svojo izjavo, da je poravnal vse nesporne obveznosti prvotnemu podizvajalcu, če je bil le ta zamenjan,
- pooblastilo za plačilo opravljenih in prevzetih del oziroma dobav neposredno novemu podizvajalcu in
- soglasje novega podizvajalca k neposrednemu plačilu.

Za podizvajalca ne šteje gospodarski subjekt, ki glede na razmerje z izbranim ponudnikom izpolnjuje kriterije za povezano družbo po zakonu, ki ureja gospodarske družbe. V tem primeru:

- se za potrebe neposrednih plačil za podizvajalca šteje subjekt, ki je pravna ali fizična oseba in za osebo, povezano z izbranim ponudnikom, dejansko dobavlja blago ali izvaja storitev oziroma gradnjo, ki je neposredno povezana s predmetom javnega naročila;
- mora izbrani ponudnik s podizvajalcem iz prejšnje alineje skleniti pogodbo, s katero uredi obveznosti in pravice povezane s predmetom javnega naročanja.

1.5.3 Skupna ponudba

Skupine gospodarskih subjektov lahko predložijo skupno ponudbo. V primeru skupne ponudbe bo naročnik od izbrane skupine zahteval predložitev ustreznega akta o skupni izvedbi naročila iz katerega bo nedvoumno razvidno naslednje:

- imenovanje poslovodečega pri izvedbi javnega naročila;
- pooblastilo poslovodečemu za podpis ponudbe, pogodbe in okvirnega sporazuma,
- izjava, da so seznanjeni z Navodili ponudnikom za izdelavo ponudbe in z razpisnimi pogoji ter merilom za dodelitev javnega naročila in da z njimi v celoti soglašajo,
- izjava, da so seznanjeni s plačilnimi pogoji iz razpisne dokumentacije in navedba, da odgovarjajo naročniku neomejeno solidarno.

V primeru, da skupina ponudnikov predloži skupno ponudbo, mora vsak partner iz skupine ponudnikov **posamično** izpolnjevati naslednje pogoje iz točke 2.12 teh navodil:

- osnovne pogoje (osnovna sposobnost ponudnikov),
- sposobnost za opravljanje poklicne dejavnosti,
- ekonomske in finančne pogoje (ekonomska in finančna sposobnost).

Tehnične in/ali kadrovske pogoje iz točke 2.12 teh navodil pa lahko partnerji iz skupine ponudnikov izpolnjujejo **skupno**.

Finančna zavarovanja lahko predloži samo eden izmed partnerjev, ki nastopajo v skupni ponudbi, morajo pa biti izpolnjene vse zahteve (višina, veljavnost, itd.), ki so določene v teh navodilih.

1.6 Pojasnila razpisne dokumentacije

Pojasnila o vsebini razpisne dokumentacije se lahko zahtevajo le v pisni obliki preko portala javnih naročil¹. Pojasnila bodo posredovana preko portala javnih naročil.

Če katerikoli ponudnik zahteva v zvezi z razpisno dokumentacijo oziroma v zvezi s pripravo ponudbe kakršno koli dodatno pojasnilo, mora zanj zaprositi **pravočasno oz. najkasneje do 26.11.2015 do 11:00 ure**. Naročnik bo dodatno pojasnilo v zvezi z razpisno dokumentacijo posredoval najpozneje šest dni pred iztekom roka za oddajo ponudb, pod pogojem, da je zahteva bila posredovana pravočasno.

1.7 Dopolnitev in spremembe razpisne dokumentacije

Naročnik si pridržuje pravico spremeniti ali dopolniti razpisno dokumentacijo. V primeru, da bo naročnik v roku za predložitev ponudb spremenil ali dopolnil razpisno dokumentacijo, bo to objavil na svoji spletni strani (<http://www.ukc-mb.si>) in na portalu javnih naročil.

Po poteku roka za prejem ponudb naročnik ne bo spreminjal ali dopolnjeval razpisne dokumentacije.

V primeru, da bo naročnik spremenil ali dopolnil razpisno dokumentacijo 6 ali manj dni pred rokom, določenim za predložitev ponudb, bo, glede na obseg in vsebino sprememb, ustrezno podaljšal rok za predložitev ponudb.

S premaknitvijo roka za prejem ponudb se pravice in obveznosti naročnika in ponudnika vežejo na nove roke, ki posledično izhajajo iz podaljšanega roka za oddajo ponudb.

¹ <http://www.enarocanje.si>

1.8 Sestanek s potencialnimi ponudniki

Sestanka s potencialnimi ponudniki ne bo.

II PONUDBA

2.1 Jezik

Ponudnik mora izdelati ponudbo v slovenskem jeziku, razen katalogov, prospektnega materiala, tehnične dokumentacije itd., ki so lahko predloženi v angleškem jeziku.

2.2 Popolnost ponudbe

Popolna bo tista ponudba, ki bo pravočasna, formalno popolna, sprejemljiva, pravilna in primerna. Ponudnik mora v ponudbi predložiti:

1. izjavo ponudnika o sprejemanju zahtev razpisne dokumentacije (OBR-1);
2. izjavo ponudnika, da so v ponudbi navedeni podatki resnični (nezavajajoči) (OBR-2);
3. izpolnjen obrazec ponudbe (OBR-3);
4. izpolnjen obrazec »Specifikacija zahtev naročnika« (OBR-4) (izpolnjen za skupine blaga za katere oddaja ponudbo; natisnjen izvod in prenosni medij – zgoščenka*);
5. izpolnjen obrazec »Specifikacija ponudbe s cenami« (OBR-5) (izpolnjen za skupine blaga za katere oddaja ponudbo; natisnjen izvod in prenosni medij – zgoščenka*);
6. vzorec okvirnega sporazuma (OBR-6);
7. vzorec kupoprodajne pogodbe (OBR-7);
8. izjavo o izpolnjevanju pogojev, opredeljenih v točki 2.12 teh navodil (OBR-8);
9. izjava o izpolnjevanju pogojev podizvajalcev (OBR-8.1) (velja v primeru, da bo ponudnik pri izvedbi naročila sodeloval s podizvajalci; glej točko 1.5.2 teh navodil);
10. soglasje ponudnika za pridobitev osebnih podatkov (OBR-9);
11. garancijo za resnost ponudbe (OBR-10 oz. dokument, izdan s strani banke/zavarovalnice) ali dokazilo o vplačilu finančnega depozita;
12. BON-2 izdan s strani AJPes-a;
13. seznam podizvajalcev z navedbo podatkov iz točke 1.5.2 teh navodil (velja v primeru, da bo ponudnik pri izvedbi naročila sodeloval s podizvajalci; glej točko 1.5.2 teh navodil);
14. pooblastilo, s katerim ponudnik pooblašča naročnika za neposredna plačila podizvajalcem (velja v primeru, da bo ponudnik pri izvedbi naročila sodeloval s podizvajalci; glej točko 1.5.2 teh navodil);
15. soglasje podizvajalca, na podlagi katerega naročnik namesto glavnega izvajalca poravnava podizvajalčevo terjatev do glavnega izvajalca (velja v primeru, da bo ponudnik pri izvedbi naročila sodeloval s podizvajalci; glej točko 1.5.2 teh navodil);
16. akt o skupni izvedbi (velja v primeru, da bo ponudnik pri izvedbi naročila nastopal s skupno ponudbo; glej točko 1.5.3 teh navodil);
17. dokazilo o imenovanju pooblaščenca za vročitve v RS (velja za tuje ponudnike; glej točko 1.5.1 teh navodil);
18. lastna izjava o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika, vključno z udeležbo tihih družbenikov in o gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so povezane družbe s ponudnikom (glej opombo k 18. točki);
19. dokumente in dokazila zahtevana v tehničnih opisih razpisanih vrst blaga iz specifikacije zahtev naročnika (OBR 4.1).

*Ponudniki lahko predložijo samo en prenosni medij, na katerem sta izpolnjeni »Specifikacija zahtev naročnika« in »Specifikacija ponudbe s cenami«.

***Opomba k 18. točki:**

Naročnik v skladu s šestim odstavkom 14. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/2011; ZintPK-UPB2) od ponudnikov zahteva, da v ponudbi predložijo lastno izjavo oziroma naslednje podatke:

- **o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika, vključno z udeležbo tihih družbenikov,**
- **o gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so povezane družbe s ponudnikom.**

Za fizične osebe mora izjava vsebovati ime in priimek, naslov prebivališča in delež lastništva.

Če ponudnik predloži lažno izjavo oziroma da neresnične podatke o navedenih dejstvih ima to v skladu z določbo šestega odstavka 14. člena ZintPK za posledico ničnost pogodbe.

V kolikor obstaja javna evidenca za katerega izmed podatkov, ki jih naročnik zahteva v razpisni dokumentaciji, se lahko ponudnik v ponudbi sklicuje na javno evidenco.

V primeru odstopanja natisnjenega izvoda od prenosnega medija, bo naročnik upošteval natisnjen izvod.

V »Specifikaciji zahtev naročnika« je naročnik za vrste blaga, ki so predmet tega naročila, navedel blagovno znamko oz. kataloško številko izključno z namenom, da se določi zahtevana raven kakovosti razpisanih vrst blaga. Ponudniki morajo ponuditi enako ali višjo raven kakovosti oz. ustrezno strokovno paralelo.

Naročnik bo kot nepopolno zavrnil tudi tisto ponudbo, ki ne bo ustrezala vsem tehničnim zahtevam za ponujene vrste blaga iz predmetnega naročila. Tehnične zahteve so opredeljene v »Specifikaciji zahtev naročnika« in v prilogi 4.1 »Tehnični opisi razpisanih vrst blaga iz specifikacije zahtev naročnika«.

Naročnik bo iz postopka izločil ponudnika, če bo na dan, ko se izteče rok za oddajo ponudb, uvrščen v evidenco ponudnikov z negativnimi referencami.

Ponudnik naj pri pripravi ponudbe upošteva navedeni vrstni red.

Obrazci iz točk 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 in 11 te točke so sestavni del te razpisne dokumentacije. Vse obrazce je treba izpolniti, podpisati in žigosati (z enotnim pečatom).

Ponudnik mora ponuditi 100% razpisanih vrst blaga in količin iz skupine oz. skupin, ki jih ponuja!

V primeru, da bo naročnik od ponudnika zahteval predložitev prospektnega materiala, katalogov ali/in vzorce, je treba le-te dostaviti v roku 7 dni, sicer bo takšen ponudnik izločen iz nadaljnjega postopka oddaje javnega naročila. Prospektni material, katalogi bodo lahko predloženi v slovenskem ali angleškem jeziku.

2.3 Izpolnitev razpisne dokumentacije oziroma celotne ponudbe

Celotna dokumentacija za ponudbo mora biti natipkana ali napisana s čitljivo pisavo, ki se je ne da izbrisati brez posebnih sredstev za brisanje. Vsebine obrazcev, izjav, listin in dokumentov ni dovoljeno spreminjati.

Ponudnik mora podpisati, žigosati (z enotnim pečatom) in parafirati vsako stran vzorca okvirnega sporazuma in/oz. kupoprodajne pogodbe. Prav tako je treba izpolniti, podpisati in žigosati (z enotnim pečatom) vse ostale obrazce iz točke 2.2 teh navodil.

V specifikaciji zahtev naročnika mora ponudnik obvezno vpisati pri vsaki vrsti blaga naslednje podatke:

- pakiranje,
- proizvajalca,
- zaščiteno ime,
- kataloško številko ali kakšno drugo oznako za identifikacijo blaga.

V primeru, da naročnik na enem identu razpisuje več dimenzij, mora ponudnik priložiti specifikacijo s kataloškiimi številkami za vse ponujene dimenzije oz. v primeru razpisanih kompletov specifikacijo s cenami in kataloškiimi številkami za vse posamezne elemente kompleta. Način vpisa je opisan v dodatnih navodilih za delo s programom »Javna naročila UKC«.

V specifikacijo ponudbe s cenami je treba vpisati:

- ceno brez DDV,
- davčno stopnjo (%).

V primeru, da ponudnik ponuja drugačno pakiranje od razpisanega, mora ponujeno ceno preračunati na razpisano pakiranje.

Vsi listi ponudbe morajo biti zvezani s pečatno vrvico in zapečateni s pečatnim voskom ali unikatno nalepko ponudnika tako, da jih ni mogoče neopazno odvzeti.

2.4 Listine v ponudbi

Vsi dokumenti morajo biti predloženi v originalu ali fotokopiji, ki jih ni treba notarsko overiti. Izjema od tega so garancija banke/zavarovalnice za resnost ponudbe in listine tujih ponudnikov (glej točko 1.5.1 teh navodil), ki morajo biti predložene izključno v originalu.

Starost dokumentov ne sme presegati roka, kot ga določajo posamezne določbe te razpisne dokumentacije. V tistih primerih, kjer starost dokumentov ni določena, morajo le-ti izkazovati pravno relevantno stanje ponudnika na dan, določen za predložitev ponudb.

2.5 Predložitev ponudbe

Ponudniki morajo naročniku posredovati ponudbe v zaprti ovojnici tako, da je na odpiranju ponudb možno preveriti, da je zaprta tako, kot je bila predana. Na ovojnici morajo biti vidne naslednje oznake:

1. **naročnikov naslov:**
UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER MARIBOR
Oddelek za javna naročila
Ljubljanska ulica 5

2000 Maribor

2. oznake:

- »NE ODPIRAJ – PONUDBA«;
- številka objave javnega naročila na portalu javnih naročil in v Uradnem listu EU;
- predmet naročila: »MEDICINSKI POTROŠNI MATERIAL 2«.

3. ponudnikov naslov (na hrbtni strani)

Ponudniki lahko ponudbe v pisni obliki dostavijo naročniku po pošti (na naslov iz prve točke te točke) ali jo predajo osebno v pisarni »Oddelka za javna naročila« (stavba številka 9).

2.6 Rok za predložitev ponudbe

Ponudbe je treba predložiti do **09.12.2015 do 11:00 ure** na naslov naročnika iz prve točke točke 2.5. Pravočasna je tista ponudba, ki je predložena naročniku do roka iz predhodnega stavka.

Če bo ponudba predložena po poteku datuma in ure, navedene v objavi in razpisni dokumentaciji, se bo štelo, da je bila predložena prepozno. Tako ponudbo bo naročnik po končanem postopku odpiranja ponudb neodprto vrnil ponudniku z navedbo, da je prepozna.

Ponudba, ki je oddana na pošto priporočeno pred rokom za predložitev ponudb, a prispe k naročniku po poteku roka, ni pravočasna ponudba in bo po javnem odpiranju ponudb neodprta vrnjena ponudniku z navedbo, da je prepozna.

2.7 Dopolnitev, sprememba in umik ponudbe

Ponudnik lahko dopolni, spremeni ali umakne ponudbo pred rokom za predložitev ponudbe.

Ovojnico, ki se nanaša na eno od navedenih dejanj iz prejšnjega odstavka, mora ponudnik opremiti z oznakami: "SPREMEMBA PONUDBE" ali "DOPOLNITEV PONUDBE" ali "UMIK PONUDBE", navesti predmet naročila, številko objave javnega naročila, naročnikov naslov in na hrbtni strani ponudnikov naslov.

Po roku za predložitev ponudb navedena dejanja niso možna.

2.8 Popravljanje napak

Popravljenе napake morajo biti označene z inicialkami osebe ali oseb, ki podpisujejo ponudbo.

2.9 Dopustne dopolnitve ponudbe

Če je ponudba formalno nepopolna, bo naročnik zahteval, da jo ponudnik v ustreznem roku dopolni ali spremeni v delu, v katerem ni popolna. Če ponudnik v roku, ki ga določi naročnik, ponudbe ustrezno ne dopolni oziroma spremeni, mora naročnik tako ponudbo izločiti.

Ponudnik ne sme dopolnjevati ali spreminjati:

- svoje cene na enoto, vrednosti postavke, skupne vrednosti ponudbe in ponudbe v okviru meril,
- tistega dela ponudbe, ki se veže na tehnične specifikacije predmeta javnega naročila v smislu zamenjave prvotno ponujenega predmeta naročanja z novim predmetom naročanja,
- tistih elementov ponudbe, ki vplivajo ali bi lahko vplivali na drugačno razvrstitev njegove ponudbe glede na preostale ponudbe, ki jih je naročnik prejel v postopku javnega naročanja.

Ne glede na prejšnji odstavek sme izključno naročnik ob pisnem soglasju ponudnika popraviti očitne računske napake, ki jih odkrije pri pregledu in ocenjevanju ponudb. Pri tem se količina in cena na enoto ne smeta spreminjati.

2.10 Navedba zavajajočih podatkov

Kadarkoli se pri naročniku pojavi utemeljen sum, da je posamezni ponudnik, ne glede na razvrstitev njegove ponudbe, predložil neresnične izjave ali dokazila, mora naročnik Državni revizijski komisiji za revizijo postopkov oddaje javnih naročil podati predlog za uvedbo postopka o prekršku iz 4. točke prvega odstavka 109.a člena ZJN-2.

2.11 Stroški priprave ponudbe, prospektnega materiala in vzorcev

Ponudniki nosijo sami vse stroške povezane s pripravo in predložitvijo ponudbe, vključno s stroški prospektnega materiala, katalogov, če jih naročnik zahteva, in vzorcev, če jih želi naročnik preizkusiti.

V primeru, da bo naročnik od ponudnika zahteval predložitev prospektnega materiala, katalogov ali vzorcev, je treba te predložiti najkasneje v roku 7 dni. V kolikor ponudnik zahtevanega prospektnega materiala, katalogov ali/in vzorcev ne dostavi oz. jih ne dostavi v zahtevanem roku, bo naročnik takega ponudnika izločil iz nadaljnjega postopka oddaje javnega naročila.

2.12 Obvezni pogoji

Ponudnik mora v času oddaje ponudbe izpolnjevati pogoje, določene v tej točki, da lahko sodeluje v postopku. Naročnik bo ugotavljal sposobnost ponudnikov na osnovi izpolnjevanja naslednjih pogojev:

Naročnik bo iz postopka javnega naročanja izločil:

1. ponudnika, če je bil le-ta ali njegov zakoniti zastopnik, v kolikor gre za pravno osebo, pravnomočno obsojen zaradi naslednjih kaznivih dejanj, ki so opredeljena v Kazenskem zakoniku (Uradni list RS, št. 50/12 – uradno prečiščeno besedilo; v nadaljnjem besedilu: KZ-1):
 - sprejemanje podkupnine pri volitvah (157. člen KZ-1),
 - goljufija (211. člen KZ-1),
 - protipravno omejevanje konkurence (225. člen KZ-1),
 - povzročitev stečaja z goljufijo ali nevestnim poslovanjem (226. člen KZ-1),
 - oškodovanje upnikov (227. člen KZ-1),
 - poslovna goljufija (228. člen KZ-1),

- goljufija na škodo Evropske unije (229. člen KZ-1),
 - preslepitev pri pridobitvi in uporabi posojila ali ugodnosti (230. člen KZ-1),
 - preslepitev pri poslovanju z vrednostnimi papirji (231. člen KZ-1),
 - preslepitev kupcev (232. člen KZ-1),
 - neupravičena uporaba tuje oznake ali modela (233. člen KZ-1),
 - neupravičena uporaba tujega izuma ali topografije (234. člen KZ-1),
 - ponaređitev ali uničenje poslovnih listin (235. člen KZ-1),
 - izdaja in neupravičena pridobitev poslovne skrivnosti (236. člen KZ-1),
 - zloraba informacijskega sistema (237. člen KZ-1),
 - zloraba notranje informacije (238. člen KZ-1),
 - zloraba trga finančnih instrumentov (239. člen KZ-1),
 - zloraba položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti (240. člen KZ-1),
 - nedovoljeno sprejemanje daril (241. člen KZ-1),
 - nedovoljeno dajanje daril (242. člen KZ-1),
 - ponarejanje denarja (243. člen KZ-1),
 - ponarejanje in uporaba ponarejenih vrednotnic ali vrednostnih papirjev (244. Člen KZ- 1),
 - pranje denarja (245. člen KZ-1),
 - zloraba negotovinskega plačilnega sredstva (246. člen KZ-1),
 - uporaba ponarejenega negotovinskega plačilnega sredstva (247. člen KZ-1),
 - izdelava, pridobitev in odtujitev pripomočkov za ponarejanje (248. člen KZ-1),
 - davčna zatajitev (249. člen KZ-1),
 - tihotapstvo (250. člen KZ-1),
 - izdaja tajnih podatkov (260. člen KZ-1),
 - jemanje podkupnine (261. člen KZ-1),
 - dajanje podkupnine (262. člen KZ-1),
 - sprejemanje koristi za nezakonito posredovanje (263. člen KZ-1),
 - dajanje daril za nezakonito posredovanje (264. člen KZ-1),
 - hudodelsko združevanje (294. člen KZ-1);
- Dokazilo: Izjava ponudnika (OBR-8);

2. ponudnika, če je le-ta na dan, ko poteče rok za oddajo ponudb, izločen iz postopkov oddaje javnih naročil zaradi uvrstitve v evidenco ponudnikov z negativnimi referencami iz 77.a člena ZJN-2, 81.a člena ZJNVETPS oziroma 73. člena ZJNPOV;
Dokazilo: Izjava ponudnika (OBR-8);
3. ponudnika, če ima na dan, ko je bila oddana ponudba, v skladu s predpisi države, v kateri ima sedež, ali predpisi države naročnika zapadle, neplačane obveznosti v zvezi s plačili prispevkov za socialno varnost ali v zvezi s plačili davkov v vrednosti 50 eurov ali več;
Dokazilo: Izjava ponudnika (OBR-8);
4. ponudnika, če je v postopku prisilne poravnave ali je bil zanj podan predlog za začetek postopka prisilne poravnave in sodišče o tem predlogu še ni odločilo;
Dokazilo: Izjava ponudnika (OBR-8);
5. ponudnika, če je v stečajnem postopku ali je bil zanj podan predlog za začetek stečajnega postopka in sodišče o tem predlogu še ni odločilo;
Dokazilo: Izjava ponudnika (OBR-8);
6. ponudnika, če je v postopku prisilnega prenehanja, je bil zanj podan predlog za začetek postopka prisilnega prenehanja in sodišče o tem predlogu še ni odločilo, z njegovimi posli iz drugih razlogov upravlja sodišče ali je opustil poslovno dejavnost ali je v katerem koli podobnem položaju;
Dokazilo: Izjava ponudnika (OBR-8);

Sposobnost za opravljanje poklicne dejavnosti:

7. da je registriran pri pristojnem sodišču ali drugemu organu;
Dokazilo: Izjava ponudnika (OBR-8);
8. da je vpisan na Seznam imetnikov dovoljenja za opravljanje dejavnosti prometa na debelo pri Javni agenciji RS za zdravila in medicinske pripomočke;
Dokazilo: Izjava ponudnika (OBR-8);

Ekonomska in finančna sposobnost:

9. da je število dni neporavnanih obveznosti v preteklih 6 mesecih vključno do dneva sestavitve obrazca iz točke B obrazca BON-2 enako 0;
Dokazilo: BON-2, ki ga izda AJPES;
Dokument ne sme biti starejši od 30 dni na dan določen za predložitev ponudbe.

Tehnična in/ali kadrovska sposobnost:

10. da zagotavlja 100% razpisanih vrst in količin blaga iz skupine za katere oddaja ponudbo;
Dokazilo: Izjava ponudnika (OBR-8);
11. da imajo vse ponujene vrste blaga CE oznako, ki jo bo ponudnik na zahtevo naročnika dokazal s predložitvijo ustreznih dokumentov;
Dokazilo: Izjava ponudnika (OBR-8).

Opomba:

- Kadar namerava ponudnik izvesti javno naročilo s podizvajalci, mora pogoji iz tretje točke izpolnjevati tudi podizvajalec, ki sodeluje pri izvedbi javnega naročila. Kot dokazilo za izpolnjevanje navedenih pogojev je potrebno v ponudbi predložiti Izjavo o izpolnjevanju pogojev podizvajalcev (OBR-8.1) za vsakega priglašene podizvajalca.

Obrazec za ocenjevanje ponudnika je priloga teh navodil.

2.13 Izločitev ponudb

Naročnik bo izločil:

- nepravočasne ponudbe (ponudbe, ki bodo vložene po roku za predložitev ponudb iz točke 2.6 teh navodil);
- ponudbe, ki ne bodo pravilno označene (ponudbe, ki ne bodo označene v skladu s točko 2.5 teh navodil);
- ponudbe, ki ne bodo izpolnjevale vseh zahtev iz točke 2.2 in 2.12 teh navodil;
- ponudnika, če bo na dan, ko se izteče rok za oddajo ponudb, uvrščen v evidenco ponudnikov z negativnimi referencami.

2.14 Ponudbena vrednost

Cene morajo biti podane v evrih (EUR).

Cena brez DDV mora vsebovati vse stroške (prevozne, špeditorske, carinske ter morebitne druge stroške), popuste in rabate. Posebej je treba izkazati stopnjo in znesek davka na dodano vrednost.

Navesti je treba tudi končno vrednost ponudbe, ki jo dobite tako, da cene pomnožite s količinami in tako dobljene vrednosti seštejete. Ponudbena vrednost mora vsebovati vse stroške in davek na dodano vrednost.

Cena na enoto mere mora biti fiksna v času trajanja pogodbe, sklenjene za posamezno obdobje iz točke 4.2 teh navodil.

V primeru, da bo naročnik za posamezno skupino blaga prejel samo eno popolno ponudbo, bo naročnik s tem ponudnikom sklenil okvirni sporazum za obdobje od 01.01.2016 do 31.12.2018. Naročnik v tem primeru ne bo odpiral konkurence. Po dvanajstih mesecih od dneva sklenitve okvirnega sporazuma je sprememba cene možna v skladu s 1. in 2. točko 6. člena Pravilnika o načinih valorizacije denarnih obveznosti, ki jih v večletnih pogodbah dogovarjajo pravne osebe javnega sektorja (Uradni list RS, št. 1/04) oz. po predpisu, ki ta pravilnik nadomešča. Stranki okvirnega sporazuma kot podlago za valorizacijo uporabita indeks cen življenjskih potrebščin.

Uskladitev cene bosta stranki sporazuma uredili z aneksom k okvirnemu sporazumu.

2.15 Merilo

Merilo, ki bo uporabljeno pri izbiri najugodnejšega ponudnika:

- **najnižja končna vrednost posamezne skupine blaga.**

Opomba:

V primeru, da bo več ponudnikov ponudilo enako vrednost za isto skupino blaga, bo naročnik za te skupine blaga opravil žrebanje – izvlačenje kroglic. Na žrebanju bodo lahko prisotni tisti ponudniki, ki so ponudili enake vrednosti. O datumu, uri in kraju žrebanja bo naročnik te ponudnike pisno obvestil. Žrebanje bo izvedel naročnik. Naročilo bo oddano tistemu ponudniku, ki bo izžreban prvi.

2.16 Izbira ponudnika

Izbran bo ponudnik, ki bo:

- predložil popolno ponudbo ter bo
- ponudil najnižjo končno vrednost posamezne skupine blaga.

Izbrani ponudnik mora naročniku na njegov poziv posredovati podatke o:

- svojih ustanoviteljih, družbenikih, vključno s tihimi družbeniki, delničarjih, komanditistih ali drugih lastnikov in podatke o lastniških deležih navedenih oseb;
- gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so z njim povezane družbe.

2.17 FINANČNA ZAVAROVANJA

2.17.1 Vrste finančnih zavarovanj

Ponudniki, čigar ponudbena vrednost je enaka ali višja od 134.000 EUR brez DDV morajo v ponudbi predložiti dokazilo o vplačilu finančnega depozita kot garancijo za resnost ponudbe v višini 4.000,00 EUR. Navedeni finančni depozit mora biti na podračunu naročnika številka: SI5601100-6030278185 odprt pri UJP Slovenska Bistrica, sklic št. SI00 1100-2011 z navedbo namena nakazila: finančni depozit – Medicinski potrošni material 2, v času do datuma podpisa okvirnega sporazuma in/oz. kupoprodajne pogodbe z najugodnejšim ponudnikom.

Ponudniki lahko kot garancijo za resnost ponudbe namesto finančnega depozita predložijo kavcijsko zavarovanje zavarovalnice oz. garancijo banke, veljavno do **09.07.2016**.

Opomba 1:

Izbrani ponudnik bo moral naročniku predložiti:

1. menično izjavo in lastno podpisano menico s pooblastilom za njeno izpolnitev v višini 5% od vrednosti okvirnega sporazuma oz. kupoprodajne pogodbe v primeru, da bo vrednost višja od 50.000,00 EUR brez DDV in nižja od 134.000,00 EUR brez DDV. Ponudnik mora zagotoviti, da bo ves čas trajanja okvirnega sporazuma oz. kupoprodajne pogodbe menica unovčljiva; oz.
2. garancijo (banke/zavarovalnice) za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 5% od vrednosti okvirnega sporazuma oz. kupoprodajne pogodbe v primeru, da bo vrednost enaka ali višja od 134.000,00 EUR brez DDV.

Veljavnost menice oz. garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti mora biti veljavna še najmanj 10 dni od veljavnosti okvirnega sporazuma in/oz. kupoprodajne pogodbe.

Opomba 2:

V primeru unovčitve menice oz. garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, bo moral ponudnik unovčeno menico oz. garancijo ustrezno nadomestiti z novo.

2.17.2 Unovčenje garancije za resnost ponudbe

Naročnik bo unovčil garancijo za resnost ponudbe oziroma zadržal finančni depozit:

- če ponudnik umakne ali spremeni ponudbo v času njene veljavnosti;
- če ponudnik v zahtevanem času ne podpiše okvirnega sporazuma in/oz. kupoprodajne pogodbe;
- če ponudnik v zahtevanem času ne predloži ali zavrne predložitev finančnih zavarovanj iz opombe 1 k točki 2.17.1 teh navodil.

2.17.3 Vračilo garancije za resnost ponudbe oziroma finančnega depozita

Naročnik bo vsem ponudnikom vrnil finančni depozit v višini 4.000,00 EUR po sklenitvi okvirnega sporazuma in/oz. kupoprodajne pogodbe z najugodnejšim ponudnikom. Finančni depozit se ne obrestuje in bo vrnjen ponudnikom na TRR, vpisan na obrazcu ponudbe (OBR-3).

Na pisno zahtevo neizbranega ponudnika, bo naročnik vrnil garancijo za resnost ponudbe, vendar šele po sklenitvi okvirnega sporazuma in/oz. kupoprodajne pogodbe z izbranim ponudnikom.

2.18 Veljavnost ponudbe

Ponudba mora veljati do **09.06.2016**.

V izjemnih okoliščinah lahko naročnik zahteva, da ponudniki podaljšajo čas veljavnosti ponudb za določeno dodatno obdobje. Zahteva in odgovori ponudnikov morajo biti podani v pisni obliki ali preko telefaksa. Ponudnik lahko zavrne zahtevo, ne da bi s tem zapadlo zavarovanje za resnost ponudbe. Od ponudnika, ki se z zahtevo strinja, ne bo zahtevano ali dovoljeno, da razen podaljšanja veljavnosti ponudbe in morebitnega zavarovanja resnosti ponudbe, kakorkoli drugače spreminja ponudbo.

2.19 Variantne ponudbe

Variantne ponudbe ne bodo upoštevane.

III JAVNO ODPIRANJE PONUDB

Javno odpiranje ponudb bo dne **09.12.2015 ob 13:00 uri v sejni sobi nabavne službe, stavba št. 3 (3. nadstropje)**.

V skladu z drugim odstavkom 22. člena ZJN-2 **so javni podatki** količina iz specifikacije, cena na enoto, vrednost posamezne postavke in skupna vrednost iz ponudbe.

Zapisnik o odpiranju ponudb bo naročnik poslal vsem ponudnikom, ki so oddali ponudbe, po pošti v roku treh delovnih dni po javnem odpiranju ponudb.

IV SKLENITEV OKVIRNEGA SPORAZUMA IN KUPOPRODAJNE POGODBE

4.1 Sklenitev okvirnega sporazuma

Naročnik bo s ponudniki, za katere bo ugotovil, da so njihove ponudbe popolne, sklenil okvirni sporazum v skladu z določbami vzorca okvirnega sporazuma iz točke 6 točke 2.2 teh navodil. Okvirni sporazum se sklene za obdobje od 01.01.2016 do 31.12.2018.

Okvirni sporazum je treba podpisati v roku desetih (10) dni od prejema naročnikovega poziva k podpisu okvirnega sporazuma, sicer bo naročnik unovčil garancijo za resnost ponudbe oziroma zadržal finančni depozit.

4.2 Predvidena obdobja

Naročnik bo odpiral konkurenco med sklenitelji okvirnega sporazuma predvidoma v naslednjih obdobjih:

- od 01.01.2016 do 31.12.2016 (prvo obdobje);

- od 01.01.2017 do 31.12.2017 (drugo obdobje);
- od 01.01.2018 do 31.12.2018 (tretje obdobje).

V posameznem obdobju bo naročnik med sklenitelji okvirnega sporazuma izbral najugodnejšega ponudnika za posamezne skupine blaga iz predmetnega naročila na podlagi merila iz točk 2.15 teh navodil.

V primeru, da bo naročnik za posamezno skupino blaga prejel samo eno popolno ponudbo, naročnik za to skupino blaga ne bo odpiral konkurenco. V takem primeru bo naročnik s tem ponudnikom sklenil okvirni sporazum za obdobje od 01.01.2016 do 31.12.2018.

4.3 Sklenitev kupoprodajne pogodbe

Naročnik bo z najugodnejšim ponudnikom, izbranim po merilu iz točke 2.15 teh navodil, sklenil kupoprodajno pogodbo po določilih vzorca kupoprodajne pogodbe iz 7. točke točke 2.2 navodil.

Ponudnik je dolžan podpisati kupoprodajno pogodbo in/oz. okvirni sporazum v roku 10 dni po prejemu kupoprodajne pogodbe in/oz. okvirnega sporazuma, sicer bo naročnik smatral, da z naročnikom posla ne želi skleniti, in bo naročnik unovčil garancijo za resnost ponudbe oziroma zadržal finančni depozit. Ponudnik mora v tem roku, če bo pogodbeni vrednost oz. vrednost okvirnega sporazuma višja kot je navedeno v opombi v točki 2.17.1, dostaviti naročniku menično izjavo z menico oz. garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 5% od vrednosti pogodbe oz. okvirnega sporazuma.

4.4 Sklenitev dogovora

Za primer naročnikove morebitne nezmožnosti poravnavanja svojih obveznosti v roku 30 dni in v želji po stabilizaciji poslovanja, bo naročnik ob sklenitvi okvirnega sporazuma oz./in pogodbe predlagal sklenitev **dogovora o načinu in teku zamudnih obresti**. Sklenitev tega dogovora ne bo vplivala na veljavnost okvirnega sporazuma in/oz. pogodbe.

Glede na dejstvo, da se naročnik nahaja v težki finančni situaciji, bo naročnik ponudnikom hkrati s podpisom okvirnega sporazuma in/oz. pogodbe poslal tudi dogovor o načinu in teku zamudnih obresti. Dogovor bo natančno definiralo položaj obeh pogodbenih strank v primeru, če naročnik svojih obveznosti do dobaviteljev ne bo mogel poravnati v roku 30 dni od dneva prejema računa.

V KONČNA DOLOČILA

Poleg določil iz teh navodil veljajo tudi določila iz okvirnega sporazuma, kupoprodajne pogodbe in celotne razpisne dokumentacije. V dvomu se presoja posamezna določila v skladu z zakonskimi členi ZJN-2 in Obligacijskega zakonika (Uradni list RS, št. 97/07).

VI PRAVNO VARSTVO

Pravno varstvo ponudnikov v postopku javnega naročanja je zagotovljeno v skladu z določbami Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/11, 60/11 - ZTP-D, 63/13, 90/14 - ZDU-1I in 95/14 ZIPRS1415-C), po postopku in na način kot ga določa zakon.

Zahteva za pravno varstvo v postopkih javnega naročanja se lahko vloži v vseh stopnjah postopka oddaje javnega naročila zoper ravnanje naročnika, ki pomeni kršitev predpisov, ki bistveno vpliva ali bi lahko bistveno vplivala na oddajo javnega naročila, razen če zakon, ki ureja oddajo javnih naročil, ali ZPVPJN ne določa drugače. Zahtevo za pravno varstvo lahko vloži aktivno legitimirana oseba, kot jo določa 14. člen ZPVPJN.

Zahtevek za revizijo mora vsebovati:

1. ime in naslov vlagatelja zahtevka (v nadaljnjem besedilu: vlagatelj) ter kontaktno osebo,
2. ime naročnika,
3. oznako javnega naročila,
4. predmet javnega naročila,
5. očitane kršitve,
6. dejstva in dokaze, s katerimi se kršitve dokazujejo,
7. pooblastilo za zastopanje v predrevizijskem in revizijskem postopku, če vlagatelj nastopa s pooblaščencom,
8. navedbo, ali gre v konkretnem postopku javnega naročila za sofinanciranje iz evropskih sredstev in iz katerega sklada.

Vlagatelj mora zahtevku za revizijo priložiti potrdilo o plačilu takse v višini 3.500,00 EUR.

Takso je potrebno vplačati na podračun, odprt pri Banki Slovenije za namen plačila takse za predrevizijski in revizijski postopek, številka 01100-1000358802 – izvrševanje proračuna RS. Pri tem mora vlagatelj na plačilnem nalogu vpisati naslednje podatke v predpolje in polje sklicevanja na številko odobritve: 11 16110-7111290-XXXXXXLL (oznaka X pomeni št. objave javnega naročila, oznaka L pa pomeni označbo leta. V kolikor je št. objave javnega naročila krajša od šestih znakov, se na manjkajoča mesta spredaj piše 0).

Zahtevek za revizijo se vloži pisno neposredno pri naročniku, po pošti priporočeno ali priporočeno s povratnico na naslov naročnika:

UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER MARIBOR

Oddelek za javna naročila

Ljubljanska ulica 5

2000 Maribor.

Ponudnik mora kopijo zahtevka za revizijo hkrati posredovati ministrstvu, pristojnemu za javna naročila (Ministrstvo RS za javno upravo).

Zahtevek za revizijo, ki se nanaša na vsebino objave, povabilo k oddaji ponudbe ali razpisno dokumentacijo, se, razen v primeru iz četrtega odstavka 25. člena ZPVPJN, vloži v osmih delovnih dneh od dneva:

- objave obvestila o javnem naročilu ali
- obvestila o dodatnih informacijah, informacijah o nedokončanem postopku ali popravku, če se s tem obvestilom spreminjajo ali dopolnjujejo zahteve ali merila za izbor najugodnejšega ponudnika iz razpisne dokumentacije ali predhodno objavljenega obvestila o naročilu, ali
- prejema povabila k oddaji ponudb.

Če naročnik ugotovi, da zahtevek za revizijo ni bil vložen pravočasno ali ga ni vložila aktivno legitimirana oseba iz 14. člena ZPVPJN, da vlagatelj v skladu z drugim odstavkom 15. člena ZPVPJN ni predložil potrdila o plačilu takse ali da ni bila plačana ustrezna taksa, ga najpozneje v treh delovnih dneh od prejema s sklepom zavrže.

C) NAVODILA ZA DELO S PROGRAMOM "JAVNA NAROČILA UKC MARIBOR"

I. POTEK NAMESTITVE PROGRAMA:

1. V okolju Okna 95/98, ME, XP, VISTA izberite ikono **START ! ZAŽENI !** vpišite **CD ENOTA:SETUP !** pritisnite **ENTER**.

Če uporabljate Windows z angleškimi ukazi pa izberite **START ! RUN !** vpišite **ENOTA:SETUP !** pritisnite **ENTER**.

2. Sledite navodilu za namestitev programa

(4x kliknite naprej in 1x končaj) Cilj namestitve lahko poljubno spreminjate.

3. Po uspešni namestitvi se bo prikazalo sporočilo z opozorilom, da je program uspešno nameščen

Zdaj so se na vašem računalniku ustvarile naslednje bližnjice v skupini **PROGRAMI**:

↵ **CD – prenos podatkov** (predpogoj za delo s programom za Javna naročila)

↵ **Javna naročila UKC MARIBOR** (glavni program za:

- vpis cen

- vpis podatkov o artiklu

↵ **Odstranitev programa** (briši program iz sistema)


4. Prenos podatkov na medij :

Kliknete ikono **START ! PROGRAMI ! UKC MARIBOR – Javna naročila za leto 2016 – ! CD – prenos podatkov ! enter !** zaprete okno "Kopiraj".

5. Sedaj ste opravili vse potrebne prenose za delo s programom Javna naročila (glej točko II).

6. Odstranitev programa (Slika 1)

Kliknete ikono **START ! PROGRAMI ! UKC MARIBOR – Javna naročila za leto 2016 - ! Odstranitev programa ! označite Automatic - finish.**



Slika 1: Odstranitev programa

Če uporabljate Windows 3.* se bo prikazala še ena ikona:

- **Uninstall naročila** (odstranitev programa)


Opozorilo:

Ta izbira bo izvedla odstranitev programa iz vašega računalnika. Ne uporabljajte je dokler ne zaključite vnosa podatkov in ne pošljete CD z vašimi podatki na naslov UKC Maribor. Odstranitev programa v okolju Okna izvedete tudi z ukazom "**Dodaj/Odstrani programe**".

II. DELO S PROGRAMOM "JAVNA NAROČILA UKC MARIBOR"

Program poženete s klikom na:

START ! PROGRAMI ! UKC MARIBOR – Javna naročila za leto 2016 - ! Javna naročila UKC MARIBOR.

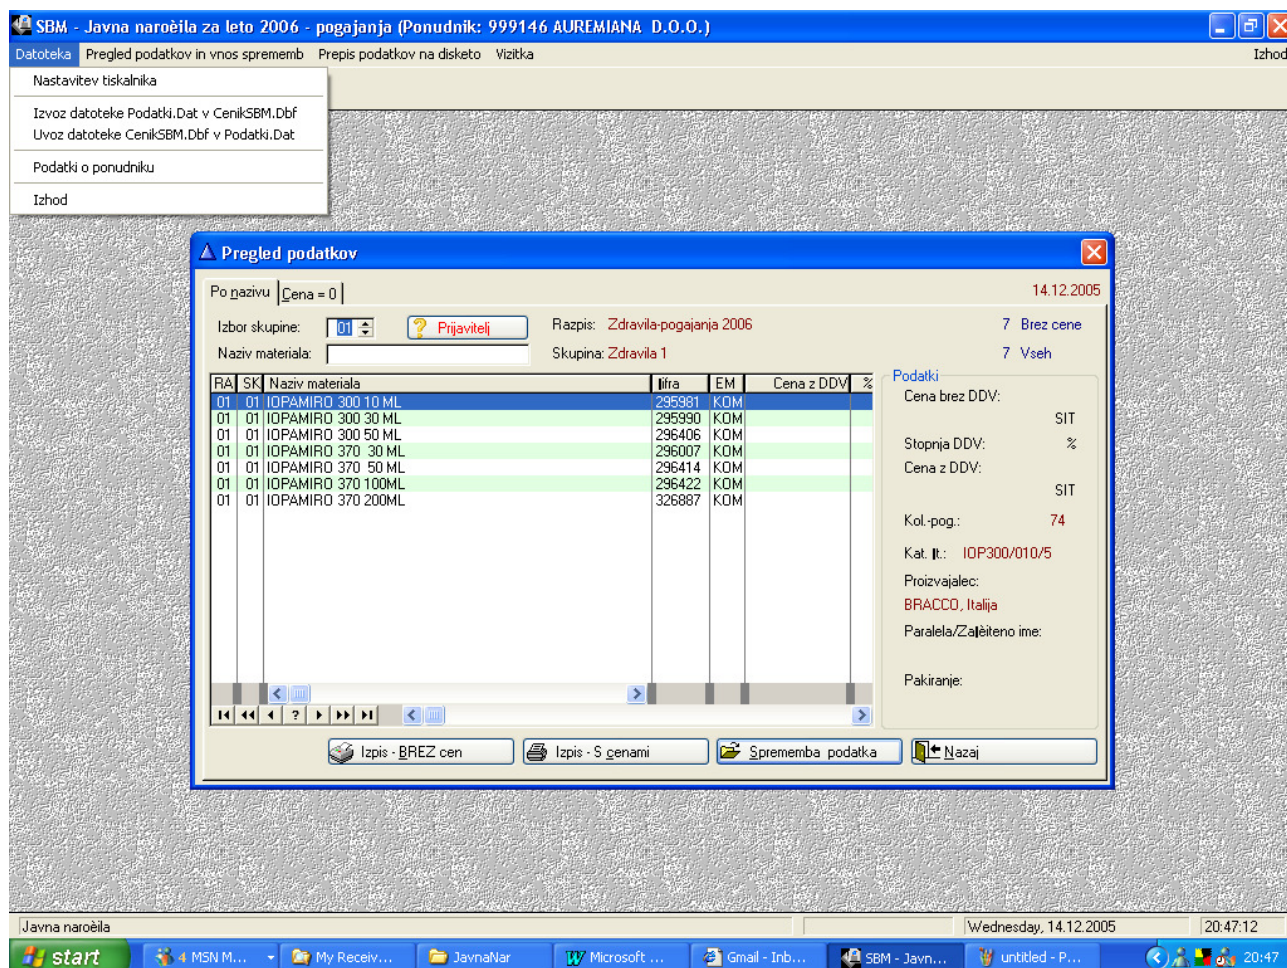

Slika 2: Okno "Javna naročila za leto 2016 "

Meniji:

a) Datoteka

- *Nastavitev tiskalnika* (izberemo privzeti tiskalnik)
- *Izvoz datoteke Podatki.Dat...* (prenos podatkov v DBF obliko)
- *Uvoz datoteke...* (uvoz podatkov iz DBF oblike)
- *Podatki o ponudniku* (vpišite vaše podatke; izpišejo se na specifikaciji)
- *Izhod* (zaključek dela s programom).

b) Pregled podatkov in vnos sprememb (glavni del programa)


- ↳ V tem meniju boste dobili možnost **pregleda vseh podatkov po skupinah**. Izdelek lahko iščete po skupini ali po nazivu. Možen je pogled samo za tiste izdelke, katerim niste vnesli ceno (izbor : **CENA = 0**).

✎ (Vnos in) spreminjanje podatkov (Slika 4)

Podatek vnesete in spremenite tako, da označite vrsto blaga in izberete "**Sprememba podatka**" ali pritisnete **Alt+S** ali pa pritisnete **"ENTER"**. Prikaže se vam novo okno, v katerega vpišete podatke. Za skupine je :

- **omogočen** vpis podatkov kot so: proizvajalec, zaščiteno ime, pakiranje, kat. št.,
- **omogočen** vpis podatkov kot so: pakiranje, cena brez DDV in stopnja DDV. V kolikor ne želite podati ponudbe za določen artikel, ne vpišite nobenega podatka v omenjena polja.

Če ste podatke pravilno vnesli in izbrali **"OK"**, se bodo vneseni ali spremenjeni podatki prikazali pri izbranem izdelku.



Slika 3: Vnos in spreminjanje podatkov

Izpisa specifikacije


Če označite polje **"Izpis BREZ CEN"** boste dobili izpis *"Specifikacija zahtev naročnika"*, in sicer s količinami do 31.12.2016.

Če označite polje **"Izpis S CENAMI"** boste dobili izpis *"Specifikacija ponudbe s cenami"*, in sicer s količinami do 31.12.2016.

Izpisi vam omogočajo izpis podatkov na tiskalnik, zaradi lažje kontrole. Pri izpisu lahko uporabljate različne možnosti (določene strani, predogled, povečava...). Če ste si premislili in ne želite izpisa, izberite **"Izhod"**.

Opomba: Potrebno je natisniti »IZPIS S CENAMI in IZPIS BREZ CEN«.

Predložiti je potrebno **izmenljiv medij z vsebino podatkov**.



Slika 4: Prikaz gumbov za izpis

- ✎ S klikom na gumb "**PONUĐNIK**" lahko vpišete vaše podatke. Podatke o ponudniku morate vpisati, saj sicer ne boste mogli izvesti izpisa.
- ✎ Po izbiri "**Nazaj**" se boste vrnili v osnovni meni.

c) **Prepis podatkov – 2 opciji**

▪ **na IZMENLJIV MEDIJ**


Ta izbira vam omogoča pripravo podatkov, na kateri bodo vaši podatki za vrste blaga oz. skupine, na katere se prijavljate in podatki o cenah z vključenimi popusti. Po končanem vnosu podatkov kopirate podatke na poljuben medij (CD ROM, USB KLJUČ ipd.)

▪ **na DISKETO**

Ta izbira vam omogoča pripravo diskete, na kateri bodo vaši podatki za vrste blaga oz. skupine, za katere oddajate ponudbo in podatki o cenah. Po končanem vnosu za vse skupine kreirate disketo.

Opozorilo:

Pred prenosom podatkov/cen na disketo morate biti v osnovnem meniju. Če boste poskušali kreirati disketo in boste še imeli odprto datoteko s podatki (na zaslonu se vidi okno s podatki), se bo sistem odzval z opozorilom, da je pristop do podatkov onemogočen. Zaradi velike količine podatkov pri nekaterih dobaviteljih je **OBVEZNO** vstaviti v disketni pogon **PRAZNO** disketo. Če na disketi ne bo dovolj prostora se ne bodo prenesli vsi podatki. Disketa ne sme biti zaščiten proti pisanju.

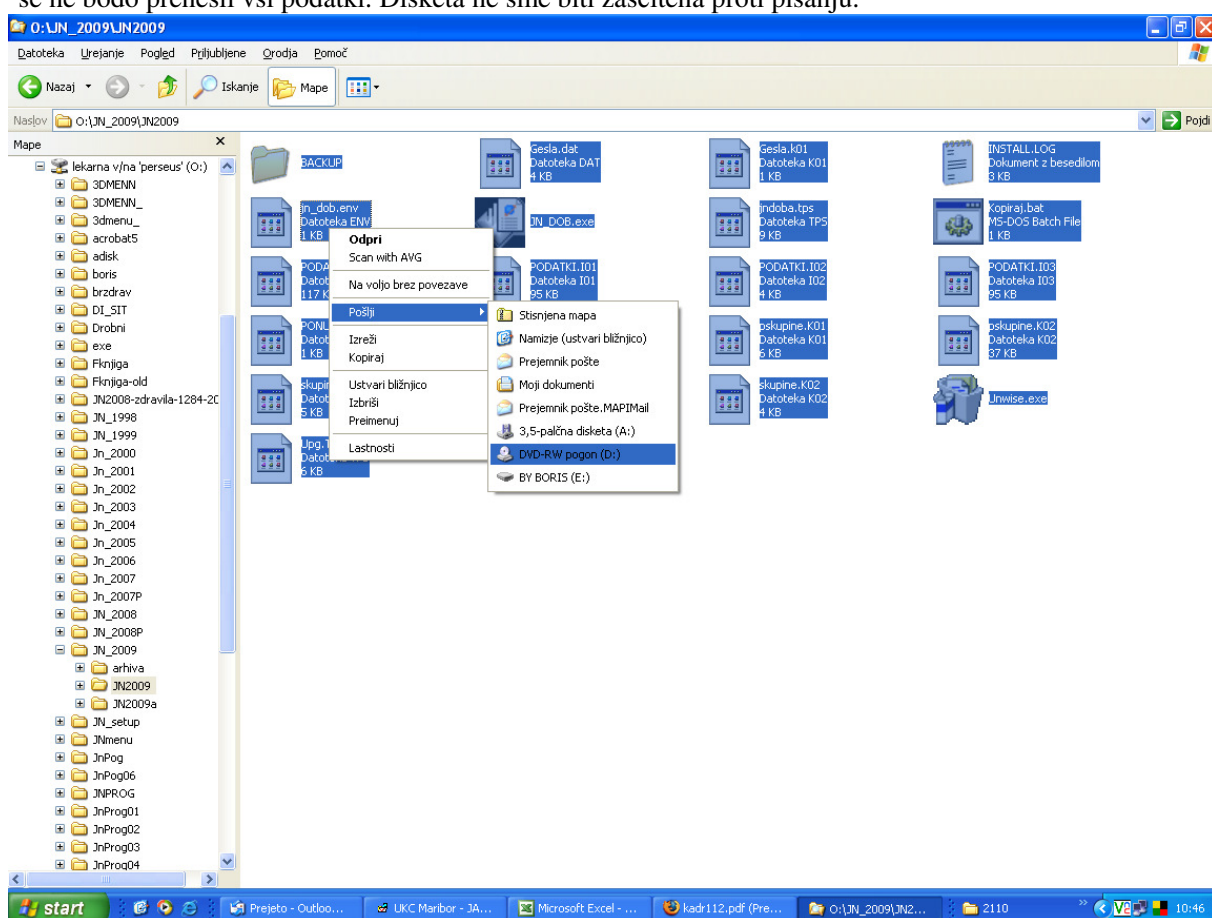

Slika 10: Prikaz gumbov za izpis

V ciljni mapi programa označite vse datoteke (ukaz CTRL+tipka A). Z desnim klikom »miške« se odpre meni v katerem kliknete : **POŠLJI ali SEND TO ! IZBERETE MEDIJ (npr. DVD-RW pogon, USB KLJUČ ipd !**


Opozorilo:

Po prenosu podatkov preverite ali so podatki na izbranem mediju. Izbrani medij priložite k ponudbi.

- e) **Vizitka.** Ta izbira vam bo dala na zaslonu podatke o kontaktni osebi iz UKC Maribor v primeru morebitnih nejasnosti v zvezi s samim programom. (Center za informatiko – Janez Krempel, tel.: 02/321-27-30; Oddelek za nabavo zdr. materiala in storitev Matej Španinger, tel.02/321-28-08). **ŽELIMO VAM USPEŠNO DELO!**

DODATNA NAVODILA ZA DELO S PROGRAMOM »JAVNA NAROČILA UKC 2016«

Ponudniki, ki oddajajo ponudbo za javno naročilo poleg osnovnih podatkov vpišejo še dodatne opise za ponujeno blago. Ob zagonu se pojavi dodatni meni »DODATNI PODATKI ZA VNOS«




Slika 1 »Dodatni podatki za vnos«

Izberemo ukaz :

»dodatni podatki za vnos«


Odpre se vam naslednje okno :

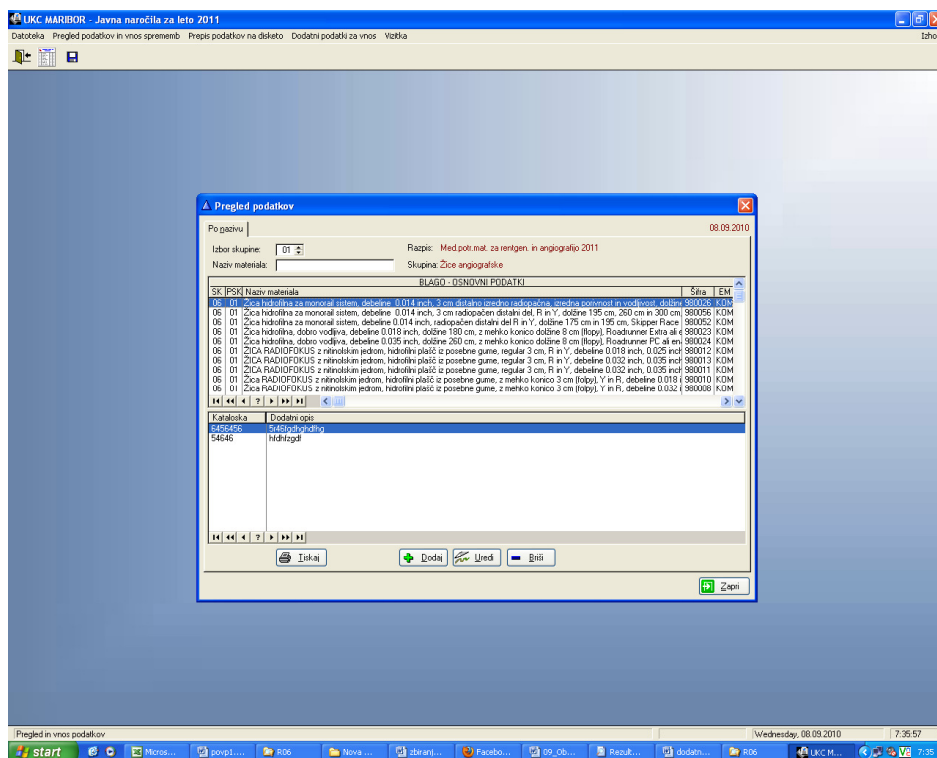

Slika 2 »Pregled podatkov«

Izberimo material za katerega bomo vnesli dodatne podatke in kliknemo na gumb »dodaj«.

Odpre se vam naslednje okno :



Slika 3 »Vnos podatkov«

Za vsak artikel posebej vnesemo kataložsko številko in v polje »dodatni opis« vpišemo podatke o proizvodu. (kat.štev., cene v primeru kompletov,...)

Po opravljenih vnosih lahko naredimo izpis s klikom na gumb »Izpis«. Po vpisu podatkov uvozimo podatke na ustrezen prenosni medij. Uvoz podatkov na ustrezen medij je podrobno opisan v navodilih za delo s programom »JAVNA NAROČILA UKC«.

D) OBRAZEC ZA OCENJEVANJE PONUDNIKA

PREDMET JAVNEGA NAROČILA:

MEDICINSKI POTROŠNI MATERIAL 2

Ponudnik: _____

Zap. št.	Dokumenti:	Priložen - ustreznost	
		DA	NE
1.	Izjava ponudnika o sprejemanju zahtev razpisne dokumentacije (OBR-1).	DA	NE
2.	Izjava ponudnika, da so v ponudbi navedeni podatki resnični (nezavajajoči) (OBR-2).	DA	NE
3.	Obrazec ponudbe (OBR-3).	DA	NE
4.	Izpolnjen obrazec »Specifikacija zahtev naročnika« (natisnjen izvod in prenosni medij – disketa ali zgoščenka) (OBR-4).	DA	NE
5.	Izpolnjen obrazec »Specifikacija ponudbe s cenami« (natisnjen izvod in prenosni medij – disketa ali zgoščenka) (OBR-5).	DA	NE
6.	Vzorec okvirnega sporazuma (OBR-6).	DA	NE
7.	Vzorec kupoprodajne pogodbe (OBR-7).	DA	NE
8.	Izjava o izpolnjevanju pogojev, opredeljenih v točki 2.12 navodil ponudnikom za izdelavo ponudbe (OBR-8).	DA	NE
9.	Izjava o izpolnjevanju pogojev podizvajalcev (OBR-8.1) (velja v primeru, da bo ponudnik pri izvedbi naročila sodeloval s podizvajalci; glej točko 1.5.2 navodil).	DA	NE
10.	Soglasje ponudnika za pridobitev osebnih podatkov (OBR-9).	DA	NE
11.	Garancija za resnost ponudbe (OBR-10 oz. dokument, izdan s strani banke/zavarovalnice) ali dokazilo o vplačilu finančnega depozita.	DA	NE
12.	BON-2.	DA	NE
13.	Seznam podizvajalcev z navedbo podatkov iz točke 1.5.2 teh navodil (velja v primeru, da bo ponudnik pri izvedbi naročila sodeloval s podizvajalci; glej točko 1.5.2 navodil).	DA	NE
14.	Pooblastilo, s katerim ponudnik pooblašča naročnika za neposredna plačila podizvajalcem (velja v primeru, da bo ponudnik pri izvedbi naročila sodeloval s podizvajalci; glej točko 1.5.2 navodil).	DA	NE
15.	Soglasje podizvajalca, na podlagi katerega naročnik namesto glavnega izvajalca poravnava podizvajalčevo terjatev do glavnega izvajalca (velja v primeru, da bo ponudnik pri izvedbi naročila sodeloval s podizvajalci; glej točko 1.5.2 navodil).	DA	NE

Zap. št.	Dokumenti:	Priložen - ustreznost	
16.	Akt o skupni izvedbi (velja v primeru, da bo ponudnik pri izvedbi naročila nastopal s skupno ponudbo; glej točko 1.5.3 navodil).	DA	NE
17.	Dokazilo o imenovanju pooblaščenca za vročitve v RS (velja za tuje ponudnike; glej točko 1.5.1 navodil).	DA	NE
18.	Lastna izjava o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika, vključno z udeležbo tihih družbenikov in o gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so povezane družbe s ponudnikom.	DA	NE
19.	Dokumenti in dokazila zahtevana v tehničnih opisih razpisanih vrst blaga iz specifikacije zahtev naročnika (OBR 4.1)	DA	NE

PONUODNIK

.....
.....
.....

IZJAVA O SPREJEMANJU ZAHTEV RAZPISNE DOKUMENTACIJE

Izjavljamo, da sprejemamo vse zahteve te razpisne dokumentacije.

Ta izjava je sestavni del ponudbe, s katero se prijavljamo za javno naročilo za dobavo medicinskega potrošnega materiala 2.

Javno naročilo je bilo objavljeno na portalu javnih naročil, datum objave 26.10.2015, številka objave JN7526/2015 in v Uradnem listu EU, datum objave 30.10.2015, številka objave 2015/S 211-382425.

Dne:

Žig in podpis ponudnika:

.....

PONUĐNIK

.....
.....
.....

IZJAVA O NEZAVAJAJOČIH PODATKIH

Izjavljamo, da so vsi podatki navedeni v naši ponudbi resnični in nezavajajoči.

Ta izjava je sestavni del ponudbe, s katero se prijavljamo za javno naročilo za dobavo medicinskega potrošnega materiala 2.

Javno naročilo je bilo objavljeno na portalu javnih naročil, datum objave 26.10.2015, številka objave JN7526/2015 in v Uradnem listu EU, datum objave 30.10.2015, številka objave 2015/S 211-382425.

Dne:

Žig in podpis ponudnika:

.....

PONUDBA

<p>1. Opis predmeta javnega naročila: MEDICINSKI POTROŠNI MATERIAL 2</p> <p>Javno naročilo je bilo objavljeno na portalu javnih naročil, datum objave 26.10.2015, številka objave JN7526/2015 in v Uradnem listu EU, datum objave 30.10.2015, številka objave 2015/S 211-382425.</p>
<p>2. Ponudbena vrednost v EUR z DDV:</p> <p>.....</p>
<p>3. Podatki o ponudniku</p> <p>3.1 Firma oz. ime:</p> <p>.....</p> <p>3.2 Naslov:</p> <p>.....</p> <p>3.3 Zakoniti zastopnik:</p> <p>.....</p> <p>3.4 Identifikacijska številka za DDV:</p> <p>.....</p> <p>3.5 Matična številka:</p> <p>.....</p> <p>3.6 Številka transakcijskega računa:</p> <p>.....</p> <p>3.7 Telefonska številka:</p> <p>.....</p> <p>3.8 Številka telefaksa:</p> <p>.....</p> <p>3.9 E-mail:</p> <p>.....</p> <p>3.10 Kontaktna oseba:</p> <p>.....</p> <p>3.11 Odgovorna oseba za podpis okvirnega sporazuma in kupoprodajne pogodbe:</p> <p>.....</p>

Dne:

Žig in podpis ponudnika:

.....

SPECIFIKACIJA ZAHTEV NAROČNIKA

Predmet JN: **88 Medicinski potrošni material 2, 2016-2018****01 ABDOMINAL.OP.Elektrode COOL TIP za "Valleylab"-100%sk.**

CPV: 33196000

Z.Š.	Naziv artikla	ident JN	EM	Razp. kol. za 12 mes	Pakir.	Proizvajalec	Zaščiteno ime	Kataloška številka
1	ELEKTRODA ZA 1 X UP , DOLŽ. 28 CM, ZA APARAT "LIGASURE"(COVIDIEN LS 3111 ALI ENAKOVREDNO).	661627	KOM	4				
2	ELEKTRODA ZA 1 X UP, DOLŽ. 23 CM, ZA APARAT" LIGASURE". (COVIDIEN LS 3091, ALI ENAKOVREDNO).	628000	KOM	10				
3	INSTRUMENT Z REZILOM ZA LAPAROSK. LEPLJENJE IN REZANJE ŽIL -5MM, DOLŽ. 37 CM , 1 X UP, ,ZA APARAT"LIGASURE"(COVIDIEN LS-1500 ALI ENAKOVREDNO).	661635	KOM	17				
4	INSTRUMENT Z REZILOM ZA LAPAROSK. LEPLJENJE IN REZANJE ŽIL-10MM, DOLŽINA 37 CM, 1 X UP, ZA APARAT" LIGASURE" (COVIDIEN LS-1037 ALI ENAKOVREDNO).	661643	KOM	2				
5	INSTRUMENT ZA LEPLJENJE IN REZANJE ŽIL- ZA ODPRT SISTEM OP, ZA 1X UP, DOLŽINA 20 CM, ZA APARAT "LIGASURE" (COVIDIEN LS 1020 ALI ENAKOVREDNO).	661929	KOM	8				
6	NEGATIVNA ELEKTRODA S KABLOM ZA APARAT COOL-TIP. (COVIDIEN DGP-HP, ALI ENAKOVREDNO).	626813	KOM	8				
7	RADIOFREKVENČNA ELEKTRODA , DOLŽINA 25CM ,AKTIVNA DOLŽINA 3CM,ZA APARAT COOL-TIP.(COVIDIEN ACTC 2025 ALI ENAKOVREDNO).	611476	KOM	2				
8	RADIOFREKVENČNA ELEKTRODA ,DOLŽINA 15CM,AKTIVNA DOLŽINA 3CM,ZA APARAT COOL-TIP.(COVIDIEN LF4318 ALI ENAKOVREDNO).	611441	KOM	29				
9	RADIOFREKVENČNA ELEKTRODA RF COOL KIT, 1SC=3 SETI (COVIDIEN SWTC25303 ALI ENAKOVREDNO).	710067	SC	6				
10	RADIOFREKVENČNA ELEKTRODA, DOLŽINA 20CM,AKTIVNA DOLŽINA 3CM ZA APARAT COOL TIP.(COVIDIEN ACT-2030 ALI ENAKOVREDNO).	611468	KOM	4				

ŽIG IN PODPIS:

SPECIFIKACIJA ZAHTEV NAROČNIKA

Predmet JN: **88 Medicinski potrošni material 2, 2016-2018**
02 ABDOMINAL.OP.Dreni abdominalni-silikonski-100% sk.

CPV: 33196000

Z.Š.	Naziv artikla	ident JN	EM	Razp. kol. za 12 mes	Pakir.	Proizvajalec	Zaščiteno ime	Kataloška številka
1	DREN ABDOMINALNI CH15,DOLŽINA 50 CM,PERFORACIJE 90 MM-5 STRANSKIH ODPRTIN+CENTRALNA ,MATERIAL- SILIKON,STERILEN	402290	KOM	325				
2	DREN ABDOMINALNI CH18 ,DOLŽINA 50 CM,PERFORACIJE 90 CM -5 STRANSKIH ODPRTIN+CENTRALNA,MATERIAL- SILIKON,STERILEN	382698	KOM	60				
3	DREN ABDOMINALNI CH20,DOLŽINA 50 CM,PERFORACIJE 90 MM-5 STRANSKIH ODPRTIN+CENTRALNA,MATERIAL-SILIKON,STERILEN	383678	KOM	101				
4	DREN ABDOMINALNI CH21-22/50CM,SILIKONSKI,STERILEN	388033	KOM	122				
5	DREN ABDOMINALNI CH24 ,DOLŽINA 50 CM,PERFORACIJE 90 MM-5 STRANSKIH ODPRTIN+CENTRALNA, MATERIAL-SILIKON,STERILEN	383686	KOM	1.115				
6	DREN ABDOMINALNI CH26,DOLŽINA 50CM, PERFORACIJE 90 MM-5 STRANSKIH ODPRTIN+CENTRALNA, MATERIAL- SILIKON,STERILEN	408719	KOM	60				
7	DREN ABDOMINALNI CH30,DOLŽINA 50 CM,PERFORACIJE 90 MM-5 STRANSKIH ODPRTIN+CENTRALNA,MATERIAL- SILIKON,STERILEN	387894	KOM	20				

ŽIG IN PODPIS:

SPECIFIKACIJA ZAHTEV NAROČNIKA

Predmet JN: **88 Medicinski potrošni material 2, 2016-2018**
03 ABDOMINAL.ODD.Vrečke in podloge za stomo-100% sk.

CPV: 33196000

Z.Š.	Naziv artikla	ident JN	EM	Razp. kol. za 12 mes	Pakir.	Proizvajalec	Zaščiteno ime	Kataloška številka
1	PODLOGA HIDROKOLOIDNA, DVOPLASTNA KOŽNA,OVALNE OBLIKE, Z RELIEFNIM VZORCEM, Z UŠESOM ZA ODSTRANJEVANJE,MOČNO LEPILO, BREZ KONVEKSITETE, VEL. 60MM, IZREZ 10-55MM(COLOPLAST SENSURA 10035 ALI ENAKOVREDNO	432075	KOM	244				
2	PODLOGA HIDROKOLOIDNA, KOŽNA, VEL.50MM,OVALNE OBLIKE,Z RELIEFNIM VZORCEM, Z UŠESOM ZA ODSTRANJEVANJE (COLOPLAST SENSURA 10021 ALI ENAKOVREDNO)	411833	KOM	37				
3	PODLOGA HIDROKOLOIDNA, KOŽNA, ZA STOMO,VEL.70-80MM,OKROGLE OBLIKE, OBROČ,KI SE LAHKO PRIDRŽI ZA NEBOLEČE NAMEŠČANJE VREČKE (COLOPLAST EASIFLEX 14303 ALI ENAKOVREDNO)	411817	KOM	244				
4	PODLOGA HIDROKOLOIDNA,DVOPLASTNA KOŽNA,OVALNE OBLIKE,Z RELIEFNIM VZORCEM Z UŠESOM ZA ODSTRANJEVANJE, VEL. 60MM, IZREZ 10-55MM (COLOPLAST SENSURA 10031 ALI ENAKOVREDNO)	325651	KOM	162				
5	PODLOGA HIDROKOLOIDNA,KOŽNA ZA VDRTO STOMO,VEL.60MM,IZREZ 15-43MM,OVALNE OBLIKE,Z RELIEFNIM VZORCEM,Z UŠESOM ZA ODSTRANJEVANJE,KONVEKSNA (COLOPLAST SENSURA 11031ALI ENAKOVREDNO)	442046	KOM	41				
6	VREČKA DRENAŽNA,ENODELNA STERILNA,MOŽNOST PRIKLOPA NA DRENAŽNO VREČKO, OVALNA,DVOPLASTNA PODLOGA S PREGLED.OKNOM,VEL.630ML,IZREZ 10-76MM,BREZ NEPOVR.VALVULE IN BREZ GRADUAC(COLOPL.SENS.19001 ALI ENAKOV.)	443131	KOM	122				
7	VREČKA DRENAŽNA,STERILNA,ENODELNAPOOPERATIVNA, Z OKNOM ZA ODPIRANJE, NA IZPUST,IZREZ OD10-70MM,MOŽNOST SPOJITVE Z DRENAŽNO VREČKO,ZAPIRANJE S ČEPOM ALI SPONKO,OKROGLA,BREZ GRAD.(COLOPL.POSTOP.12808 ALI ENAKOV.)	482650	KOM	251				
8	VREČKA DRENAŽNA,STERILNA,POOPERATIVNA,ENODELNA,Z OKNOM ZA ODPIRANJE,NA IZPUST,IZREZ OD 10-100MM,MOŽNOST SPOJITVE Z DRENAŽNO VREČKO,ZAPIR.S ČEPOM ALI SPONKO,OKROGLA,BREZ GRADUAC.(COLOPLAST 12810 ALI EN	384461	KOM	244				
9	VREČKA ZA ILEOSTOMO Z IZPUSTOM,VEL.70-80MM,Z VARNOSTNIM KANALOM,ZAPIRANJE Z JEŽKOM,PROZORNA,OKROGLE OBLIKE,S FILTROM (COLOPLAST EASIFLEX 14344 ALI ENAKOVREDNO)	435759	KOM	170				
10	VREČKA ZA ILEOSTOMO,ENODELNA,Z IZPUSTOM,KOŽNA PODLOGA OVALNE OBLIKE,IZREZ OD 10-76MM,RELIEFNI VZOREC,ZAPIR.NA JEŽKA,VALOVIT FILTER,PROZORNA,BREZ DVOJNE ZAP.,ODPRTINA ZA STOMO NA SREDINI(COLOPLAST15570 ALI ENAKOV.)	416959	KOM	648				

SPECIFIKACIJA ZAHTEV NAROČNIKA

Predmet JN: **88 Medicinski potrošni material 2, 2016-2018**
03 ABDOMINAL.ODD.Vrečke in podloge za stomo-100% sk.

CPV: 33196000

Z.Š.	Naziv artikla	ident JN	EM	Razp. kol. za 12 mes	Pakir.	Proizvajalec	Zaščiteno ime	Kataloška številka
11	VREČKA ZA ILEOSTOMO,ODPRTA,Z IZPUSTOM,PRITRJEVANJE S KLJUČAVNICO,VALOVIT FILTER,ZAPIRANJE Z JEŽKOM,PROZORNA, MEHKA TKANINA,VEL.60MM (COLOPLAST SENSURA 10386 ALI ENAKOVREDNO)	404497	KOM	292				
12	VREČKA ZA KOLOSTOMO,ZAPRTA,S FILTROM,VEL.70-80MM,NAMEŠČANJE Z LEPLJENJEM, Z VARNOSTNIM KANALOM,KOŽNE BARVE,OKROGLE OBLIKE (COLOPLAST EASIFLEX 14319 ALI ENAKOVREDNO)	443140	KOM	122				
13	VREČKA ZA KOLOSTOMO,ZAPRTA,VEL. 60MM,VALOVITI FILTER,ZAPIRANJE NA KLJUČAVNICO,PROZORNA, MEHKA TKANINA (COLOPLAST SENSURA 10186 ALI ENAKOVREDNO)	443115	KOM	49				
14	VREČKA ZA UROSTOMO,Z IZPUSTOM,PRITRJEVANJE S KLJUČAVNICO,NEPOVRATNI VENTIL,MOŽNA SPOJITEV Z ZBIRALNO VREČKO,S PREKATI,VEL.50MM,PROZORNA, ZAPIR.S ČEPOM (COLOPLAST SENSURA 11855 ALI ENAKOVREDNO)	560286	KOM	122				
15	VREČKA ZA UROSTOMO,Z IZPUSTOM,PRITRJEVANJE S KLJUČAVNICO,NEPOVRATNI VENTIL,MOŽNA SPOJITEV Z ZBIRALNO VREČKO,S PREKATI,VEL.60MM,PROZORNA,ZAPIR. S ČEPOM (COLOPLAST SENSURA 11856 ALI ENAKOVREDNO)	560294	KOM	73				

ŽIG IN PODPIS:

SPECIFIKACIJA ZAHTEV NAROČNIKA

Predmet JN: **88 Medicinski potrošni material 2, 2016-2018**
04 ANESTEZIJA.Dihalni sistemi in drugi pripom.-100% sk.

CPV: 33196000

Z.Š.	Naziv artikla	ident JN	EM	Razp. kol. za 12 mes	Pakir.	Proizvajalec	Zaščiteno ime	Kataloška številka
1	BALON ZA ANESTEZ.,VOL.OD 1000 DO 1200ML,BREZ LATEXA, Z ZAŠČITNO MREŽO PROTI KOLENČENJU.(INTERSURGICAL 2810 ALI ENAKOVREDNO).	430056	KOM	33				
2	BALON ZA ANESTEZ.,VOL.OD 1800 DO 2000ML, BREZ LATEXA, Z ZAŠČITNO MREŽO PROTI KOLENČENJU. ZA 1X UPOR.(INTERSURG. 2820 ALI ENAKOVREDNO).	388815	KOM	41				
3	CEV ZA KISIK,REBRASTA,FRAGMENTIRANA NA RAZDALJI MED 160 IN 170MM,PREMER 22MM IN DOLŽINE MED 45 IN 50M.(INTERSURG. 1573 ALI ENAKOVREDNO).	221180	KOM	18				
4	CEVKA ZA KISIK,DOLŽINA MED 1,8- 2M,Z NOTRANJO STENO ZVEZDASTE OBLIKE ZA PREPREČEVANJE KOLENČENJA.RAZTEGLJIVE OBJEMKE NA OBEH KONCIH.(INTERSURGICAL 1174 ALI ENAKOVREDNO).	388513	KOM	5.128				
5	CEVKA ZA MERJENJE CO2,NOTRANJI PREM.1,2MM.VSEBUJE DODATNI LUER LOCK KOMOLČEK PREMERA 7,6MM,DOLŽINA 2,45M.(INTERSURG. 2732100 ALI ENAKOVREDNO)	386111	KOM	876				
6	CEVKA ZA MERJENJE CO2,NOTRANJI PREMER 1,2MM.VSEBUJE DODATNI LUER LOCK KOMOLČEK PREMERA 7,6MM.DOLŽINA 3,0M.(INTERSURG. 2734100 ALI ENAKOVREDNO).	386120	KOM	1.022				
7	CEVKA ZA MERJENJE CO2.NOTRANJI PREMER 1,2mm.VSEBUJE DODATNI LUER LOCK KOMOLČEK PREMERA 7,6mm.DOLŽINA 1,8m.(INTERURG. 2725100 ALI ENAKOVREDNO).	432814	KOM	1.184				
8	CEVKA ZA MERJENJE IN DOVAJANJE KISIKA.NOTR PREMER 3,6MM.NA ENI STRANI OBJEMKA Z NOTR. PREM.5MM IN LUERLOCK SPOJKA S KOMOLČK.PREM.7,6MM NA DRUGI STR.KOMOLČEK LOČLJIV OD CEVKE.(INTERSURG2723 ALI ENAKOV)	388343	KOM	211				
9	CPAP SIST.ZA TUBUS OZ.KANILO.PREVLEČEN Z BAKTERICIDNO PREVLEKO S SREBROVIMI IONI.PREIZKUŠ.NA UČINKOVITOST PREPREČEV.OKUŽBE Z MRSA IN STAPHYLOCOCCUS IN AUREUS.(INTERSURGICAL 2234001 ALI ENAKOVREDNO).	433594	KOM	41				
10	DRŽALO ZA CEVI BREZ KOVINSKIH DELOV Z UPOGLJIVIM NOSILCEM.DRŽALO IMA NA KONCU NOSILEC S ŠTIRIMI UTORI.DVA UTORA STA PREMERA 10MM IN DVA 15MM.(INTERSURGICAL 5905 ALI ENAKOVREDNO).	434256	KOM	2				
11	DRŽALO ZA CEVI BREZ KOVINSKIH DELOV. Z UPOGLJIVIM NOSILCEM,KI IMA NA KONCU NOSILEC Z DVEMA UTOROMA,PREMERA 22 MM,DVEMA UTOROMA PREMERA 15MM IN ENIM UTOROM PREM.30MM.(INTERSURG. 5904 ALI ENAKOVREDNO).	388793	KOM	4				

SPECIFIKACIJA ZAHTEV NAROČNIKA

Predmet JN: **88 Medicinski potrošni material 2, 2016-2018**
04 ANESTEZIJA.Dihalni sistemi in drugi pripom.-100% sk.

CPV: 33196000

Z.Š.	Naziv artikla	ident JN	EM	Razp. kol. za 12 mes	Pakir.	Proizvajalec	Zaščiteno ime	Kataloška številka
12	KATETER NOSNI ZA KISIK,DVOROGI OTROŠKI,DOLŽINA 1,8M,CEVKA 423912 IMA NOTRANJI PREMIER ZVEZDASTE OBLIKE, NASTAVEK ZA PRIKLJUČITEV NA POVEZOVALNO CEV.(INTERSURG. 1163 ALI ENAKOVREDNO).		KOM	2				
13	KATETER NOSNI ZA KISIK,DVOROGI ZA NOVOROJENCE.DOLŽINA KATET.MED 1,8 IN 2,0M. CEVKA ZA KISIK Z NOTR.STENO ZVEZDASTE OBLIKE ZA PREPREČEVANJE KOLENČENJA. KATETER BREZ PHT-JA.(INTERSURG.1160001 ALI ENAK	832766	KOM	2				
14	KATETER NOSNI ZA KISIK,DVOROGI,ZA DOJENČKE, DOLŽINA KATET. MED 1,8M IN 2,0M.CEVKA ZA KISIK Z NOTR.STENO ZVEZDASTE OBLIKE ZA PREPREČEVAN.KOLENČENJA KATETER BREZ PHT-JA (INTERSURG.1164 ALI ENAKOVR.)	660132	KOM	41				
15	KATETER NOSNI ZA KISIK,DVOROGI,ZA NEDONOŠENČKE.DOLŽINA KATET.MED 1,8M IN 2,0M.CEVKA ZA KISIK Z NOTR.STENO ZVEZDASTE OBLIKE ZA PREPREČEV.KOLENČENJA.KATETER BREZ PHT-JA (INTERSURG.1160 ALI ENAKOVR.)	832758	KOM	2				
16	KATETER NOSNI ZA,KISIK DVOROGI ZA ODRASLE, DOLŽINE 1,8M Z IZBOKLINO POD NOSOM PROTI PREMIKANJU,CEVKA ZA KISIK IMA NOTRANJO STENO ZVEZDASTE OBLIKE.V UŠESNEM PREDELU MORA BITI CEV OBLAZINJENA PROTI RAZJEDAM (INTERSURG.1165002 ALI ENAKOVR.).	388734	KOM	8.392				
17	KOMOLČEK GIBLJIVI 22M-15F/15M.GIBLJIV OKOLI OSI NA OBEH STRANEH,KOMOLČEK NE SME VSEBOVATI ODPRTIN. (INTERSURGICAL 1897 ALI ENAKOVREDNO).	388661	KOM	29				
18	KONEKT KOMOLČEK FIKSNI 22M/15F IN 22M.(INTERSURGICAL 1892 ALI ENAKOVREDNO).	388572	KOM	20				
19	KONEKT ZA CEV-ELASTIČEN.(INTERSURG.1704 ALI ENAKOVREDNO).	334634	KOM	56				
20	KONEKT ZA KISIK 22M/15F S KONUSNIM NASTAVKOM 6,5MM,POSAMEZNO PAKIRAN , (INTERURGICAL 1974 ALI ENAKOVREDNO).	336777	KOM	182				
21	KONEKT 15M/22M.(INTERSURGICAL 1943 ALI ENAKOVREDNO).	430048	KOM	162				
22	KONEKT 22F-22M Z ZAMAŠKOM IN ODPRTINO 7,6MM. (INTERSURGICAL 1964 ALI ENAKOVREDNO).	388556	KOM	203				
23	KONEKT 22F-22m.(INTERSURGICAL 1967 ALI ENAKOVREDNO).	388432	KOM	2				
24	KONEKTOR T , DIMENZIJE :22F+22M+22M/15F .(INTERSURGICAL 1986 ALI ENAKOVREDNO).	429449	KOM	308				

SPECIFIKACIJA ZAHTEV NAROČNIKA

Predmet JN: **88 Medicinski potrošni material 2, 2016-2018**
04 ANESTEZIJA.Dihalni sistemi in drugi pripom.-100% sk.

CPV: 33196000

Z.Š.	Naziv artikla	ident JN	EM	Razp. kol. za 12 mes	Pakir.	Proizvajalec	Zaščiteno ime	Kataloška številka
25	KONEKTOR T,DIMENZIJE:22M+22M/15F+22M IN PORT ZA SESANJE 7,6MM S PRITRJENIM POKLOPCEM.(INTERSURGICAL 1984 ALI ENAKOVREDNO).	388564	KOM	1.906				
26	MASKA OBLAZINJENA ZA CPAP INHALATOR- ODRASLA(S)Z VENTILOM ZA POLNJENJE,NASTAVKI ZA PRITRDITEV,PROZORNA,MEHKI ROB.(VITAL S. 9000 ALI ENAKOVREDNO).	442895	KOM	2				
27	MASKA ZA CPAP SISTEM. GLEJ PRILOGO 3.	532754	KOM	2				
28	MASKA OBLAZINJENA ,VELIKOST ONAČENA TUDI Z BARVNO OZNAKO,PROZORNA,ROB NI NAPIHLJIV IN NE VSEBUJE ZRAKA,MASKA NE VSEBUJE PVC.VELIKOST ŠT.6.(INTERSURGICAL 7096 ALI ENAKOVREDNO).	667668	KOM	2				
29	MASKA OBLAZINJENA ,VELIKOST OZNAČENA TUDI Z BARVNO OZNAKO,PROZORNA,ROB NI NAPIHLJIV IN NE VSEBUJE ZRAKA,MASKA NE VSEBUJE PVC,VELIKOST ŠT.4.(INTERSURGICAL 7094 ALI ENAKOVREDNO).	667641	KOM	2				
30	MASKA OBLAZINJENA ,VELIKOST OZNAČENA TUDI Z BARVNO OZNAKO,PROZORNA,ROB NI NAPIHLJIV IN NE VSEBUJE ZRAKA,MASKE NE VSEBUJE PVC,VELIKOST ŠT.3.(INTERSURGICAL 7093 ALI ENAKOVREDNO).	667633	KOM	2				
31	MASKA OBLAZINJENA ,VELIKOST TUDI Z BARVNO OZNAKO ,PROZORNA ,ROB NI NAPIHLJIV IN NE VSEBUJE ZRAKA MATERIAL NE VSEBUJE PVC,VELIKOST ŠT.0.(INTERSURGICAL 7090 ALI ENAKOVREDNO).	667609	KOM	2				
32	MASKA OBLAZINJENA ŠT.4 ZA ODRASLE-SREDJA Z MEŠIČKOM IN VENTILOM ZA NAPIHOVANJE-ODIŠAVLJENA, PROZORNA.(INTERSURGICAL 1124 ALI ENAKOVREDNO).	388467	KOM	2.448				
33	MASKA OBLAZINJENA ŠT.3.Z MEŠIČKOM IN VENTILOM ZA NAPIHOVANJE.PROZORNA,ODIŠAVLJENA.(INTERURGICAL 1123 ALI ENAKOVREDNO).	437930	KOM	4.013				
34	MASKA OBLAZINJENA,VELIKOST ONAČENA TUDI Z BARVNO OZNAKO,PROZORNA,ROB NI NAPIHLJIV IN NE VSEBUJE ZRAKA,MATERIAL NE VSEBUJE PVC,VELIKOST ŠT.1.(INTERSURGICAL 7091 ALI ENAKOVREDNO).	667617	KOM	2				
35	MASKA OBLAZINJENA,VELIKOST OZNAČENA TUDI Z BARVNO OZNAKO,PROZORNA,ROB NI NAPIHLJIV IN NE VSEBUJE ZRAKA, VELIKOST ŠT.5.(INTERSURGICAL 7095 ALI ENAKOVREDNO).	667650	KOM	2				
36	MASKA oblazinjena,velikost označena tudi z barvno oznako,PROZORNA,ROB NI NAPIHLJIV IN NE VSEBUJE ZRAKA,MASKA NE VSEBUJE PVC,VELIKOST ŠT.2.(INTERSURGICAL 7092 ALI ENAKOVREDNO).	667625	KOM	2				

SPECIFIKACIJA ZAHTEV NAROČNIKA

Predmet JN: **88 Medicinski potrošni material 2, 2016-2018**
04 ANESTEZIJA.Dihalni sistemi in drugi pripom.-100% sk.

CPV: 33196000

Z.Š.	Naziv artikla	ident JN	EM	Razp. kol. za 12 mes	Pakir.	Proizvajalec	Zaščiteno ime	Kataloška številka
37	MASKA OBLAZINJENA-NEONATALNA VELIKOST 0, Z MEŠIČKOM IN VENTILOM ZA NAPIHOVANJE,ODIŠAVLJENA,PROZORNA.(INTERURGICAL 1127 ALI ENAKOVREDNO).	584991	KOM	65				
38	MASKA OBLAZINJENA-ŠT.1 ZA DOJENČKE Z MEŠIČKOM IN VENTILOM ZA NAPIHOVANJE,ODIŠAVLJENA, PROZORNA.(INTERSURGICAL 1128 ALI ENAKOVREDNO).	388530	KOM	130				
39	MASKA OBLAZINJENA-ŠT.5 ZA ODRASLE ZMEŠIČKOM IN VENTILOM ZA NAPIHOVANJE- ODIŠAVLJENA, PROZORNA.(INTERSURGICAL 1125 ALI ENAKOVREDNO).	388459	KOM	1.192				
40	MASKA OBLAZINJENAŠT.2 ZA OTROKE Z MEŠIČKOM IN VENTILOM ZA NAPIHOVANJE, ODIŠAVLJENA, PROZORNA.(INTERURGICAL 1129 ALI ENAKOVREDNO).	388548	KOM	738				
41	MASKA ZA DOVOD 100% KISIKA ZA ODRSLE ,MASKA IMA NOSNI STIŠČEK, DOLŽINA CEVI ZA KISIK NAJMANJ 1,8M ,PROZORNA ,BREZBARVNA Z INDIKATORJEM DIHANJA (INTERSURGICAL 1202 ALI ENAKOVREDNO).	563927	KOM	697				
42	MASKA ZA DOVOD 100% KISIKA Z ENIM ENOSMERNIM VENTILOM IN INDIKATORJEM DIHANJA.CEVKA ZA KISIK IMA NOTRANJO STENO ZVEZDASTE OBLIKE.ZA OTROKE, (INTERSURGICAL 1292 ALI ENAKOVREDNO).	563919	KOM	16				
43	MASKA ZA KISIK S KONEKT.ZA MERJENJE CO2. V KOMPLETU CEV ZA KISIK Z NOTR.STENO ZVEZDASTE OBLIKE PROTI KOLENČENJU IN CEVKA ZA MONITORING CO2.(INTERSURG. 1143 ALI ENAKOVREDNO)	832855	KOM	2				
44	MASKA ZA KISIK ZA ODRASLE,NE VSEBUJE PVC,IMA CEVKO ZA KISIK DOLŽINE VSAJ 1,8M(INTERSURGICAL 1135 ALI ENAKOVREDNO).	750093	KOM	7.152				
45	MASKA ZA KISIK ZA OTROKE S STIŠČKOM IN S CEVJO,KI IMA NOTRANJO STENO ZVEZDASTE OBLIKE.(INTERSURGICAL 1196015 ALI ENAKOVREDNO).	424552	KOM	536				
46	MASKA ZA KISIK ZA TRAHEOSTOMO ZA ODRASLE Z VRTLJIVIM PRIKLJUČKOM. MASKA NE SME VSEBOVATI PVC-JA.(INTRSURGICAL1200050 ALI ENAKOVREDNO).	528862	KOM	2				
47	MASKA ZA NEBULIZER -OTROŠKA Z GIBLJIVIM KONEKTOM.(INTERSURGICAL 1148 ALI ENAKOVREDNO).	388491	KOM	1.447				
48	MASKA ZA NEBULIZER ZA ODRASLE BREZ PVC,S STIŠČKOM Z GIBLJIVIM NASTAVKOM 22M.(INTERSURGICAL 1108 ALI ENAKOVREDNO).	388505	KOM	1.906				
49	MASKA ZA NEBULIZER ZA ODRASLE,SREDNJA Z VENTILOM.(INTERSURGICAL 1101 ALI ENAKOVREDNO).	423939	KOM	1.930				

SPECIFIKACIJA ZAHTEV NAROČNIKA

Predmet JN: **88 Medicinski potrošni material 2, 2016-2018**
04 ANESTEZIJA.Dihalni sistemi in drugi pripom.-100% sk.

CPV: 33196000

Z.Š.	Naziv artikla	ident JN	EM	Razp. kol. za 12 mes	Pakir.	Proizvajalec	Zaščiteno ime	Kataloška številka
50	NASTAVEK ZA AEROSOL TERAPIJO ZA BOLNIKE NA VENTILATORJU,KONEKT 15M-15F Z GIBLJIVO RAZPRŠILNO ŠOBO. (INTERSURGICAL 1947001 ALI ENAKOVREDNO).	388688	KOM	20				
51	NASTAVEK ZA AEROSOL TERAPIJO ZA BOLNIKE NA VENTILATORJU,KONEKT 22M/22F Z GIBLJIVO RAZPRŠILNO ŠOBO. (INTERSURGICAL1964-001 ALI ENAKOVREDNO).	611522	KOM	284				
52	NASTAVEK ZA TUBUS RAZTEGLJIV OD 110MM DO 170MM Z GIBLJIVIM KOMOLČKOM.MOŽNOST SP.MRTVEGA PROST OD 20ML DO 40ML.KONKT PRI DIH.SIST.22MM NOTRANJI PREMER. (INTERSURGICAL 3512 ALI ENAKOVREDNO).	388807	KOM	5.116				
53	NASTAVEK ZA TUBUS RAZTEGLJIV. GLEJ PRILOGO 3.	729523	KOM	3.433				
54	NEBULIZER HOT TOP 72% SKUP VOLUMNA DELCEV JE PRI PRETOKU 8 L MANJŠIH OD 5 MIKR.IZHOD JE 0.50g/min. PRI PRETOKU 8L.KOMPLET ZA ODR. Z MASKO S STIŠČ. CEVKO Z NAVOJEM,SP.(INTERSU 1473015 ALI ENAKOVREDNO)	528838	KOM	5.132				
55	NEBULIZER HOT-TOP. PRI PRETOKU 8L/MIN MORAJO BITI DELCI MANJŠI OD 5 MIKRONOV. Z NAVOJEM ZA PRITRDITEV CEVKE (INTERSURGICAL 1471 ALI ENAKOVREDNO).	439223	KOM	527				
56	NEBULIZER ZA ZDRAVILA ,ZAGOTAVLJA PRI PRETOKU 8L/MIN DELCE MANJŠE OD 5 MIK.UČINKOVITOST VSAJ 74%. (INTERSURGICAL 1402 ALI ENAKOVREDNO).	388475	KOM	1.155				
57	NEBULIZER ZA ZDRAVILA ,90%SKUPNEGA VOLUMNA DELCEV JE PRI PRETOKU 8L/MIN MANJŠIH OD 2 MIKRONA.(INTERSURGICAL 1503 ALI ENAKOVREDNO).	388483	KOM	81				
58	NEBULIZER ZA ZDRAVILA S T KONEKTOM.ZAGOTAVLJA PRI PRETOKU 8L/MIN DELCE MANJŠE OD 5 MIK,UČINKOVITOST VSAJ 74%,KOMPLET S CEVKO.(INTERSURGICAL 1485 ALI ENAKOVREDNO).	388360	KOM	486				
59	NEBULIZER ZA ZDRAVILA Z MASKO ZA OTROKE, PRI PRET 8L /MIN,DELCI MANJŠI OD 5 MIK.IZHOD JE 0.50g/min..KOMPL.S PROZORNO MASKO S STIŠČ. IN CEVKO Z NAVOJEM,IN KONEKT ZA O2.(INTERSURG 1474 ALI ENAKOVREDNO)	528846	KOM	2				
60	NEBULIZER ZA ZDRAVILA ZA ALVEOLARNO DEPOZICIJO. GLEJ PRILOGO 3.	388769	KOM	1.662				
61	NEBULIZER ZA ZDRAVILAZ MASKO ZA ODRASLE,PRI PRETOKU 8L/MIN DELCI MANJŠI OD 5 MIKRONOV,UČINKOVITOST VSAJ 74% ,KOMPLET Z OBRAZNO MASKO,GIBLJIVIM KONEKTOM IN CEVKO. (INTERSURGICAL 1493004 ALI ENAKOVREDNO	388378	KOM	2				

SPECIFIKACIJA ZAHTEV NAROČNIKA

Predmet JN: **88 Medicinski potrošni material 2, 2016-2018**
04 ANESTEZIJA.Dihalni sistemi in drugi pripom.-100% sk.

CPV: 33196000

Z.Š.	Naziv artikla	ident JN	EM	Razp. kol. za 12 mes	Pakir.	Proizvajalec	Zaščiteno ime	Kataloška številka
62	ROČNI DIHALNIK KOMPLET,VOL.1L ZA OTR.VSEBUJE CEVKO ZA KISIK 2M Z NOTRANJO STENO ZVEZDASTE OBLIKE IN VREČKO ZA KISIK.KOMOLČEK Z VAROVANIM VENTIL.(INTERSURGICAL 7153 ALI ENAKOVREDNO).	425486	KOM	5				
63	ROČNI DIHALNIK KOMPLET,vol.280ml,ne vsebuje lateksa,cevka ima zvezdasti notranji prem.za preprečitev mašenja,rezervoar za kisik,obrazna maska,komolček ima varovalni ventil.(INTERS 7150 ALI ENAKOVREDNO	425478	KOM	2				
64	ROČNI DIHALNIK KOMPLET,volumen 1500 ml,ne vsebuje lateksa,cevka za kisik ima zvezdasti notr.premer za preprečitev mašenja, ima rezervoar za kisik in obrazno masko.(INTERSURGICAL 7152 ALI ENAKOVREDNO).	388408	KOM	73				
65	ROČNI DIHALNIK KOMPLET,za otroke,vol.550ml,brez lateksa,cevka za kisik ima zvezdasti notr.prem.Komolček med masko in balonom z varnost.valvulo,rezervoar za kisik in obrazna maska,(INT7151 ALI ENAKOVR)	578916	KOM	2				
66	SISTEM DIHALNI OBOJESTRANSKO PREVLEK. Z ANTIBAKT. PREVLEKO S SREBROVIMI IONI, CEVI DOLŽINA 1,6M,PREMER 22MM,KRAK ZA BALON 0,8M; BALON 2L. Z MREŽO PROTI MAŠENJU.(INTERSURGICAL 2010102 ALI ENAKOVREDNO)	662585	KOM	2.408				
67	SISTEM DIHALNI KOAKSIALNI,DOLŽ.CEVI 2,4M,INSPIRATORNA CEV SE NAHAJA V EKSPIRATORNI CEVI,KRAK ZA POV.Z APAR.JE RAZTEGLJIV 0,4M,CEVKA ZA CO2 V NOT.LUMNU,BALON 2L ,Z BAKT.ZAŠČ.(INTERSU2902103 ALI ENAKOVR	711276	KOM	78				
68	SISTEM DIHALNI Z GRELNO ŽICO V INSPR.KRAKU IN KNDENZ.LONČKOM V EKSPIRATORNEM KRAKU.KRAK ZA POVEZAVO VLAŽILCA IN APAR.DOLG 0,4M.KOMPLET VSEBUJE DVE RAZTEGLJIVI SPOJ.22MM.(INTERS.2049002 ALI ENAKOVREDNO	505226	KOM	2				
69	SISTEM DIHALNI ZA OXILOG1000 Z VENTILOM,KI NE VSEBUJE LATEKSA.ZA STANDARDNO VENTILACIJO, PREIZKUŠEN NA UČINKOVITOST PREPREČ.OKUŽBE Z MRSA IN STAPHYLOCOCCUS AUREUS.(INTERSURG.2080103 ALI ENAKOVREDNO).	609102	KOM	259				
70	SISTEM DIHALNI ZA CPAP Z MASKO-VELIKO ZA ODRASLE,CEVKO ZA MERJENJE PRITISKA,INSPIRAT.CEVJO PEM.22MM IN DVEMA CPAP VENT.(5CM H2O.20CM H2O)SISTEM INTEG.Z BAKT.PREV.(INTERSUGICAL 2230002 ALI ENAKOVREDNO)	486922	KOM	511				
71	SISTEM DIHALNI ZA DREGER AQUAPOR VLAŽILEC Z DVEMA KONDENZ.LONČKOMA,ODPRTINO ZA TEMPERAT.TIPALO 20MM,DOLŽINA 1,6M,PREM.CEVI 22MM,PREV.OBOJESTRANSKA.S SREBROVIM IONI.(INTERSURG.2034100 ALI ENAKOVREDN)	662593	KOM	1.350				

SPECIFIKACIJA ZAHTEV NAROČNIKA

Predmet JN: **88 Medicinski potrošni material 2, 2016-2018**
04 ANESTEZIJA.Dihalni sistemi in drugi pripom.-100% sk.

CPV: 33196000

Z.Š.	Naziv artikla	ident JN	EM	Razp. kol. za 12 mes	Pakir.	Proizvajalec	Zaščiteno ime	Kataloška številka
72	SISTEM DIHALNI ZA OTR. AYRES T MAPELSOM Z APL VENT.UPOR VENT. PRI ZAPRT. POLOŽAJU IN 15 L/min.PRETOKA JE 35cmH2O.KOMPLET IMA DVA BALONA:1l in 0.5l.KONEK.22M/30F. (INTERSUGICAL 2122012 ALI ENAKOVREDNO).	423017	KOM	60				
73	SISTEM DIHALNI, KROŽNI OTR. ZA ANESTEZIJO.REBRASTE CEVI PREM.15mm,FRAGMENTI NA 40cm,DOLŽINA 1,6m.BALON 1l,Z ZAŠČITO PROTI MAŠENJU.KRAK ZA BAL.0,8m.(INTERSURG. 4500006 ALI ENAKOVREDNO).	409898	KOM	414				
74	SISTEM DIHALNI,IMPREG. Z BAKTER. PREV. Z SREB. IONI, BREZ GRELNE ŽICE, DOLŽINA CEVI 1,6M,PREMER 22MM,PRISKUŠEN NA UČINKOVITOST PREP.OK.MRSA IN STAPHILOCOCCUS AUREU. (INTERSURG.2000101 ALI ENAKOVREDNO)	388351	KOM	438				
75	SISTEM DIHALNI-CEVI PREMERA 22MM OBOJESTR. IMPREGNIRANE Z ANTIBAKT. PREVLEKO S SREBROVIMI IONI PROTI MRSA IN STAPHILOCOCCUS AUREUS. DOLŽ. CEVI 2,4M. (INTERSURGICAL 2010101ALI ENAKOVREDNO).	662577	KOM	827				
76	SISTEM DIHALNI-CEVI.ODRASLI,ZA UPORABO PRI MR PREISKAVAH (INTERSURGICAL 2010106 ALI ENAKOVREDNO).	820024	KOM	3				
77	SISTEM DIHALNI-CEVI.OTROŠKI,ZA UPORABO PRI MR PREISKAVAH (INTERSURGICAL 4500027 ALI ENAKOVREDNO).	820059	KOM	7				
78	SISTEM KROŽ.DIHALNI KOAKSIALNI,DOLŽINA 1,6M,inspiratorna cev se nahaja v ekspiratorni cevi,krak za pov.z aparatom 0,4m,cevka za CO2 V NOT.LUMNU,BALON 2L,Z BAKT.PREVL. (INTERSUR2902102 ali enakovredno)	506788	KOM	32				
79	VENTIL PEEP 5CM H2O PRITISKA ZA CPAP SISTEM,PROZOREN,BARVNA OZNAKA NASTAVITVE PRITISKA. (INTERSURGICAL 2205 ALI ENAKOVREDNO).	751324	KOM	186				
80	VENTURI VENTIL ZA KISIK 24%, POSAMEZNO PAKIRAN,NOTRANJI PREMER 22MM,KONCENTRACIJA KISIKA JE OZNAČENA Z BARVO, KI JE RAZLIČNA OD BARVE VENTILA.(INTERSURGICAL 0024 ALI ENAKOVREDNO).	388599	KOM	406				
81	VENTURI VENTIL ZA KISIK 28%, POSAMEZNO PAKIRAN,NOTRANJI PREMER 22MM,KONCENTRACIJA NA VENTILU OZNAČENA Z BARVO,KI JE RAZLIČNA OD BARVE VENTILA.(INTERSURGICAL 0028 ALI ENAKOVREDNO).	388602	KOM	892				
82	VENTURI VENTIL ZA KISIK 31%, POSAMEZNO PAKIRAN,NOTRANJI PREMER 22MM,KONCENTRACIJA KISIKA NA VENTILU JE OZNAČENA Z BARVO KI JE RAZLIČNA OD BARVE VENTILA.(INTERSURGICAL 0031 ALI ENAKOVREDNO).	388629	KOM	527				

SPECIFIKACIJA ZAHTEV NAROČNIKA

Predmet JN: **88 Medicinski potrošni material 2, 2016-2018**
04 ANESTEZIJA.Dihalni sistemi in drugi pripom.-100% sk.

CPV: 33196000

Z.Š.	Naziv artikla	ident JN	EM	Razp. kol. za 12 mes	Pakir.	Proizvajalec	Zaščiteno ime	Kataloška številka
83	VENTURI VENTIL ZA KISIK 35%, POSAMEZNO PAKIRAN ,NOTRANJI PREMER 22MM,KONCENTRACIJA KISIKA JE NA VENTILU OZNAČENA Z BARVO ,KI JE RAZLIČNA OD BARVE VENTILA.(INTERSURGICAL 0035 ALI ENAKOVREDNO).	388637	KOM	608				
84	VENTURI VENTIL ZA KISIK 40%, POSAMEZNO PAKIRAN,NOTRANJI PREMER 22MM,KONCENTRACIJA KISIKA JE NA VENTILU OZNAČENA Z BARVO,KI JE RAZLIČNA OD BARVE VENTILA.(INTERSURGICAL 0040 ALI ENAKOVREDNO).	388645	KOM	1.703				
85	VENTURI VENTIL ZA KISIK 50% KISIK,POSAMEZNO PAKIRAN. (INTERSURGICAL 0070 ALI ENAKOVREDNO).	695831	KOM	41				
86	VENTURI VENTIL ZA KISIK 60%, POSAMEZNO PAKIRAN,NOTRANJI PEMER 22MM,KONCENTRCIJA KISIKA JE NA KONEKTU OZNAČENA Z BARVO,KI JE RAZLIČNA OD BARVE VENTILA.(INTERSURGICAL 0060 ALI ENAKOVREDNO).	388653	KOM	973				
87	VLAŽILEC ZA TUBUS IN KANILO S CEVZA KISIK-NOS UMETNI.POVRAČILO VLAG PRI VT500ml=27mgH2O/l.ZAVAROVANA ODPRTINA ZA ASPIRACIJO S POKROVOM,KI JE PRITRJAN NA ROB ODPRTINE.(INTERSURG.1874 ALI ENAKOVREDNO).	329851	KOM	211				
88	VLAŽILEC ZA TUBUS IN KANILO-NOS UMETNI.POVRAČILO VLAG PRI VT500ml=27mgH2O/l,ZAVAROV.ODPRTINA ZA ASPIR.S PRITRJENIM POKR.VAROVALNI MEHANIZEM PROTI ZADUŠITVI,GIBLJIV KON.(INTERSURG.1873 ALI ENAKOVREDNO).	388394	KOM	4.298				

ŽIG IN PODPIS:

SPECIFIKACIJA ZAHTEV NAROČNIKA

Predmet JN: **88 Medicinski potrošni material 2, 2016-2018**
05 ANESTEZIJA.Filtri bakteriološki - 100% sk.GLEJ PRIL.2

CPV: 33196000

Z.Š.	Naziv artikla	ident JN	EM	Razp. kol. za 12 mes	Pakir.	Proizvajalec	Zaščiteno ime	Kataloška številka
1	FILTER VIRALNO BAKTERIOLOŠKI. GLEJ PRILOGO 2.	329479	KOM	17.578				
2	FILTER VIRALNO BAKTERIOLOŠKI. GLEJ PRILOGO 2.	386138	KOM	10.086				
3	FILTER VIRALNO BAKTERIOLOŠKI. GLEJ PRILOGO 2.	386146	KOM	843				
4	FILTER VIRALNO BAKTERIOLOŠKI. GLEJ PRILOGO 2.	430129	KOM	49				

ŽIG IN PODPIS:

SPECIFIKACIJA ZAHTEV NAROČNIKA

Predmet JN: **88 Medicinski potrošni material 2, 2016-2018**
06 ANESTEZIJA.Igle za spinalno anest.-atravmatske-100%sk

CPV: 33196000

Z.Š.	Naziv artikla	ident JN	EM	Razp. kol. za 12 mes	Pakir.	Proizvajalec	Zaščiteno ime	Kataloška številka
1	IGLA ZA SUBARAHNOIDNO ANESTEZIJO G25 X 4 3/4"(120MM)TIPA SPROTTE S PROZORNIM LUER NASTAVKOM IN Z ODGOVARJAJOČIM INTRODUKTORJEM.(PAJUNK 051151-29A ALI ENAKOVREDNO).	508241	KOM	81				
2	IGLA ZA SUBARAHNOIDNO ANESTEZIJO G25X 90MM TIPA SPROTTE S PROZORNIM LUER NASTAVKOM Z INTEGRIRANO LUPO IN Z ODGOVARJAJOČIM INDUKTORJEM DOLŽINE 3CM. (PAJUNK 511151-29A ALI ENAKOVREDNO).	330272	KOM	2.635				
3	IGLA ZA SUBARAHNOIDNO ANESTEZIJO G27 X 90MM TIPA SPROTTE S PROZORNIM LUER NASTAVKOM Z INTEGRIRANO LUPO IN Z ODGOVARJAJOČIM INDUKTORJEM DOLŽINE 3CM. (PAJUNK 121151-27A ALI ENAKOVREDNO).	382299	KOM	2				

ŽIG IN PODPIS:

SPECIFIKACIJA ZAHTEV NAROČNIKA

Predmet JN: **88 Medicinski potrošni material 2, 2016-2018**
08 ANESTEZIJA.Katetri periferni venski-100% sk.

CPV: 33196000

Z.Š.	Naziv artikla	ident JN	EM	Razp. kol. za 12 mes	Pakir.	Proizvajalec	Zaščiteno ime	Kataloška številka
1	KATETER PERIFERNI VENSKI; 1 LUMNI 1,2 X 1,7MM, DOLŽINA 70CM,PRETOK 30ML/MIN/0,8ML, KANILA 1,9 X 2,3M	326364	KOM	162				
2	KATETER PERIFERNI VENSKI;1 LUMNI 1,5 X 2,0MM, DOLŽINA 70CM, PRETOK 50ML/MIN/1,1ML, KANILA 2,1 X 2,7M	344303	KOM	244				

ŽIG IN PODPIS:

SPECIFIKACIJA ZAHTEV NAROČNIKA

Predmet JN: **88 Medicinski potrošni material 2, 2016-2018****09 ANESTEZIJA.Potrošni material za "HAEMONETICS"-100%sk.**

CPV: 33196000

Z.Š.	Naziv artikla	ident JN	EM	Razp. kol. za 12 mes	Pakir.	Proizvajalec	Zaščiteno ime	Kataloška številka
1	BASIC A/C"- ZA ASPIRAT,1 X ANTIKOAGULANTNI APIRACIJSKI SISTEM ZA "CELL SAVER".(HAEMONETICS 208 ALI ENAKOVREDNO).	424722	KOM	393				
2	NASTAVEK ZA ASPIRACIJO,5 X 10MM-DOLŽINA 27CM, ZA "CELL SAVER" SISTEM. KODA-68175.(PFM 33093182 ALI ENAKOVREDNO).	424749	KOM	2				
3	STEKLENICA 225ML-SET ZA 1X UPORABO ZA "CELL SAVER". (HAEMONETICS 263 ALI ENAKOVREDNO)	424706	KOM	356				
4	ZBIRNI REZERVOAR ,MAKSIMALNA KAPACITETA 3000ML ZA "CELL SAVER".(HAEMONETICS 205 ALI ENAKOVREDNO).	424714	KOM	379				

ŽIG IN PODPIS:

SPECIFIKACIJA ZAHTEV NAROČNIKA

Predmet JN: **88 Medicinski potrošni material 2, 2016-2018**
10 ANESTEZIJA.Pripomočki za aspiracijo-100%sk.

CPV: 33196000

Z.Š.	Naziv artikla	ident JN	EM	Razp. kol. za 12 mes	Pakir.	Proizvajalec	Zaščiteno ime	Kataloška številka
1	DRŽALO ZA POSODE, SEP-T-VAC (COVIDIEN 000844 ALI ENAKOVREDNO)	425320	KOM	2				
2	PRAŠEK ŽELIRNI, PAKIRANJE PO 20G, (COVIDIEN, SEP-T VAC 310557 ali enakovredno).	418323	KOM	7.297				
3	1200 ML FLEKSIBILNA ASPIRACIJSKA VREČKA Z HIDROFOBNI M ZAPORNIM VENTILOM,ČISTA , (COVIDIEN,SEP-T-VAC ali enakovredno).	418293	KOM	661				
4	1200 ML POSODA ZA ASPIRACIJSKO VREČKO,ČISTA, (COVIDIEN, SEP-T VAC ali enakovredno).	418277	KOM	26				
5	2000 ML FLEKSIBILNA ASPIRACIJSKA VREČKA Z HIDROFOBNI M ZAPORNIM VENTILOM,ČISTA , (COVIDIEN, SEP-T-VAC ali enakovredno).	418307	KOM	467				
6	2000 ML POSODA ZA ASPIRACIJSKO VREČKO,ČISTA, (COVIDIEN, SEP-T-VAC ali enakovredno).	418285	KOM	20				
7	3000 ML FLEKSIBILNA ASPIRACIJSKA VREČKA, S HIDROFOBNI M ZAPORNIM VENTILOM,ČISTA , (COVIDIEN, SEP-T-VAC ali enakovredno).	420646	KOM	1.868				
8	3000 ML POSODA ZA ASPIRACIJSKO VREČKO,ČISTA, (COVIDIEN, SEP T VAC ali enakovredno).	399329	KOM	114				

ŽIG IN PODPIS:

SPECIFIKACIJA ZAHTEV NAROČNIKA

Predmet JN: **88 Medicinski potrošni material 2, 2016-2018****11 ANESTEZIJA.Pribor za hemodinamski monitoring-Picco-100%**

CPV: 33196000

Z.Š.	Naziv artikla	ident JN	EM	Razp. kol. za 12 mes	Pakir.	Proizvajalec	Zaščiteno ime	Kataloška številka
1	KATETER ARTERIJSKI TERMODILUCIJSKI 4F-DOLŽINA 16CM: (PULSION PV2014L16 ali enakovredno)	497410	KOM	93				
2	KATETER ARTERIJSKI TERMODILUCIJSKI 4F-DOLŽINA 22CM: (PULSION PV2014L22 ali enakovredno)	628085	KOM	2				
3	KATETER ARTERIJSKI TERMODILUCIJSKI 5F,DOLŽINA 20CM : (PULSION PV2015L20 ali enakovredno)	707660	KOM	2				
4	MONITORING SET PICCO ZA MONITORING SISTEM PICCO PLUS, (PULSION PV8115-150CM ali enakovredno)	694517	KOM	85				
5	MONITORING SET PICCO ZA MONITORING SISTEM PICCO: (PULSION PV8115CVP ali enakovredno)	497428	KOM	2				

ŽIG IN PODPIS:

SPECIFIKACIJA ZAHTEV NAROČNIKA

Predmet JN: **88 Medicinski potrošni material 2, 2016-2018**
12 ANESTEZIJA.Sistemi za merjenje tlaka-100% sk.

CPV: 33196000

Z.Š.	Naziv artikla	ident JN	EM	Razp. kol. za 12 mes	Pakir.	Proizvajalec	Zaščiteno ime	Kataloška številka
1	ADAPTER ZA ZAPRTI SISTEM ZA ODVZEM KRVİ ZA BOLNIKE, KI SO PRIKLJUČENI NA MONITORING SISTEM.(PVB HG-01 ALI ENAKOVREDNO).	487007	KOM	20.838				
2	SISTEM ZA INVAZIVNO MERJENJE ARTERIJSKEGA TLAKA ZA MONITORJE. BREZ LATEKSA, BARVNO OZNAČENE LINIJE.(PVB AGO005A ALI ENAKOVREDNO).	399345	KOM	2				
3	SISTEM ZA INVAZIVNO MERJENJE ARTERIJSKEGA TLAKA Z ZAPRTIM SISTEMOM JEMANJA VZORCEV,ZA MONITORJE. BREZ LATEKSA, BARVNO OZNAČENE LINIJE.(PVB AGO005H ALI ENAKOVREDNO).	477141	KOM	1.386				
4	SISTEM ZA VZPOREDNO INVAZ. MERJENJE TREH TLAKOV Z ZAPRTIM SIST. JEMANJA VZORCEV ARTER.KRVİ NA ENOJNI MANŠETI.POVEZ Z ENOJNIM KABLOM NA MONIT.BREZ LATEKSA,BARVNO OZNAČ.LINIJE (PVB AGO007H ALI ENAK.)	406031	KOM	316				
5	SISTEM ZA VZPOREDNO INVAZIVNO MERJENJE DVEH TLAKOV NA ENOJNI MANŠETI. ZAPRT SIST.JEMANJA VZORCEV ART.KRVİ.POVEZAVA NA MONIT.PREKO ENOJN.KABLA. BREZ LATEKSA,BARVNO OZNAČ.LINIJE (PVB AGO006H ALI ENAKOV)	406872	KOM	1.569				

ŽIG IN PODPIS:

SPECIFIKACIJA ZAHTEV NAROČNIKA

Predmet JN: **88 Medicinski potrošni material 2, 2016-2018**
13 ANESTEZIJA.Supraglotični pripomočki-100% sk.GLEJ PRIL.1

CPV: 33196000

Z.Š.	Naziv artikla	ident JN	EM	Razp. kol. za 12 mes	Pakir.	Proizvajalec	Zaščiteno ime	Kataloška številka
1	LARINGEALNE MASKE, I-GEL ZA INTUB.,OTROŠKE (INTERSURGICAL 8201 ALI ENAKOVREDNO.	807281	KOM	49				
2	LARINGEALNE MASKE, I-GEL ZA INTUB.,OTROŠKE (INTERSURGICAL 8202 ALI ENAKOVREDNO)	807303	KOM	81				
3	LARINGEALNE MASKE, I-GEL ZA INTUB.,OTROŠKE (INTERSURGICAL 8215 ALI ENAKOVREDNO)	807290	KOM	73				
4	LARINGEALNE MASKE, I-GEL ZA INTUB.,OTROŠKE (INTERSURGICAL 8225 ALI ENAKOVREDNO)	807311	KOM	89				
5	MASKA LARINGEALNA ŠT.1 ZA 1XUPORABO.	663085	KOM	2				
6	MASKA LARINGEALNA ŠT.1,5 ZA 1XUPORABO.	659452	KOM	2				
7	MASKA LARINGEALNA ŠT.2 ZA 1XUPORABO.	663077	KOM	2				
8	MASKA LARINGEALNA ŠT.2,5 ZA 1XUPORABO.	675563	KOM	2				
9	MASKA LARINGEALNA ŠT.3 ,ZA 1 XUPORABO.	664596	KOM	2				
10	MASKA LARINGEALNA ŠT.4,1X UPORABO.	664588	KOM	2				
11	MASKA LARINGEALNA ŠT.5,1X UPORABO.	664600	KOM	2				
12	MASKA LARINGEALNA ŠT:1,prilagojena uporabi v področju magnetnega polja,brez vsebnosti kovine.	424153	KOM	2				
13	MASKA LARINGEALNA ŠT:1,5,prilagojena uporabi v področju magnetnega polja,brez vsebnosti kovine.	424170	KOM	2				
14	MASKA LARINGEALNA ŠT:2,prilagojena uporabi v področju magnetnega polja,brez vsebnosti kovine.	424161	KOM	2				
15	MASKA LARINGEALNA ŠT:2,5,prilagojena uporabi v področju magnetnega polja,brez vsebnosti kovine.	424188	KOM	2				
16	MASKA LARINGEALNA ŠT:3,prilagojena uporabi v področju magnetnega polja,brez vsebnosti kovine.	424196	KOM	2				
17	MASKA LARINGEALNA ŠT:4-,prilagojena uporabi v področju magnetnega polja,brez vsebnosti kovine.	424200	KOM	2				
18	MASKA LARINGEALNA ŠT:5,prilagojena uporabi v področju magnetnega polja,brez vsebnosti kovine.	531669	KOM	2				

SPECIFIKACIJA ZAHTEV NAROČNIKA

Predmet JN: **88 Medicinski potrošni material 2, 2016-2018**
13 ANESTEZIJA.Supraglotični pripomočki-100% sk.GLEJ PRIL.1

CPV: 33196000

Z.Š.	Naziv artikla	ident JN	EM	Razp. kol. za 12 mes	Pakir.	Proizvajalec	Zaščiteno ime	Kataloška številka
19	OPTIČNI LARINGOSKOP ZA 1XUP. S KANALOM ZA VSTAV.IN UVAJ.TUBUSA.VSEBUJE BATERIJE,NOTRANJI OPTIČNI KANAL KI OMOGOČA POGLED V SMERI KONICE TUBUSA,OGREV.PROTI KOND.ZA TUB.6-7,5.(AIRTRAQ A-021ALI ENAKOVREDN.).	749109	KOM	2				
20	OPTIČNI LARINGOSKOP ZA 1XUP. S KANALOM ZA VSTAVITEV IN UVAJANJE TUBUSA.VSEBUJE BATERIJE,NOT.OPTIČNI KANAL KI OMOGOČA POGLED V SMERI KONICE TUBUSA.OGREV.PROTI KON.TUB.7-8.(AIRTRAQ:A-011 ALI ENAKOVREDN.).	749095	KOM	10				
21	OPTIČNI LARINGOSKOP ZA 1XUP.S KANALOM ZA VSTAV.IN UVAJ.TUBUSA.VSEBUJE BATERIJE,NOT.OPTIČNI KAN.KI OMOGOČA POGL.V SMERI KON.TUBUSA-OGREVAN,ZA NAZOGASTRIČ.TUBUSE.(AIRTRAQ:A-051 ALI ENAKOVREDNO).	770094	KOM	2				
22	OPTIČNI LARINGOSKOP ZA 1XUP.S KANALOM ZA VSTAV.IN UVAJ.TUBUSA.VSEBUJE BATERIJE,NOT.OPTOČ.KANAL KI OMOGOČA POGL.V SMERI KON.TUBUSA.OGREVAN.ZA TUBUS OD.2,5-4,00.(AIRTRAQ:A-041 ALI ENAKOVREDNO).	770086	KOM	2				
23	OPTIČNI LARINGOSKOP ZA 1XUP.S KANALOM ZA VSTAVITEV IN UVAJ.TUBUSA.VSEBUJE BATERIJE.NOT.OPT.KANAL OMOGOČA POGLED V SMERI KONICE TUBUSA,OGREVAN ZA TUB.4-5,5.(AIRTRAQ:A-031 ALI ENAKOVREDNO).	770078	KOM	3				
24	SUPRAGLOTIČNI PRIPOMOČEK ZA ODPRTJE DIHALNIH POTI ZA 1 X UPORABO Z NENAPIHLJIVIM MEŠIČKOM, VELIKOST ŠT.5. (INTERSURGICAL-I-GELO2:8705 ALI ENAKOVREDNO).	730661	KOM	345				
25	SUPRAGLOTIČNI PRIPOMOČEK ZA ODPRTJE DIHALNIH POTI ZA 1 X UPORABO Z NENAPIHLJIVIM MEŠIČKOM,VELIKOST ŠT:3. (INTERSURGICAL-I-GELO2:8703 ALI ENAKOVREDNO).	730645	KOM	284				
26	SUPRAGLOTIČNI PRIPOMOČEK ZA ODPRTJE DIHALNIH POTI ZA 1 X UPORABO Z NENAPIHLJIVIM MEŠIČKOM. VELIKOST ŠT.4. (INTERSURGICAL-I-GELO2:8704 ALI ENAKOVREDNO).	730653	KOM	1.004				

ŽIG IN PODPIS:

SPECIFIKACIJA ZAHTEV NAROČNIKA

Predmet JN: **88 Medicinski potrošni material 2, 2016-2018**
14 ANESTEZIJA.Tubusi endotrahealni-PVC-100% sk.

CPV: 33196000

Z.Š.	Naziv artikla	ident JN	EM	Razp. kol. za 12 mes	Pakir.	Proizvajalec	Zaščiteno ime	Kataloška številka
1	TUBUS TRAHEALNI 7,0MM-ZUNANJI PREMER DO 9,6MM, Z NIZKOT. MEŠIČKOM IN MRPHY. OČESOM-VELIKIM VOLUM,GRADUIRAN,RADIOPAČEN,KONICA ATRAUM. OBLIKOV,MATERIAL-PVC,GLADKA NOTR. POVRŠINA	477427	KOM	778				
2	TUBUS TRAHEALNI 7,5MM-ZUNANJI PREMER DO 10,2MM,Z NIZKOT. MEŠIČKOM IN MPRHY. OČESOM-VELIKIM VOLUM,GRADUIRAN,RADIOPAČEN,KONICA ASTRAUM. OBLIKOV,MATERIAL-PVC.GLADKA NOTR. POVRŠINA,	482722	KOM	1.654				
3	TUBUS TRAHEALNI 8,0MM-ZUNANJI PREMER DO 11,0MM, Z NIZKOT.MEŠIČKOM IN MRPHY. OČESOM-VELIKIM VOLUM,GRADUIRAN,RADIOPAČEN,KONICA ATRAUM. OBLIK,MATERIAL-PVC.GLADKA NOTR. POVRŠINA,	477435	KOM	555				
4	TUBUS TRAHEALNI 8,5MM-ZUNANJI PREMER DO 11,6MM, Z NIZKOT. MEŠIČKOM MRPHY. OČESOM-VELIKIM VOLUM,GRADUIRAN,RADIOPAČEN,KONICA ATRAUM.OBLIK.MATERIAL-PVC.GLADKA NOTR. POVRŠINA,	470503	KOM	1.334				
5	TUBUS TRAHEALNI 9,0MM-ZUNANJI PREMER DO 12,3MM, Z NIZKOT. MEŠIČKOM IN MPRHY.-VELIKIM VOLUM,GRADUIRAN,RADIOPAČEN,KONICA ATRAUM. OBLIKOV,MATERIAL-PVC.GLADKA NOTR. POVRŠINA,	565016	KOM	49				

ŽIG IN PODPIS:

SPECIFIKACIJA ZAHTEV NAROČNIKA

Predmet JN: **88 Medicinski potrošni material 2, 2016-2018**
15 ANESTEZIJA.Tubusi endotrahealni-PVC silikoniziran-100% sk.

CPV: 33196000

Z.Š.	Naziv artikla	ident JN	EM	Razp. kol. za 12 mes	Pakir.	Proizvajalec	Zaščiteno ime	Kataloška številka
1	TRAK SAMOLEPILNI ZA PRITRDITEV TUBUSA.(DALE 270 ALI ENAKOVREDNO).	472379	KOM	1.691				
2	TUBUS TRAHEALNI 5,0MM- ZUNANJI PREMIER DO 6,9MM,,Z NIZKOTLAČNIM MESIČKOM IN VELIKIM VOLUM, MRPHY. OČESOM,GRADUIRAN,RADIOPAČEN,ATRAUMATSKA KONICA-PVC-SILIKONIZ.GLADKA NOTRA.POVRŠ,	344907	KOM	73				
3	TUBUS TRAHEALNI 5,5MM-ZUNANJI PREMIER DO 7,5MM,Z NIZKOTLAČNIM MESIČKOM IN VELIKIM VOLUM, MRPHY. OČESOM,GRADUIRAN,RADIOPAČEN,ATRAUMATSKA KONICA-PVC-SILIKONIZ.GLADKA POVRŠINA,	325902	KOM	81				
4	TUBUS TRAHEALNI 6.0MM-ZUNAJI PREMIER DO 8,2MM,Z NIZKOTL. MESIČKOM IN VELIKIM VOLUM, Z MRPHY. OČESOM,GRADUIRAN,RADIOPAČEN,ATRAUM. KONICA -PVC-SILIKONIZ.GLADKA NOTRAN POVRŠINA,	344893	KOM	65				
5	TUBUS TRAHEALNI 6.5MM-ZUNAJI PREMIER DO 8,8MM,Z NIZKOT. MESIČKOM IN VELIKIM VOLUM, Z MRPHY. OČESOM,GRADU.,RADIOPAČEN,ATRAUM. KONICA- PVC-SILIKONIZIRAN. GLADKA NOTRA. POVRŠINA,	344842	KOM	49				
6	TUBUS TRAHEALNI 7,0MM-ZUNANJI PREMIER DO 9,6MM,Z NIZKOTL. MESIČKOM IN VELIKIM VOLUM. IN MRPHY. OČESOM,GRADUIRAN,RADIOPAČEN,ATRAUM. KONICA-PVC -SILIKONIZ.GLADKA NOTR. POVRŠINA,	629197	KOM	81				
7	TUBUS TRAHEALNI 7.5MM-ZUNANJI PREMIER DO 10,2MM,Z NIZKOT. MESIČKOM IN VELIKIM VOLUM,GRADUIRAN,MRPHY. OČESOM,RADIOPAČEN,ATRAUM. KONICA-PVC-SILIKON. GLADKA NOTRANJA POVRŠINA,	629219	KOM	25				
8	TUBUS TRAHEALNI 8,0MM-ZUNANJI PREMIER DO 11,0MM,,Z NIZKOTL. MESIČKOM IN VELIKIM VOLUM, MPRHY. OČESOM,GRADUIRAN,RADIOPAČEN,ATRAUMA KONICA-PVC-SILIKON.GLADKA NOTRANJA POVRŠINA,	629227	KOM	33				
9	TUBUS TRAHEALNI 8.5MM-ZUNANJI PREMIER DO 11,6MM, Z NIZKOTL.MESIČKOM IN VELIKIM VOLUM, MRPHY. OČESOM,GRADUIRAN,RADIOPAČEN,ATRAUM. KONICA-PVC -SILIKON.GLADKA NOTRANJA POVRŠINA,	629235	KOM	73				
10	TUBUS TRAHEALNI 9.0MM-ZUNANJI PREMIER DO 12,3MM, Z NIZKOTL. MESIČKOM IN VELIKIM VOLUM, MRPHY. OČESOM,GRADUIRAN,RADIOPAČEN,ATRAUM. KONICA-PVC-SILIKON.GLADKA NOTRANJ POVRŠINA,	629243	KOM	65				
11	VODILO ZA TUBUS 2,0-3,5MM.(SMITHS-PORTEX 100/120/100 ALI ENAKOVREDNO).	432911	KOM	33				

SPECIFIKACIJA ZAHTEV NAROČNIKA

Predmet JN: **88 Medicinski potrošni material 2, 2016-2018****15 ANESTEZIJA.Tubusi endotrahealni-PVC silikoniziran-100% sk.**

CPV: 33196000

Z.Š.	Naziv artikla	ident JN	EM	Razp. kol. za 12 mes	Pakir.	Proizvajalec	Zaščiteno ime	Kataloška številka
12	VODILO ZA TUBUS 4,0MM/335MM. GLADKA NOTRANJ POVRŠINA, OB ENAKEM PREMURU LUMNA TUBUSA ČIM MANJŠI ZUNANJI PREMER.	432903	KOM	138				
13	VODILO ZA TUBUS 6,5-10MM. GLADKA NOTRANJ POVRŠINA, OB ENAKEM PREMURU LUMNA TUBUSA ČIM MANJŠI ZUNANJI PREMER.	432890	KOM	356				

ŽIG IN PODPIS:

SPECIFIKACIJA ZAHTEV NAROČNIKA

Predmet JN: **88 Medicinski potrošni material 2, 2016-2018**
16 ANESTEZIJA.Tubusi endotraheal.ojačani z jekleno žic.100%*s*

CPV: 33196000

Z.Š.	Naziv artikla	ident JN	EM	Razp. kol. za 12 mes	Pakir.	Proizvajalec	Zaščiteno ime	Kataloška številka
1	TUBUS SPIRALNI 5,0MM-ZUNANJI PREMIER DO 7,3MM;GRADUIRAN,Z NIZKOTLAČNIM-VELIKIM MEŠIČKOM,ZA ORALNO IN NASALNO INTUBACIJO,ATRAUM. KONICA , MATERIAL PVC.GLADKA NOTR.POVRŠINA,	384569	KOM	29				
2	TUBUS SPIRALNI 5,5MM-ZUNANJI PREMIER 8,0MM;GRADUIRAN,Z NIZKOT.-VELIKIM MEŠIČKOM,ZA ORALNO IN NASALNO INTUBACIJO,ATRAUM. KONICA , MATERIAL PVC.GLADKA NOTRANJA POVRŠINA,	384577	KOM	29				
3	TUBUS SPIRALNI 6,0MM-ZUNANJI PREMIER DO 8,7MM;GRADUIRAN,Z NIZKOT.-VELIKIM MEŠIČKOM,ZA ORALNO IN NASALNO INTUBACIJO,ATRAUM. KONICA , MATERIAL PVC.GLADKA NOTRANJA POVRŠINA,	344885	KOM	29				
4	TUBUS SPIRALNI 6,5MM-ZUNANJI PREMIER 9,4MM;GRADUIRAN,Z NIZKOT.-VELIKIM MEŠIČKOM,ZA ORALNO IN NASALNO INTUBACIJO,ATRAUM. KONICA , MATERIAL PVC.GLADKA NOTRA. POVRŠINA,	344877	KOM	73				
5	TUBUS SPIRALNI 7,0MM-ZUNANJI PREMIER DO 10,0MM;GRADUIRAN,Z NIZKOT.-VELIKIM MEŠIČKOM,ZA ORALNO IN NASALNO INTUBACIJO,ATRAUMA. KONICA , MATERIAL PVC.GLADKA NOTRAN. POVRŠINA,	343102	KOM	341				
6	TUBUS SPIRALNI 7,5MM-ZUNANJI PREMIER DO 10,4MM;GRADUIRAN,Z NIZKOT.-VELIKIM MEŠIČKOM,ZA ORALNO IN NASALNO INTUBACIJO,ATRAUM. KONICA,MATERIAL PVC.GLADKA NOTR. POVRŠINA,	318477	KOM	665				
7	TUBUS SPIRALNI 8,0MM-ZUNANJI PREMIER 11,0MM;GRADUIRAN,Z NIZKOT.-VELIKIM MEŠIČKOM,ZA ORALNO IN NASALNO INTUBACIJO ,ATRAUM. KONICA,MATERIAL PVC.GLADKA NOTRANJA POVRŠINA,	343099	KOM	410				
8	TUBUS SPIRALNI 8,5MM-ZUNANJI PREMIER DO 11,8MM;GRADUIRAN,Z NIZKOT.-VELIKIM MEŠIČKOM,ZA ORALNO IN NASALNO INTUBACIJO,ATRAUMATSKA KONICA , MATERIAL PVC. GLADKA NOTR. POVRŠINA,	344869	KOM	616				
9	TUBUS SPIRALNI 9,0MM-ZUNANJI PREMIER DO 12,3MM;GRADUIRAN,Z NIZKOT.-VELIKIM MEŠIČKOM,ZA ORALNO IN NASALNO INTUBACIJO,ATRAUM. KONICA,MATERIALPVC. GLADKA NOTRANJA POVRŠINA,	342947	KOM	2				

ŽIG IN PODPIS:

SPECIFIKACIJA ZAHTEV NAROČNIKA

Predmet JN: **88 Medicinski potrošni material 2, 2016-2018**
17 ANESTEZIJA.Tubusi endotraheal.in traheostom.-silikon.-100%

CPV: 33196000

Z.Š.	Naziv artikla	ident JN	EM	Razp. kol. za 12 mes	Pakir.	Proizvajalec	Zaščiteno ime	Kataloška številka
1	TUBUS ENDOTRHEALNI, ZA LASERSKE POSEGE V ORL OBMOČJU. VELIKOST 4; 5 IN 6 MM (MEDTRONIC 7060100... ALI ENAKOVREDNO).	821381	KOM	4				
2	TUBUS 2,5 ;ENDOTRAHEALNI,SILIKONSKI,SPIRALNI, GRADUIRAN,RADIOPAČEN,S SILIKONSKIM MEŠIČKOM , GLADKA NOTRA. POVRŠINA, OB ENAKEM PREMERU LUMNA TUBUSA ČIM MANJŠI ZUN. PREMER.(BIVONA 35W25 ALI ENAKOVREDNO).	426652	KOM	2				
3	TUBUS 3,0 ;ENDOTRAHEALNI,SILIKONSKI,SPIRALNI,GRADUIRAN,RADIOPAČEN ,S SILIKONSKIM MEŠIČKOM , GLADKA NOTR. POVRŠINA, OB ENAKEM PREMERU LUMNA TUBUSA ČIM MANJŠI ZUNANJI PREM. (BIVONA 35W30 ALI ENAKOVREDNO).	426717	KOM	2				
4	TUBUS 3,5 ;ENDOTRAHEALNI,SILIKONSKI,SPIRALNI,GRADUIRAN,RADIOPAČEN ,S SILIKONSKIM MEŠIČKOM , GLADKA NOTRANJA POVRŠINA,OB ENAKEM PREMERU LUMNA TUBUSA ČIM MANJŠI ZUNANJI PREME. (BIVONA 35W35 ALI ENAKOVREDNO).	301752	KOM	33				
5	TUBUS 4,0 ;ENDOTRAHEALNI,SILIKONSKI,SPIRALNI,GRADUIRAN,RADIOPAČEN ,S SILIKONSKIM MEŠIČKOM , GLADKA NOTR. POVRŠINA, OB ENAKEM PREMERU LUMNA TUBUSA ČIM MANJŠI ZUNANJI PREM. (BIVONA 35W40 ALI ENAKOVREDNO).	426725	KOM	16				
6	TUBUS 4,5 ;ENDOTRAHEALNI, SPIRALNI,GRADUIRAN,RADIOPAČEN,S SILIKONSKIM MEŠIČKOM , GLADKA NOTRANJA POVRŠINA, OB ENAKEM PREMERU LUMNA TUBUSA ČIM MANJŠI ZUNANJI PREMER.(BIVONA 35W45 ALI ENAKOVREDNO).	500135	KOM	33				

ŽIG IN PODPIS:

SPECIFIKACIJA ZAHTEV NAROČNIKA

Predmet JN: **88 Medicinski potrošni material 2, 2016-2018**
18 ANESTEZIJA.Tubus guedel-100% sk.

CPV: 33196000

Z.Š.	Naziv artikla	ident JN	EM	Razp. kol. za 12 mes	Pakir.	Proizvajalec	Zaščiteno ime	Kataloška številka
1	GUEDEL VELIKOST 0, PRIPOMOČEK ZA OHRANJANJE DIHALNIH POTI.IZDELAN IZ ENEGA DELA BREZ DODATNIH SESTAVNIH DELOV .BARVNA OZNAKA VELIKOSTI,POSAMEZNO PAKIRAN,ČIST. (INTERSURGICAL 1110055 ALI ENAKOVREDNO).	423041	KOM	2				
2	GUEDEL VELIKOST 00, PRIPOMOČEK ZA OHRANJANJE DIHALNIH POTI.IZDELAN IZ ENAGA DELA BREZ DODATNIH SESTAVNIH DELOV.BARVNA OZNAKA VELIKOSTI,POSAMEZNO PAKIRAN,ČIST. (INTERSURGICAL 1100050 ALI ENAKOVREDNO).	423050	KOM	2				
3	GUEDEL VELIKOST 000, PRIPOMOČEK ZA OHRANJANJE DIHALNIH POTI.IZDELAN IZ ENEGA DELA BREZ DODATNIH SESTAVNIH DELOV.BARVNA OZNAKA VELIKOSTI,POSAMEZNO PAKIRAN,ČIS. (:INTERSURGICAL 1000035 ALI ENAKOVREDNO).	439576	KOM	2				
4	GUEDEL VELIKOST 1-ZA OHRANJANJE DIHALNIH POTI.IZDELAN IZ ENEGA DELA BREZ DODATNIH SESTAVNIH DELOV.BARVNA OZNAKA VELIKOSTI, POSAMEZNO PAKIRAN,ČIST.(INTERSURGICAL 1111065 ALI ENAKOVREDNO).	423033	KOM	2				
5	GUEDEL VELIKOST 2-PRIPOMOČEK ZA OHRANJANJE DIHALNIH POTI.IZDELAN IZ ENEGA SAMEGA DELA BREZ DODATNIH SESTAVNIH DELOV.BARVNA OZNAKA VELIKOSTI,POSAMEZNO PAKIRAN,ČIST.(INTERSURG.1112080 ALI ENAKOVREDNO).	388785	KOM	2.838				
6	GUEDEL VELIKOST 3-PRIPOMOČEK ZA OHRANJANJE DIHALNIH POTI.IZDELAN IZ ENEGA DELA BREZ DODATNIH SESTAVNIH DELOV.BARVNA OZNAKA VELIKOSTI,POSAMEZNO PAKIRAN,ČIST. (INTERSURGICAL 1113090 ALI ENAKOVREDNO).	421715	KOM	1.476				
7	GUEDEL VELIKOST 4-PRIPOMOČEK ZA OHRANJANJE DIHALNIH POTI.IZDELAN IZ ENEGA DELA BREZ DODATNIH SESTAVNIH DELOV.BARVNA OZNAKA VELIKOSTI ,POSAMEZNO PAKIRAN,ČIST. (INTERSURGICAL 1114100 ALI ENAKOVREDNO).	421723	KOM	65				

ŽIG IN PODPIS:

SPECIFIKACIJA ZAHTEV NAROČNIKA

Predmet JN: **88 Medicinski potrošni material 2, 2016-2018**
19 ANESTEZIJA.Tubusi rae-PVC-100%sk.

CPV: 33196000

Z.Š.	Naziv artikla	ident JN	EM	Razp. kol. za 12 mes	Pakir.	Proizvajalec	Zaščiteno ime	Kataloška številka
1	TUBUS RAE ORAL 4,0;ORALNI Z VELIKIM MEŠIČKOM-NIZKIM TLAKOM, UKRIVLJEN ZA OP.POSEG NA OBRAZU,VRATU IN V USTIH,RADIOPAČEN,GRDUIRAN,ATRAVMATSKA KONICA-PVC	318485	KOM	41				
2	TUBUS RAE ORAL 4,5;ORALNI Z VELIKIM MEŠIČKOM-NIZKIM TLAKOM, UKRIVLJEN ZA OP.POSEG NA OBRAZU,VRATU IN V USTIH,RADIOPAČEN, GRADUIRAN, ATRAVMATSKA KONICA-PVC	342904	KOM	154				
3	TUBUS RAE ORAL 5,0;ORALNI Z VELIKIM MEŠIČKOM-NIZKIM TLAKOM, UKRIVLJEN ZA OP.POSEG NA OBRAZU VRATU IN V USTIH,RADIOPAČEN,GRADUIRAN, ATRAVMATSKA KONICA-PVC	344788	KOM	97				
4	TUBUS RAE ORAL 5,5;ORALNI Z VELIKIM MEŠIČKOM-NIZKIM TLAKOM, UKRIVLJEN ZA OP.POSEG NA OBRAZU,VRATU IN V USTIH,RADIOPAČEN,GRADUIRAN, ATRAVMATSKA KONICA-PVC	342882	KOM	65				
5	TUBUS RAE 6.0-8.0MM ;NAZALNI Z VELIKIM MEŠIČKOM-NIZKIM TLAKOM, UKRIVLJEN ZA OP. POSEG NA VRATU,OBRAZU IN V UST,RADIOPAČEN, GRADUIRAN, ATRAUM. KONICA-PVC	426695	KOM	41				

ŽIG IN PODPIS:

SPECIFIKACIJA ZAHTEV NAROČNIKA

Predmet JN: **88 Medicinski potrošni material 2, 2016-2018****21 MEDICIN.REHABIL.Elektrode za aparat "BIEGLER"-100% sk.**

CPV: 33196000

Z.Š.	Naziv artikla	ident JN	EM	Razp. kol. za 12 mes	Pakir.	Proizvajalec	Zaščiteno ime	Kataloška številka
1	ELEKTRODA HERPEX-ANODA 13MM ZA APARAT "BIEGLER". (BIEGLER FE1003013 ALI ENAKOVREDNO).	342157	KOM	41				
2	ELEKTRODA HERPEX-ANODA 25MM ZA APARAT "BIEGLER". (BIEGLER FE 1003025 ALI ENAKOVREDNO).	561541	KOM	130				
3	ELEKTRODA HERPEX-KATODA ZA APARAT "BIEGLER".(BIEGLER FE103026 ALI ENAKOVREDNO).	254550	KOM	956				

ŽIG IN PODPIS:

SPECIFIKACIJA ZAHTEV NAROČNIKA

Predmet JN: **88 Medicinski potrošni material 2, 2016-2018**
22 NEVROKIR.OP.Implantati "Cervios Chronos"-100%sk.

CPV: 33196000

Z.Š.	Naziv artikla	ident JN	EM	Razp. kol. za 12 mes	Pakir.	Proizvajalec	Zaščiteno ime	Kataloška številka
1	CERVIKALNI MEDVREtenČNI IMPLANTI-CERVIOS CHRONOS 5MM, 870.931S (SYNTHESES ali enakovredno).	707180	KOM	2				
2	CERVIKALNI MEDVREtenČNI IMPLANTI-CERVIOS CHRONOS 6MM,KLIN.CER.KL.(SYNTHESES 870.922S ali enakovredno).	705560	KOM	6				
3	CERVIKALNI MEDVREtenČNI IMPLANTI-CERVIOS CHRONOS 7MM,KLIN.CER.KL.(SYNTHESES 870.923S ali enakovredno).	705578	KOM	7				
4	CERVIKALNI MEDVREtenČNI IMPLANTI-CERVIOS CHRONOS 8MM,KLIN.CER.KL.(SYNTHESES 870.924S ali enakovredno).	705586	KOM	2				
5	CERVIKALNI MEDVREtenČNI IMPLANTI-CERVIOS CHRONOS 8MM,ZAOB.CER.KL.(SYNTHESES 870.934S ali enakovredno).	705527	KOM	2				
6	CERVIKALNI MEDVREtenČNI IMPLANTI-CERVIOS CHRONOS 9MM,KLIN.CER.KL.(SYNTHESES 870.925S ali enakovredno).	705594	KOM	2				
7	CERVIKALNI MEDVREtenČNI IMPLANTI-CERVIOS CHRONOS 9MM,ZAOB.CER.KL.(SYNTHESES 870.935S ali enakovredno).	705535	KOM	2				
8	CERVIKALNI MEDVREtenČNI IMPLANTI-CERVIOS CHRONOS 10MM,KLIN.CER.KL.(SYNTHESES 870.926S ali enakovredno).	705608	KOM	2				
9	CERVIKALNI MEDVREtenČNI IMPLANTI-CERVIOS CHRONOS 10MM,ZAOB.CER.KL.(SYNTHESES 870.936S ali enakovredno).	705543	KOM	2				
10	CERVIKALNI MEDVREtenČNI IMPLANTI-CERVIOS CHRONOS,5MM,KLIN.CER.KL.(SYNTHESES 870.921 ali enakovredno).	705551	KOM	5				
11	CERVIKALNI MEDVREtenČNI IMPLANTI-CERVIOS CHRONOS,5MM,ZAOB.CERV.KL.(SYNTHESES 870.931 ali enakovredno).	705489	KOM	7				
12	CERVIKALNI MEDVREtenČNI IMPLANTI-CERVIOS CHRONOS,6MM,ZAOB.CERV.KL.(SYNTHESES 870.932 ali enakovredno).	705497	KOM	5				
13	CERVIKALNI MEDVREtenČNI IMPLANTI-CERVIOS CHRONOS,7MM,ZAOB.CERV.KL.(SYNTHESES 870.933 ali enakovredno).	705519	KOM	2				

ŽIG IN PODPIS:

SPECIFIKACIJA ZAHTEV NAROČNIKA

Predmet JN: **88 Medicinski potrošni material 2, 2016-2018**
23 NEVROKIR.OP.Osteokonduktivni nadomestki-100%sk.

CPV: 33196000

Z.Š.	Naziv artikla	ident JN	EM	Razp. kol. za 12 mes	Pakir.	Proizvajalec	Zaščiteno ime	Kataloška številka
1	CHRONOS BLOK 12,5 X 12,5 X 10MM. (SYNTHESES 07.720.045 ali enakovredno).	731706	KOM	2				
2	CHRONOS BLOK 20 X 20 X 10MM.(SYNTHESES 07.720.047 ali enakovredno).	731714	KOM	2				
3	CHRONOS GRANULE DIA.0.5-0.7MM.(SYNTHESES 710.000S ali enakovredno).	419982	KOM	2				
4	CHRONOS GRANULE DIA.0.7-1.4MM.(SYNTHESES 710.001S ali enakovredno).	418773	KOM	2				
5	CHRONOS GRANULE DIA.0.7-1.4MM.(SYNTHESES 710.002S ali enakovredno).	418790	KOM	2				
6	CHRONOS GRANULE DIA.1,4-2,8MM.(SYNTHESES 710-019S ali enakovredno).	710610	KOM	4				
7	CHRONOS GRANULE DIA.1.4-2.8MM.(SYNTHESES 710.014S ali enakovredno).	327760	KOM	5				
8	CHRONOS GRANULE DIA.2,8-5,6MM.(SYNTHESES 710-026S ali enakovredno).	710628	KOM	2				
9	CHRONOS GRANULE DIA.2.8-5.6MM.(SYNTHESES 710.025S ali enakovredno).	671444	KOM	2				
10	CHRONOS INJECT 10,0CCM.(SYNTHESES 710.067S ali enakovredno).	731765	KOM	2				
11	CHRONOS INJECT 2,5CCM.(SYNTHESES 710.065S ali enakovredno).	731749	KOM	2				
12	CHRONOS INJECT 5,0CCM.(SYNTHESES 710.066S ali enakovredno).	731757	KOM	2				

ŽIG IN PODPIS:

SPECIFIKACIJA ZAHTEV NAROČNIKA

Predmet JN: **88 Medicinski potrošni material 2, 2016-2018**
24 NEVROKIR.OP.Nevrokirurške vatices-100%sk.

CPV: 33196000

Z.Š.	Naziv artikla	ident JN	EM	Razp. kol. za 12 mes	Pakir.	Proizvajalec	Zaščiteno ime	Kataloška številka
1	NEVROKIRURŠKE VATICE 10 X 30MM,BREZ RTG NITI , BREZ DODATKA ZA PRIJEMANJE S PRIJEMALKO, MATERIAL BOMBAŽ SOFT , SC = 200KOM	658669	SC	4				
2	NEVROKIRURŠKE VATICE 13 X 25MM,BREZ RTG NITI , BREZ DODATKA ZA PRIJEMANJE S PRIJEMALKO, MATERIAL BOMBAŽ SOFT , SC =200KOM	658642	SC	2				
3	NEVROKIRURŠKE VATICE 13 X 38MM,BREZ RTG NITI, BREZ DODATKA ZA PRIJEMANJE S PRIJEMALKO, MATERIAL BOMBAŽ SOFT , SC =200KOM	658677	SC	2				
4	NEVROKIRURŠKE VATICE 13 X 51MM,BREZ RTG NITI, BREZ DODATKA ZA PRIJEMANJE S PRIJEMALKO, MATERIAL BOMBAŽ SOFT , SC=200KOM	658626	SC	23				
5	NEVROKIRURŠKE VATICE 15 X 50MM,BREZ RTG NITI, BREZ DODATKA ZA PRIJEMANJE S PRIJEMALKO, MATERIAL BOMBAŽ SOFT , SC=200KOM	658634	SC	7				
6	NEVROKIRURŠKE VATICE 76X152MM,BREZ RTG NITI,BREZ DODATKA ZA PRIJEMANJE S PRIJEMALKO, MATERIAL BOMBAŽ SOFT. SC=200KOM	658685	SC	2				

ŽIG IN PODPIS:

SPECIFIKACIJA ZAHTEV NAROČNIKA

Predmet JN: **88 Medicinski potrošni material 2, 2016-2018**
25 ORL IN MFK OP. Kanile traheostomijske.-100%sk.

CPV: 33196000

Z.Š.	Naziv artikla	ident JN	EM	Razp. kol. za 12 mes	Pakir.	Proizvajalec	Zaščiteno ime	Kataloška številka
1	KANILA TRAHEOSTOMIJSKA 6,0; SILIKONSKI,S PENASTO POLNJENIM SILIKONSKIM MEŠIČKOM , GLADKA NOTRANJA POVRŠINA, OB ENAKEM PREMERU LUMNA TUBUSA ČIM MANJŠI ZUNANJI PREMER.(BIVONA 850160 ALI ENAKOVREDNO).	383775	KOM	2				
2	KANILA TRAHEOSTOMIJSKA 7,0; SILIKONSKI,ARMIRAN,S PENASTO POLNJENIM SILIKONSKIM MEŠIČKOM , GLADKA NOTR. POVRŠINA, OB ENAKEM PREMERU LUMNA TUBUSA ČIM MANJŠI ZUNANJI PREME.(BIVONA 850170 ALI ENAKOVREDNO).	383805	KOM	5				
3	KANILA TRAHEOSTOMIJSKA 8,0; SILIKONSKI,ARMIRAN,S PENASTO POLNJENIM SILIKONSKIM MEŠIČKOM , GLADKA NOTRAN. POVRŠINA, OB ENAKEM PREMERU LUMNA TUBUSA ČIM MANJŠI ZUNANJI PREM.(BIVONA 850180 ALI ENAKOVREDNO).	383813	KOM	49				
4	KANILA TRAHEOSTOMIJSKA 9,0; SILIKONSKI,ARMIRAN,S PENASTO POLNJENIM SILIKONSKIM MEŠIČKOM , GLADKA NOTR. POVRŠINA, OB ENAKEM PREMERU LUMNA TUBUSA ČIM MANJŠI ZUNANJI PREMER.(BIVONA 850190 ALI ENAKOVREDNO)	402427	KOM	4				
5	KANILA TRAHEOSTOMIJSKA 9,5; SILIKONSKI,ARMIRAN,S PENASTO POLNJENIM SILIKONSKIM MEŠIČKOM , GLADKA NOTR. POVRŠINA, OB ENAKEM PREMERU LUMNA TUBUSA ČIM MANJŠI ZUNANJI PREME.(BIVONA 850195 ALI ENAKOVREDNO)	408824	KOM	4				

ŽIG IN PODPIS:

SPECIFIKACIJA ZAHTEV NAROČNIKA

Predmet JN: **88 Medicinski potrošni material 2, 2016-2018**
26 OTROŠKI ODD. Tubusi trahealni,pvc,silikon.-100%sk.

CPV: 33196000

Z.Š.	Naziv artikla	ident JN	EM	Razp. kol. za 12 mes	Pakir.	Proizvajalec	Zaščiteno ime	Kataloška številka
1	TUBUS TRAHEALNI 2,0MM;BREZ MEŠIČKA,GRADUIRAN, ATRAVMATSKA KONICA,RADIOPAČEN- PVC-SILIKONIZIRAN. GLADKA NOTRANJA POVRŠINA, OB ENAKEM PREMERU LUMNA TUBUSA ČIM MANJŠI ZUNANJI PREMER.	220515	KOM	56				
2	TUBUS TRAHEALNI 2,5MM;BREZ MEŠIČKA,GRADUIRAN, ATRAVMATSKA KONICA,RADIOPAČEN - PVC-SILIKONIZIRAN. gLADKA NOTRANJA POVRŠINA, OB ENAKEM PREMERU LUMNA TUBUSA ČIM MANJŠI ZUNANJI PREMER.	344915	KOM	89				
3	TUBUS TRAHEALNI 3,0MM;BREZ MEŠIČKA,GRADUIRAN, ATRAVMATSKA KONICA,RADIOPAČEN - PVC-SILIKONIZIRAN. gLADKA NOTRANJA POVRŠINA, OB ENAKEM PREMERU LUMNA TUBUSA ČIM MANJŠI ZUNANJI PREMER.	342866	KOM	89				
4	TUBUS TRAHEALNI 3,5MM;BREZ MEŠIČKA,GRADUIRAN, ATRAVMATSKA KONICA,RADIOPAČEN - PVC-SILIKONIZIRAN. GLADKA NOTRANJA POVRŠINA, OB ENAKEM PREMERU LUMNA TUBUSA ČIM MANJŠI ZUNANJI PREMER.	385832	KOM	25				
5	TUBUS TRAHEALNI 4,5MM;BREZ MEŠIČKA,GRADUIRAN,RADIOPAČEN,ATRAUMATSKA KONICA-PVC-SILIKONIZIRAN. GLADKA NOTRANJA POVRŠINA, OB ENAKEM PREMERU LUMNA TUBUSA ČIM MANJŠI ZUNANJI PREMER.	477117	KOM	8				
6	TUBUS TRAHEALNI 4.0MM;BREZ MEŠIČKA,GRADUIRAN,RADIOPAČEN, ATRAUMATSKA KONICA-PVC-SILIKONIZIRAN. GLADKA NOTRANJA POVRŠINA, OB ENAKEM PREMERU LUMNA TUBUSA ČIM MANJŠI ZUNANJI PREMER.	477109	KOM	12				

ŽIG IN PODPIS:

SPECIFIKACIJA ZAHTEV NAROČNIKA

Predmet JN: **88 Medicinski potrošni material 2, 2016-2018**
31 Brizgalka. LUER-TRIDELNE.-100% sk.

CPV: 33196000

Z.Š.	Naziv artikla	ident JN	EM	Razp. kol. za 12 mes	Pakir.	Proizvajalec	Zaščiteno ime	Kataloška številka
1	BRIZGALKA LUER ZA 1XUP. 1 ML-TUBERKULINSKA SKALA(DOBRO ČITLJIVA),TRIDELNA-BREZ LATEKSA	407399	KOM	12.162				
2	BRIZGALKA LUER ZA 1XUP. 2 ML-2,5 ML,TRIDELNA-BREZ LATEKSA,OZNAKE ČITLJIVE,ODPORNE NA IZBRIS	327930	KOM	162.162				
3	BRIZGALKA LUER ZA 1XUP. 3 ML,TRIDELNA-BREZ LATEKSA,OZNAKE ČITLJIVE,ODPORNE NA IZBRIS	478237	KOM	162.162				
4	BRIZGALKA LUER ZA 1XUP. 5 ML,TRIDELNA-BREZ LATEKSA,OZNAKE ČITLJIVE,ODPORNE NA IZBRIS	327948	KOM	234.162				
5	BRIZGALKA LUER ZA 1XUP.10 ML,TRIDELNA-BREZ LATEKSA,OZNAKE ČITLJIVE,ODPORNE NA IZBRIS	143405	KOM	335.594				
6	BRIZGALKA LUER ZA 1XUP.20 ML ,TRIDELNA-BREZ LATEKSA,OZNAKE ČITLJIVE,ODPORNE NA IZBRIS	327956	KOM	206.757				
7	BRIZGALKA LUER ZA 1XUP.30ML,TRIDELNA-BREZ LATEKSA,OZNAKE ČITLJIVE,ODPORNE NA IZBRIS	485217	KOM	730				
8	BRIZGALKA S KATETERSKIM NASTAVKOM-50ML,ZA 1 X UP.TRIDELNA-BREZ LATEKSA,OZNAKA ČITLJIVA,ODPORN NA IZBRIS	301655	KOM	22.670				
9	BRIZGALKA LUER ZA 1XUP. 1ML,INSULINSKA SKALA-100 I.U.,DOBRO ČITLJIVA,TRI-DELNA,BREZ LATEKSA	482218	KOM	26.757				

ŽIG IN PODPIS:

SPECIFIKACIJA ZAHTEV NAROČNIKA

Predmet JN: **88 Medicinski potrošni material 2, 2016-2018****32 Brezigelne spojke,podaljški,vbodne igle s spojki.-100%sk.GL.PR.4**

CPV: 33196000

Z.Š.	Naziv artikla	ident JN	EM	Razp. kol. za 12 mes	Pakir.	Proizvajalec	Zaščiteno ime	Kataloška številka
1	DVOKANALI DEBEL.PODALJŠEK,Z DVEMA SPOJK.,KI JU NI MOGOČE ODSTRANITI.DOLŽ.12-13CM.VOL. MED 0,70-0,80ML (ICU MED. 011-C2205 ali enakovredno).	693995	KOM	41				
2	ICU BREZIGELNA SPOJKA, PROZORNA (TRANSPARENTNA).(ICU MEDICAL 011-MC100 ALI ENAKOVREDNO).	832952	KOM	4.540				
3	ICU CEV ZA ASPIRACIJOZDRAVIL S 5 MIKROMETR.FILTROM DOLŽ.MED 6 IN 6,5 CM.PREmera MED 2,5 IN 2,7MM.(ICU MEDICAL 011-CS-35 ALI ENAKOVREDNO).	833029	KOM	41				
4	ICU VMESNIK BREZIGELNI ZA ZAPORO BRIZGALKE ALI INFUZ.SISTEMA.PROZORNO OHIŠJE .PRETOK MED 125 IN 130 ML/MIN.MRTVI PROSTOR MAX.0,1ML.VMESNIK SE MORA OB ODK LOPU ZAPRETI (ICU MEDICAL CH2000 ALI ENAKOV.)	833045	KOM	8				
5	ICU VMESNIK ZA ČRPALKE.Z DVOKANALNO IGLO,ZRAČNI FILTER S POKROVOM,DVEMA SPOJKAMA ZA DOSTOP BREZ IGLE,Z ROBERTOVO ZAPONKO.DOLŽ. MED 30 IN32CM.POLNI TV.VOL.MED2 IN 2,5ML(ICU MEDICAL 011-H2923 ALI ENA.).	832987	KOM	1.784				
6	ICU-CLAVE INFUZIJSKI GRAVITACIJSKI SISTEM, OBARVAN, Z ENIM DOSTOPOM.PROZOREN DEL KOMORE,KI OMOGOČA NADZOR PRETOKA, DRUGI DEL KOMORE JE V CELOTI OBARAVAN(ICU MEDICAL 011-H2334 ALI ENAKOVREDNO).	829935	KOM	81				
7	ICU-CLAVE PODALJŠEK Z VBODNO IGLO, MIKRO CLAVE KONEKTOM, HIDROFOBNI FILTROM IN ZRAČENJEM (ICU MEDICAL 011-H1702 ALI ENAKOVREDNO).	829919	KOM	3.243				
8	ICU-CLAVE TANKA VBODNA IGLA (ICU MEDICAL 011-CS-53, ALI ENAKOVREDNO).	693898	KOM	2.148				
9	ICU-CLAVE VBODNA IGLA Z ZAŠČITNIM POKROVOM (ICU MEDICAL 011-CV-100 ALI ENAKOVREDNO).	693987	KOM	41				
10	ICU-CLAVE VBODNA IGLA, S CLAVE KONEKTOM IN DVEMA ZATIČKOMA (ICU MEDICAL 011-CS-50 ALI ENAKOVREDNO).	829943	KOM	689				
11	ICU-CLAVE VBODNA IGLA, S CLAVE KONEKTOM IN ZRAČNIM TER FILTROM ZA DELCE (ICU MEDICAL 011-CS-52 ALI ENAKOVREDNO).	829897	KOM	608				
12	ICU-CLAVE VMESNIK S ŠTIRIMI CLAVE KONEKTI, ZA INFUZIJSKO ČRPALKO (ICU MEDICAL 011-H2924 ALI ENAKOVREDNO).	829927	KOM	162				
13	PODALJŠEK DVOKANALNI (Y), Z 2 X MIKRO CLAVE SPOJKAMA, KI JU NI MOGOČE ODSTRANITI (ICU MED.011-MC3316 ali enakovredno).	694088	KOM	1.217				

SPECIFIKACIJA ZAHTEV NAROČNIKA

Predmet JN: **88 Medicinski potrošni material 2, 2016-2018****32 Brezigelne spojke,podaljški,vbodne igle s spojkm.-100%sk.GL.PR.4**

CPV: 33196000

Z.Š.	Naziv artikla	ident JN	EM	Razp. kol. za 12 mes	Pakir.	Proizvajalec	Zaščiteno ime	Kataloška številka
14	PODALJŠEK ENOKANALNI Z NEPROZORNO SPOJKO, Z MOŽNOSTJO ZAPORE.VOL.MED 0,25 IN 0,30ML.DOLŽ. MED 17,5 IN 18 CM.(ICU MEDICAL 011-MC3302 ALI ENAKOVREDNO).	832995	KOM	575				
15	PODALJŠEK ENOKANALNI, S SPOJKO, KI JE NI MOGOČE ODSTRANITI.DOLŽINA PODALJŠKA 17 DO 18 CM,VOL.0.60 DO 0,65 ML (ICU MEDIC.011-C2005 ali enakovredno).	693910	KOM	41				
16	PODALJŠEK S TREMI KONEKTI ZA DOSTOP BREZ IGLE,VOL.1,3-1,5ML,DOLŽ.24-25 CM.KONEKTI SI SLEDIJO V LINJI,PRVI PRETOK V OBE STRANI,OSTALA DVA PA OMOGOČATA SAMO INJICIRANJE T. (011-C4329-ICU ali enakovredno).	694118	KOM	81				
17	SPOJKA ZA DOSTOP BREZ IGLE S KONICO ZA PREBOD INF. STEKL.- OBARVANA (ICU MED.011-C3300G ali enakovredno).	693952	KOM	15.365				
18	SPOJKA ZA DOSTOP BREZ IGLE Z BARVNO OZNAKO,ZA ZAPIRANJE IN UPORABO KANALA,KI JE ŽE ZAPRT Z DRUGIM ZAPIRALOM KI NE VSEBUJE SPOJKE CLAVE, (011-C3300RR,ICU M. ali enakovredno).	694100	KOM	9.567				
19	SPOJKA ZA DOSTOP BREZ IGLE Z VBODNO KONICO S FILTROM ZA PREBOD INFUZIJSKIH STEKLENIC-TUDI ZA CITOSTATIKE, (ICU MEDICAL 011-CS-10B ali enakovredno).	693979	KOM	3.259				
20	SPOJKA ZA DOSTOP BREZ IGLE Z VBODNO KONICO S FILTROM 0.2 MIK.(ICU MEDICAL 011-CS-51 ali enakovredno).	693871	KOM	2.554				
21	SPOJKA ZA DOSTOP BREZ IGLE Z VBODNO KONICO Z NEPOVRATNO VALVULO, (ICU MEDICAL 011-CS-55 ali enakovredno).	693901	KOM	41				
22	SPOJKA ZA DOSTOP BREZ IGLE,NEPROZORNA.POLNITV.VOL.SPOJKE MAX. 0,035ML. PRETOK DO 620ML/MIN. (ICU MEDICAL D1000 ALI ENAKOVREDNO).	831590	KOM	41				
23	SPOJKA ZA DOSTOP BREZ IGLE,PROZORNA, Z FLUORESC.BARVNO OZNAKO VIDNO V TEMI.POLNITV.VOL. MAX. 0,1ML.PRETOK DO 100ML/MIN. (ICU MEDICAL 011-NC100 ALI ENAKOVREDNO)	694061	KOM	3.081				
24	ŠTIRIKANALNI PODALJŠEK S ŠTIRIMI SPOJK.ZA DOSTOP BREZ IGLE,DOLŽINA PODALJŠKA 19 DO 21CM,LL, VOL. MED 0,80 IN 1,00ML. (ICU MEDICAL 011-H2742 ali enakovredno).	694053	KOM	284				
25	T-PODALJŠEK S CLAVE KONEKTOM,S SPOJKO ZA DOSTOP BREZ IGLE,KI JE NI MOGOČE PREBOSTI Z IGLO,IMETI MORA MOŽNOST ZAPORE PRETOKA.7 DNEVNA UPOR.DOLŽ.PODALJ.12-13CM,VOL.0,3ML.(ICU MED.011-CT-3306 ali enakovredno).	693880	KOM	284				
26	TROKANALNI DEBEL.PODALJ. S TREMI SPOJK.,KI JIH NI MOGOČE ODSTRANITI.DOLŽ.15-15,5CM,VOL.MED 1,25-1,30ML (ICU MED. 011-CU-1362 ali enakovredno).	693928	KOM	1.500				

SPECIFIKACIJA ZAHTEV NAROČNIKA

Predmet JN: **88 Medicinski potrošni material 2, 2016-2018****32 Brezigelne spojke,podaljški,vbodne igle s spojki.-100%sk.GL.PR.4**

CPV: 33196000

Z.Š.	Naziv artikla	ident JN	EM	Razp. kol. za 12 mes	Pakir.	Proizvajalec	Zaščiteno ime	Kataloška številka
27	TROKANALNI PODALJŠEK S TREMI SPOJK.,KI JIH NI MOGOČE ODSTRANITI.DOLŽINA 17,5 DO 18CM, VOL.MED 0,65 IN 0,70ML (ICU MEDICAL 011-MC3323 ALI ENAKOVREDNO).	694002	KOM	1.217				

ŽIG IN PODPIS:

SPECIFIKACIJA ZAHTEV NAROČNIKA

Predmet JN: **88 Medicinski potrošni material 2, 2016-2018**
33 Dreni pvc in rezervoarji za drenažo op.ran-100%sk.

CPV: 33196000

Z.Š.	Naziv artikla	ident JN	EM	Razp. kol. za 12 mes	Pakir.	Proizvajalec	Zaščiteno ime	Kataloška številka
1	DREN REDON CH 6 ,PERFORACIJA 70MM-DOLŽINA 50CM /PVC,STERILEN, RTG NITKA	402281	KOM	81				
2	DREN REDON CH 8,PERFORACIJA 140MM-DOLŽINA 50CM /PVC,STERILEN, RTG NITKA	344648	KOM	162				
3	DREN REDON CH10, PERFORACIJA 150MM-DOLŽINA 50CM /PVC,STERILEN, RTG NITKA	387886	KOM	567				
4	DREN REDON CH12 ,PERFORACIJA 150MM-DOLŽINA 50CM /PVC,STERILEN	383660	KOM	1.217				
5	DREN REDON CH14,PERFORACIJA 150MM-DOLŽINA 50CM /PVC,STERILEN	382116	KOM	1.136				
6	DREN REDON CH16 ,PERFORACIJA 150MM-DOLŽINA 50CM /PVC,STERILEN	218308	KOM	648				
7	IGLA REDON CH 8-16,LEGIRANO JEKLO,RAVNA Z UPOGNJENO KONICO SULIČASTE OBLIKE/NESTERINA	425923	KOM	8				
8	REDIVAC, 30 DO 50ML ,HARMONIKA, KOMPL.Z DRENOM CH6 IN VODILNO IGLO ZA DREN,VACUUM 80MM/Hg,STERILEN	219053	KOM	138				
9	REDON PLASTENKA 400ML+50ML VARN. VOL,INTIGRIRAN INDIKAT.VAKUMA Z GRADUACIJO MIN-MAX,VACUUM 2000 Pa,POVEZ. CEV S PROZOR. KONEKT. ZA REDON DREN,Z LL PRIKL.NA PLASTENKO,NOSILEC,STERILNO (PRIMED 24502 ALI ENAKOVREDNO)	342190	KOM	519				
10	REDON PLASTENKA 600ML+50ML VARNOSTNI VOLUMEN,INTEGRIRAN INDIK. VACUUMA Z GRADUAC.MIN-MAX,VAKUM 2000 Pa,POVEZOVALNA CEV S PROZOR.KONEKT. ZA REDON DREN,Z LL PRIKL. NA PLASTENKO,NOSILEC,STERILNO (PRIMED 24504 ALI ENAKOVREDNO)	342181	KOM	3.527				
11	REDON PLASTENKA- 150ML,HARMONIKA,VACUUM 140MM/Hg,S POVEZOVALNO CEVJO IN KONEKTOM, STERILEN	329819	KOM	162				

ŽIG IN PODPIS:

SPECIFIKACIJA ZAHTEV NAROČNIKA

Predmet JN: **88 Medicinski potrošni material 2, 2016-2018**
34 Dreni silikon.+rezervoarji za drenažo op.ran-100%

CPV: 33196000

Z.Š.	Naziv artikla	ident JN	EM	Razp. kol. za 12 mes	Pakir.	Proizvajalec	Zaščiteno ime	Kataloška številka
1	DREN S TROKARJEM 10 FR,SILIKONSKI,PLOŠATI,RADIOPAČEN, ŽLEBIČAST PO CELOTNI DOLŽINI. MOŽNOST PRIKLOPA NA RAZPISANA 100 ML IN 450 ML REZERVOARJA.(J&J 2215 ali enakovredno).	381870	KOM	49				
2	DREN S TROKARJEM 15 FR,SILIKONSKI,OKROGLI-PLOŠČATI,BLAKE 3/16", DOLŽ. 3/ 4 ŽLEBIČAST. MOŽNOST PRIKLOPA NA VSE TRI RAZPIS. TIPE REZERVOARJEV: 100, 150, 450ML. (J&J2229 ali enakovredno).	381888	KOM	138				
3	DREN S TROKARJEM 19FR,SILIKONSKI,OKROGLI (JOHNSON&JOHNSON.2231 ALI ENAKOVREDNO).MOŽNOST PRIKLOPA NA VSE 3 RAZPIS.REZERVOARJE ZA SUKCIJO JOHNSON 2160, 2161 IN 2162.	381861	KOM	97				
4	DREN SILIKONSKI 10MM PLOŠČATI,BLAKE,RADIOPAČEN,ŽLEBAST PO CELOTNI DOLŽINI,MOŽNOST PRIKLOPA NA RAZPISANA 100 ,150 IN 450ML REZERVOAR, (J&J2214 ali enakovredno).	381853	KOM	16				
5	DREN 24FR,SILIKON,okrogle oblike s 3/16 trokarjem, (J&J2234 ali enakovredno).	695696	KOM	97				
6	DREN 7MM,SILIKONSKI,PLOŠČATI,BLAKE , S 3/16 TROKARJEM, ŽLEBIČAST PO CELOTNI DOLŽINI. MOŽNOST PRIKLOPA NA VSE TRI RAZPISANE TIPE REZERVOARJEV: 100,150,450 ML. (J&J 2212 ali enakovredno).	338281	KOM	633				
7	REZERVOAR ZA SUKCIJO- 100ML,OKROGLI, Z NEPOVRATNIM VENTILOM, (J&J 2160 ali enakovredno).	381837	KOM	105				
8	REZERVOAR ZA SUKCIJO- 150ML,PLOŠČATI, Z Y KONEKTOM IN NEPOVRATNIM VENTILOM, (J&J 2161 ali enakovredno).	381845	KOM	33				
9	REZERVOAR ZA SUKCIJO- 450ML,PLOŠČATI, Z Y KONEKTOM IN NEPOVRATNIM VENTILOM, (J&J 2162 ali enakovredno).	322148	KOM	219				

ŽIG IN PODPIS:

SPECIFIKACIJA ZAHTEV NAROČNIKA

Predmet JN: **88 Medicinski potrošni material 2, 2016-2018**
35 Elektrode.kabli+ostali pripom.za"VALLEYLAB".-100%sk.

CPV: 33196000

Z.Š.	Naziv artikla	ident JN	EM	Razp. kol. za 12 mes	Pakir.	Proizvajalec	Zaščiteno ime	Kataloška številka
1	ELEKTRODA EDGE -NOŽ,DOLŽINA 16,51CM, AKTIVNA DOLŽINA 5,1MM, IZOLIRANA,(COVIDIEN E1455-6 ali enakovredno).	485012	KOM	1.095				
2	ELEKTRODA EDGE -NOŽ,DOLŽINA 6,99CM,AKTIVNA DOLŽINA 2,8CM,IZOLIRANA,STERILNA,(COVIDIEN E1450 X ali enakovredno).	484997	KOM	1.459				
3	ELEKTRODA NEVTRALNA ZA VF.KIR.NOŽ, 1XUP, DVODELNA S HYDROGELOM, BREZ KABLA, OMOGOČATI MORA DOBRO PRILEGANJE IN NEODSTOPAJE OD PODLAGE,(COVIDIEN E7509 ali enakovredno).	565911	KOM	7.541				
4	ELEKTRODA ZA EL.NOŽ, ZA VEČKRATNO UPORABO (COVIDIEN E1020 ALI ENAKOVREDNO).	580775	KOM	8				
5	ELEKTRODA ZA EL.NOŽ (COVIDIEN E1455B-4 ALI ENAKOVREDNO).	485004	KOM	101				
6	ELEKTRODA ZA EL.NOŽ ZA VEČKRATNO UPORABO (COVIDIEN E1003 ALI ENAKOVREDNO).	486558	KOM	2				
7	KABEL ZA BIPOLARNO PINCETO , DOLŽINA 3.6M, (COVIDIEN E0018 ali enakovredno).	567841	KOM	4				
8	KABEL ZA NEGATIVNO ELEKTRODO, E0560 ali enakovredno	566942	KOM	18				
9	KABEL ZA NEGATIVNO ELEKTRODO. (COVIDIEN E0560E ali enakovredno).	606154	KOM	13				
10	PODALJŠEK ZA ELEKTROKIR.NOŽ. (COVIDIEN E1502 ali enakovredno).	507008	KOM	2				
11	ROČNIK ZA VF ELEKTROKIRURŠKI NOŽ S 4,6M SILIKONSKIM KABLOM IN STAINLEESS STEEL ELEKTRODO-NOŽ, NESTERILEN, (COVIDIEN E 2100 ali enakovredno).	486540	KOM	154				

ŽIG IN PODPIS:

SPECIFIKACIJA ZAHTEV NAROČNIKA

Predmet JN: **88 Medicinski potrošni material 2, 2016-2018**
36 Kanile varne.-100%sk.

CPV: 33196000

Z.Š.	Naziv artikla	ident JN	EM	Razp. kol. za 12 mes	Pakir.	Proizvajalec	Zaščiteno ime	Kataloška številka
1	Kanila venska varnostna G14-2,2 X 50-52mm,pretok 314-343ml/min. (BRAUN 4269225S ali enakovredno).	755621	KOM	325				
2	Kanila venska varnostna G16-1,7-1,8 X 50-52mm,pretok 196-208 ml/min.(BRAUN 4269179S ali enakovredno).	755630	KOM	244				
3	Kanila venska varnostna G17-1,5 X 45mm,pretok 128 ml/min.(BRAUN 4269152S ali enakovredno).	755648	KOM	446				
4	Kanila venska varnostna G18-1,3 X 45mm,pretok 96-100 ml/min. (BRAUN 4269136S ali enakovredno).	755656	KOM	1.581				
5	Kanila venska varnostna G20-1,1 X 32-33mm ,pretok 61-63 ml/min. (BRAUN 4269110S ali enakovredno).	755664	KOM	3.406				
6	Kanila venska varnostna G22-0,9 X 25mm,pretok 36-38 ml/min.(BRAUN 4269098S ali enakovredno).	755672	KOM	2.554				
7	Kanila venska varnostna G24-0,7-0,8 X 16-19mm ,pretok 22-24 ml/min. (BRAUN 4269071S ali enakovredno).	755699	KOM	244				

ŽIG IN PODPIS:

SPECIFIKACIJA ZAHTEV NAROČNIKA

Predmet JN: **88 Medicinski potrošni material 2, 2016-2018**
37 Kanile venozne.-100% sk.

CPV: 33196000

Z.Š.	Naziv artikla	ident JN	EM	Razp. kol. za 12 mes	Pakir.	Proizvajalec	Zaščiteno ime	Kataloška številka
1	KANILA NEOFLON 24G 0,7 X 19MM,DVOVHODNA ,MATERIAL: PTFE,APIROGEN (B&D391350 ali enakovredno)	318442	KOM	3.365				
2	KANILA NEOFLON 26G 0,6X19MM,DVOVHODNA,MATERIAL:PTFE,APIROGEN (B&D391349 ALI ENAKOVREDNO)	765449	KOM	162				
3	KANILA VENOZNA G18 -1,2MM X 45MM DVOVHODNA-POLIURETAN,PRETOK 96ML/MIN.,DOBRO GIBLJIV METULJČEK Z LUKNJICAMI,LATEX-FREE	526754	KOM	3.243				
4	KANILA VENOZNA G20 -1,0MM X 32MM DVOVHODNA-POLIURETAN,PRETOK 61ML/MIN.,DOBRO GIBLJIV METULJČEK Z LUKNJICAMI,LATEX FREE	526746	KOM	21.162				
5	KANILA VENOZNA G22-0,8MM X 25MM DVOVHODNA-POLIURETAN,PRETOK 36ML/MIN.,DOBRO GIBLJIV METULJČEK,LATEX-FREE	526738	KOM	5.190				
6	KANILA VENOZNA 0.8 X 25MM- G22,dvovhodna,MATERIAL-PTFE, APIROGEN, (B&D 391451 ali enakovredno).	318434	KOM	20.473				
7	KANILA VENOZNA 1.0 X 32 MM-G20,DVOVHODNA,MATERIAL-PTFE, APIROGEN, (B&D 391452 ali enakovredno).	235687	KOM	30.608				
8	KANILA VENOZNA 1.2 X 45MM G18,DVOVHODNA ,MATERIAL- PTFE, APIROGEN, (B&D 391453 ali enakovredno).	344362	KOM	11.757				
9	KANILA VENOZNA 1.4 X 45MM-G17,DVOVHODNA ,MATERIAL-PTFE, APIROGEN, (B&D 391454 ali enakovredno).	342726	KOM	2.108				
10	KANILA VENOZNA 1.7 X 45MM- G16,DVOVHODNA ,MATERIAL-PTFE, APIROGEN, (B&D 391455 ali enakovredno).	342718	KOM	3.406				
11	MANDREN ZA VENOZNO KANILO G18-1,2MM-DOLŽINA 45MM-POLIURETAN,KOMPATIBILEN S KANILO NA ID:526754.	526720	KOM	41				
12	MANDREN ZA VENOZNO KANILO G20-1,0MM -DOLŽINA 33MM-POLIURETAN,KOMPATIBILEN S KANILO NA ID:526746.	526762	KOM	527				
13	MANDREN ZA VENOZNO KANILO G22-0,8MM-DOLŽINA 25MM-POLIURETAN,KOMPATIBILEN S KANILO NA ID:526738.	526711	KOM	244				
14	VENOZNA IGLA Z METULJČKOM,19G-1.0 X 25 MM,DOLŽINA POVEZOVALNE CEVI-30CM,LATEX FREE,LL,ZAMAŠEK	384097	KOM	81				
15	VENOZNA IGLA Z METULJČKOM,21G- 0.8 X 20MM,DOLŽINA POVEZOVALNE CEVI-30CM,LATEX FREE,LL,ZAMAŠEK	387096	KOM	3.243				
16	VENOZNA IGLA Z METULJČKOM,22G- 0,7 X 20MM,DOLŽINA POVEZOVALNE CEVI-30CM,LATEX FREE,LL,ZAMAŠEK	436950	KOM	567				
17	VENOZNA IGLA Z METULJČKOM,23G- 0,6 X 17MM,DOLŽINA POVEZOVALNE CEVI-30CM,LATEX FREE,LL,ZAMAŠEK	143499	KOM	1.217				

SPECIFIKACIJA ZAHTEV NAROČNIKA

Predmet JN: **88 Medicinski potrošni material 2, 2016-2018**
37 Kanile venozne.-100% sk.

CPV: 33196000

Z.Š.	Naziv artikla	ident JN	EM	Razp. kol. za 12 mes	Pakir.	Proizvajalec	Zaščiteno ime	Kataloška številka
18	VENOZNA IGLA Z METULJČKOM,25G-0,5 X 17MM ,DOLŽINA POVEZOVALNE CEVI-30CM,LATEX FREE,LL,ZAMAŠEK	423904	KOM	162				
19	ZAMAŠEK ZA IV.KANILO Z MOŽNOTJO DODATNE APLIKACIJE,BREZ LATEXA	219045	KOM	16.054				
20	ZAMAŠEK ZA IV.KANILO,LUER LOCK	408514	KOM	42.811				

ŽIG IN PODPIS:

SPECIFIKACIJA ZAHTEV NAROČNIKA

Predmet JN: **88 Medicinski potrošni material 2, 2016-2018**
38 Katetri urinski s temperatur.senzorjem+kabli.-100%sk.

CPV: 33196000

Z.Š.	Naziv artikla	ident JN	EM	Razp. kol. za 12 mes	Pakir.	Proizvajalec	Zaščiteno ime	Kataloška številka
1	KABEL ADAPTACIJSKI ZA TEMPARATURNI KATETER,ZA MONITOR "DRAGER".	567353	KOM	2				
2	KABEL ADAPTACIJSKI ZA TEMPARATURNI KATETER,ZA MONITOR" HP"	567361	KOM	8				
3	KATETER URINSKI DVOPOTNI FOLEY CH14,,BALONSKI BALON 5-15 ML, DOLŽINA 40-45 CM, ,SILIKONSKI, S TEMPERATURNIM SENZORJEM, KONICA NAJMANJ Z DVEMA OČESOMA	442941	KOM	255				
4	KATETER URINSKI DVOPOTNI FOLEY CH16 ,BALONSKI, BALON 5-15ML, DOLŽINA 40-45 CM, SILIKONSKI,S TEMPERATURNIM SENZORJEM, KONICA NAJMANJ Z DVEMA OČESOMA	442950	KOM	267				
5	KATETER URINSKI DVOPOTNI FOLEY CH18 , BALONSKI, BALON 5-15ML, DOLŽINA 40-45 CM, KONICA Z NAJMANJ DVEMA OČESOMA, SILIKONSKI,S TEMPERATURNIM SENZORJEM	442968	KOM	150				

ŽIG IN PODPIS:

SPECIFIKACIJA ZAHTEV NAROČNIKA

Predmet JN: **88 Medicinski potrošni material 2, 2016-2018**
39 Papir za EKG in EEG aparate.-100% sk.

CPV: 33196000

Z.Š.	Naziv artikla	ident JN	EM	Razp. kol. za 12 mes	Pakir.	Proizvajalec	Zaščiteno ime	Kataloška številka
1	FOLIJA TERMALNA ZA VIDEOPRINTER.(MITSHUBISHI K65HM ali enakovredno).	388262	KOM	549				
2	FOLIJA VIDEOPRINTER 210MM. (Sony UPP-210HD ali enakovredno)	608378	KOM	33				
3	FOLIJA 110MM X 18M ZA VIDEOPRINTER "SONY". (Sony UPP110HG ali enakovredno).	482234	KOM	154				
4	PAPIR CTG TERMO 150 X 100MM, BREZ LUKNJIC, 1 ZAV = 150 LISTIČEV,(DIAGRAM HALB. 1501-HP1911A ali enakovredno).	399698	ZAV	292				
5	PAPIR CTG TERMO 152 X 100 MM, Z LUKNJICAMI, 1 ZAV = 50 LISTIČEV,(DIAGRAM HALB.HP9270-0630 ali enakovredno).	244767	ZAV	16				
6	PAPIR CTG 152X90X160 LISTOV.(DIAGRAM HALB. DAO4305 ali enakovredno).	488259	KOM	381				
7	PAPIR EKG TERMO 130 X 135 MM X 370 LISTIČEV. ZA APARAT EK53. (DIAGRAM HALB. EK53 (15) ali enakovredno).	241369	ZAV	8				
8	PAPIR EKG TERMO 210 X 300MM, POTISKAN, 1 ZAV = 150 LISTIČEV. (DIAGRAM HALBACH 110 ali enakovredno).	411876	ZAV	466				
9	PAPIR EKG TERMO 210 X 300MM, 2/3 POTISKAN, 1 ZAV = 200 LISTIČEV.(DIAGRAM HALBACH 2/3-88).	406562	ZAV	12				
10	PAPIR EKG TERMO 90 X 90MM ZA APARAT MIKROSMART 22616702. 1ZAV= 360 LISTIČEV.(DIAGRAM HALB. Microsmart 209 ali enakovredno).	427802	ZAV	16				
11	PAPIR EKG TERMO, ZA APARAT "SCHILLER AT-2/AT102 " Dim: 210MM X 280MM, 1 ZAV = 240 LISTIČEV.(DIAGRAM HALBACH EKG TERMO AT2/AT102 ali enakovredno).	478059	ZAV	316				
12	PAPIR TERMO ROLA- ŠIRINA 110MM,NOTRANJI PREMIER ODPRTINE 12MM,ZUNANJI PREMIER ROLE 45MM,DOLŽINA 25M-NEPOTISKAN	399680	SVT	39				
13	PAPIR TERMO ROLA- ŠIRINA 50MM,NOTRANJI PREMIER ODPRTINE 16MM, ZUNANJI PREMIER 50MM-POTISKAN	442011	SVT	73				
14	PAPIR TERMO ROLA- ŠIRINA 50MM,NOTRANJI PREMIER ODPRTINE 16MM,ZUNANJI PREMIER ROLE 50MM-NEPOTISKAN	405965	SVT	25				
15	PAPIR TERMO ROLA- ŠIRINA 57MM,NOTRANJI PREMIER ODPRTINE 12MM, ZUNANJI PREMIER ROLE 45MM,-NEPOTISKAN	382493	SVT	178				
16	TONER+PAPIR ZA SONY (SONY UPC 21L ali enakovredno).	666424	SC	9				

ŽIG IN PODPIS:

SPECIFIKACIJA ZAHTEV NAROČNIKA

Predmet JN: **88 Medicinski potrošni material 2, 2016-2018**
40 Preveleke za RTG.-100% sk.

CPV: 33196000

Z.Š.	Naziv artikla	ident JN	EM	Razp. kol. za 12 mes	Pakir.	Proizvajalec	Zaščiteno ime	Kataloška številka
1	PREVLEKA ZA EKRAN , MAT.: PE STERILIZ. S PLINOM ETTO, PRAVOKOTNE OBLIKE ENA STRAN FIKSNO ZAPRTA , DRUGA Z GUMICO ZA TESNITEV, 80CM X 110 CM , RT II.(MI-SAN 12103611 ali enakovredno).	425605	KOM	2.035				
2	PREVLEKA ZA EKRAN , MAT.: PE , POLKROŽNE OBLIKE Z GUMICO ZA TESNITEV, 65CMX125CM, OBSEG 160 CM, PREMIER 80 CM, GLOBINA 80 CM, STERILNA , RTG I.(MI-SAN 121036103 ali enakovredno).	425591	KOM	754				
3	PREVLEKA ZA EKRAN , MAT.: PE STERILEN, STOŽASTE OBLIKE, DIMENZIJE KROG PREMIERA 35 CM, VIŠINA 30 CM, ENA STRAN ZAPRTA, DRUGA Z GUMI TESNILOM , RTG IV,(MI-SAN SBM-122008 ali enakovredno).	580201	KOM	292				
4	PREVLEKA ZA EKRAN MONITORJA "AKSIOM", DOLŽINA 1,6 M IN 30-40CM GLOBINE, RTG VI.(MI-SAN 121042910 ali enakovredno).	580228	KOM	608				
5	PREVLEKA ZA EKRAN RTG VII. ZA APARAT SIREMOBIL ISO-C SIMENS.(MI-SAN 121045447 ali enakovredno).	580236	KOM	2				
6	PREVLEKA ZA EKRAN TRAUMAT.OP BLOK- RTG ZA APARAT Y 9053 PROIZ. SIMMENS 5146886 , RTG V.(MI-SAN SBM ali enakovredno).	580210	KOM	770				

ŽIG IN PODPIS:

SPECIFIKACIJA ZAHTEV NAROČNIKA

Predmet JN: **88 Medicinski potrošni material 2, 2016-2018**
41 Sistemi za IVAC črpalke.-100% sk.

CPV: 33196000

Z.Š.	Naziv artikla	ident JN	EM	Razp. kol. za 12 mes	Pakir.	Proizvajalec	Zaščiteno ime	Kataloška številka
1	BRIZGALKA LL 50ML , ZA ALARIS INJEKTOMAT IVAC 700. (CAREFUSION 30602N ali enakovredno).	478580	KOM	49				
2	SISTEM ZA IVAC ČRPALKE;TIP- 591,597 IN 598.(CAREFUSION G59793 ali enakovredno).	402109	KOM	2.514				
3	SISTEM ZA IVAC ČRPALKE;TIP- 591,597 IN 598- ZATEMNJEN. (CAREFUSION G59643 ali enakovredno).	284556	KOM	211				
4	SISTEM ZA IVAC ČRPALKE;TIP- 591,597 IN 598.(CAREFUSION G59693 ali enakovredno).	426474	KOM	3.649				
5	SISTEM ZA IVAC ČRPALKE;TIP- 701,711 IN 770- ZATEMNJEN, VIDEN PRETOK (CAREFUSION G30453V ali enakovredno).	436135	KOM	1.540				
6	SISTEM ZA IVAC ČRPALKE;TIP- 701,711,770 IN P7000.(CAREFUSION 422363 G30402 ali enakovredno).	422363	KOM	10.622				
7	SISTEM INFUZIJSKI S 15 MIKRONSKIM FILTROM,APIROGEN,STERILEN, ZA IVAC ČRPALKE SE 2 GOLD, (CAREFUSION 72303 ali enakovredno).	528803	KOM	3.609				
8	SISTEM INFUZIJSKI-ONKOLOŠKI, ZA IVAC ČRPALKE "ALARIS GP".ZATEMNJEN, BREZ LATEKSA (CAREFUSION 60951E ali enakovredno).	830704	KOM	41				
9	SISTEM ZA ENOSTAVNE INFUZIJSKE ČRPALKE Z Y PORTOM (ZA GP).(CAREFUSION 60693E ali enakovredno).	749630	KOM	325				
10	SISTEM ZA ENOSTAVNE INFUZIJSKE ČRPALKE-NAVADNI (ZA GP). (CAREFUSION 60593 ali enakovredno).	749621	KOM	1.378				
11	SISTEM ZA PERFUZOR, NAVADNI, ZA APARAT ASENA GH. (CAREFUSION G40015 ali enakovredno).	749605	KOM	162				

ŽIG IN PODPIS:

SPECIFIKACIJA ZAHTEV NAROČNIKA

Predmet JN: **88 Medicinski potrošni material 2, 2016-2018**
42 Skalpel.-100% sk.

CPV: 33196000

Z.Š.	Naziv artikla	ident JN	EM	Razp. kol. za 12 mes	Pakir.	Proizvajalec	Zaščiteno ime	Kataloška številka
1	SKALPELI ZA 1XUP FIG 10;DRŽALO UMETNA MASA,STERILEN,OVOJ MORA IMETI DOBRO VIDNO OZNAKO VELIKOSTI IN DATUM STERILNOSTI,DOBRO ODPIRANJE OVOJA V VSEH SLOJIH	143502	KOM	1.322				
2	SKALPELI ZA 1XUP FIG 11;DRŽALO UMETNA MASA,STERILEN,OVOJ MORA IMETI DOBRO VIDNO OZNAKO VELIKOSTI IN STERILNOSTI,DOBRO SE MORA ODPIRATI V VSEH SLOJIH	389773	KOM	2.140				
3	SKALPELI ZA 1XUP FIG 15;DRŽALO UMETNA MASA,STERILEN,OVOJ MORA IMETI DOBRO VIDNO OZNAKO VELIKOSTI IN STERILNOSTI,DOBRO SE MORA ODPIRATI V VSEH SLOJIH	389781	KOM	941				
4	SKALPELI ZA 1XUP FIG 20;DRŽALO UMETNA MASA,STERILEN,OVOJ MORA IMETI DOBRO VIDNO OZNAKO VELIKOSTI IN DATUM STERILNOSTI,DOBRO SE MORA ODPIRATI V VSEH SLOJIH	389790	KOM	333				
5	SKALPELI ZA 1XUP FIG 22;DRŽALO UMETNA MASA,STERILEN,OVOJ MORA IMETI DOBRO VIDNO OZNAKO VELIKOSTI IN STERILNOSTI,DOBRO SE MORA ODPIRATI V VSEH SLOJIH	389803	KOM	41				
6	SKALPELI- REZILA FIG.10,STAINLEESS STEEL,STERILNA,OVOJ MORA IMETI DOBRO VIDNO OZNAKO VELIKOSTI IN STERILNOSTI,DOBRO SE MORA ODPIRATI V VSEH SLOJIH	344621	KOM	13.865				
7	SKALPELI- REZILA FIG.11,STAINLEESS STEEL,STERILNA,OVOJ MORA IMETI DOBRO VIDNO OZNAKO VELIKOSTI IN STERILNOSTI,DOBRO SE MORA ODPIRATI V VSEH SLOJIH	381551	KOM	17.838				
8	SKALPELI- REZILA FIG.12,STAINLEESS STEEL,STERILNA,OVOJ MORA IMETI DOBRO VIDNO OZNAKO VELIKOSTI IN STERILNOSTI,DOBRO SE MORA ODPIRATI V VSEH SLOJIH	238481	KOM	1.540				
9	SKALPELI- REZILA FIG.15,STAINLESS STEEL,STERILNA, OVOJ MORA IMETI DOBRO VIDNO OZNAKO VELIKOSTI IN STERILNOSTI,DOBRO SE MORA ODPIRATI V VSEH SLOJIH	344613	KOM	16.865				
10	SKALPELI- REZILA FIG.20,STAINLESS STEEL,STERILNA,OVOJ MORA IMETI DOBRO VIDNO OZNAKO VELIKOSTI IN STERILNOSTI,DOBRO SE MORA ODPIRATI V VSEH SLOJIH	344605	KOM	12.648				
11	SKALPELI- REZILA FIG.22,STAINLESS STEEL,STERILNA,OVOJ MORA IMETI DOBRO VIDNO OZNAKO VELIKOSTI IN STERILNOSTI,DOBRO SE MORA ODPIRATI V VSEH SLOJIH	382434	KOM	1.217				

ŽIG IN PODPIS:

SPECIFIKACIJA ZAHTEV NAROČNIKA

Predmet JN: **88 Medicinski potrošni material 2, 2016-2018**
43 Zapestnice.-100% sk.

CPV: 33196000

Z.Š.	Naziv artikla	ident JN	EM	Razp. kol. za 12 mes	Pakir.	Proizvajalec	Zaščiteno ime	Kataloška številka
1	TRAK IDENTIFIKACIJSKI ZA UMRLE/EKOLOŠKI,Z DVE MA KARTONČKOMA,MATERIAL EKOLOŠKI PVC 460	484083	KOM	2.311				
2	TRAK ZA OZNAČEVANJE POSTELJE,MATERIAL EKOLOŠKI PVC	486663	KOM	1.217				
3	ZAPESTNICA BELA MALA ,MATERIAL: MEHEK PROZOREN EKOLOŠKI POLIURETAN.Z GUMBOM, KI MORA BITI SESTAVNI DEL ZAPESTNICE. Z VODOODPORNIM KARTONČKOM, ZA PODATKE PACIENTA.	329878	KOM	1.987				
4	ZAPESTNICA MODRA MALA,MATERIAL: MEHEK EKOLOŠKI POLIURETAN. Z GUMBOM, KI MORA BITI SESTAVNI DEL ZAPESTNICE. Z VODOODPORNIM KARTONČKOM, ZA PODATKE PACIENTA.	328472	KOM	3.040				
5	ZAPESTNICA MODRA VELIKA , MATERIAL EKOLOŠKI PVC.Z GUMBOM, KI MORA BITI SESTAVNI DEL ZAPESTNICE. Z VODOODPORNIM KARTONČKOM, ZA PODATKE PACIENTA.	328464	KOM	21.487				
6	ZAPESTNICA RDEČA VELIKA,MATERIAL EKOLOŠKI PVC.Z GUMBOM, KI MORA BITI SESTAVNI DEL ZAPESTNICE. Z VODOODPORNIM KARTONČKOM, ZA PODATKE PACIENTA.	329860	KOM	18.852				
7	ZAPESTNICA ZA NOVOROJENČKA IN MAMICO-V KOMPLETU. MATERIAL: MEHKI EKOLOŠKI PVC.	221473	PAR	1.865				

ŽIG IN PODPIS:

SPECIFIKACIJA ZAHTEV NAROČNIKA

Predmet JN: **88 Medicinski potrošni material 2, 2016-2018**
44 Zbiralniki za ostre predmete.-100% sk.

CPV: 33196000

Z.Š.	Naziv artikla	ident JN	EM	Razp. kol. za 12 mes	Pakir.	Proizvajalec	Zaščiteno ime	Kataloška številka
1	ZBIRALNIK ZA OSTRE PREDMETE,VOLUMEN 1,5 L , POKROV ZA VARNOSTNO ZAPIRANJE,MATERIAL: POLYPROPYLEN	342624	KOM	3.770				
2	ZBIRALNIK ZA OSTRE PREDMETE,VOLUMEN 3,5 L, POKROV ZA VARNOSTNO ZAPIRANJE,MATERIAL-POLYPROPYLEN	342637	KOM	2.717				
3	ZBIRALNIK ZA OSTRE PREDMETE,VOLUMEN 5,5-6,0 L, POKROV ZA VARNOSTNO ZAPIRANJE, MATERIAL: POLYPROPYLEN	329568	KOM	648				
4	ZBIRALNIK ZA OSTRE PREDMETE,VOLUMEN- 5 L ,OKROGLE OBLIKE,VIŠINA 42CM,ŠIRINA ODPRTINE 13,5CM,ŠIRINA DNA 11CM,VARNO ZAPIRANJE, MATERIAL.: POLYPROPYLEN	335070	KOM	486				
5	ZBIRALNIK ZA OSTRE PREDMETE,VOLUMEN: 0,5-0,6 L; POKROV ZA VARNOSTNO ZAPIRANJE,MATERIAL: POLYPROPYLEN	385085	KOM	2.229				

ŽIG IN PODPIS:

SPECIFIKACIJA ZAHTEV NAROČNIKA

Predmet JN: **88 Medicinski potrošni material 2, 2016-2018**
50 ANESTEZIJA.Grelne blazine.100%sk.

CPV: 33196000

Z.Š.	Naziv artikla	ident JN	EM	Razp. kol. za 12 mes	Pakir.	Proizvajalec	Zaščiteno ime	Kataloška številka
1	BLAZINA GRELNA in za prep.preležanin,55 X200CM,prevlečena z netkano tkanino ki vpija tekočino,preh.za rtg žarke,s trakovi za pričv.na op.mizo,za priklop na aparat.(KANMED OT-600-222 ali enakovredno).	322806	KOM	648				
2	BLAZINA GRELNA in za prepr.preležanin,50 X 110CM,prevlečena z netkano tkanino ,ki vpija tekočino,prehodna za rtg žarke,s trakovi za pričv.na op.mizo,za priklop na apar.(KANMED OT-600-211 ali enakovred	328405	KOM	422				

ŽIG IN PODPIS:

SPECIFIKACIJA ZAHTEV NAROČNIKA

Predmet JN: **88 Medicinski potrošni material 2, 2016-2018****51 ANESTEZIJA.Kartice,senzorji za hemodinam.mon.Lidco-100%sk.**

CPV: 33196000

Z.Š.	Naziv artikla	ident JN	EM	Razp. kol. za 12 mes	Pakir.	Proizvajalec	Zaščiteno ime	Kataloška številka
1	LIDCO-RAPID STAND.KARTICA ZA UMERJANJE (LIDCO-LI10507 ALI ENAKOVREDNO)	808369	KOM	251				
2	LIDCO-SENSOR ZA LIDL. (LIDCO CM-10 ALI ENAKOVREDNO).	694525	KOM	49				
3	LIDCO-SET ZA APLIKACIJO.(LIDCO CM50-044 ALI ENAKOVREDNO).	694533	KOM	37				

ŽIG IN PODPIS:

PONUĐNIK: .

NAROČNIK UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER MARIBOR
Ljubljanska ulica 5, 2000 MARIBOR

Datum: 1.10.2015

Stran: 1

SPECIFIKACIJA ZAHTEV NAROČNIKA

Predmet JN: **88 Medicinski potrošni material 2, 2016-2018**

52 ANESTEZIJA.Senzor za hemodinam.monitor Invos.100%sk.

CPV: 33196000

Z.Š.	Naziv artikla	ident JN	EM	Razp. kol. za 12 mes	Pakir.	Proizvajalec	Zaščiteno ime	Kataloška številka
1	SENZOR NIRS KOMPATIBILEN Z INVOS MONITORJEM (SOMANETICS SAFB-SMX10 ALI ENAKOVREDNO)	609943	KOM	827				

ŽIG IN PODPIS:

TEHNIČNI OPISI RAZPISANIH VRST BLAGA IZ SPECIFIKACIJE ZAHTEV NAROČNIKA

SKUPINA 4: Anestezija. Dihalni sistemi in drugi pripomočki. (PRILOGA 3)

▪ **IDENT 532754**

Maska za CPAP z napihljivim robom, srednja. Vsebuje priključek 22F za priklop dihalnega sistema z enosmernim ventilom, priključek 30M za priklop PEEP ventila z enosmernim ventilom, priključek za cevko za merjenje pritiska ter varovalni enosmerni ventil, ki pacientu omogoča dodatni vdih po potrebi.

▪ **IDENT 729523**

Nastavek za tubus raztegljiv od 70 do 150 mm, z gibljivim komolčkom. Možnost spreminjanja mrtvega prostora od 20 do 40 ml. Na komolčku mora biti odprtina za aspiracijo in bronhoskop premera 7,6 mm oz. 9,5 mm, odvisno od odprtega pokrovčka. Konekt pri dihalnem sistemu ima 22 mm notranji premer.

▪ **IDENT 388769**

Nebulizer za zdravila z alveolarno depozicijo. V kompletu mora biti T konekt dimenzije 22F-22M-22M/15F in cevka za kisik z notranjo steno zvezdaste oblike proti kolenčenju, dolžina med 1,8 in 2m. Zagotavljati mora, pri pretoku 8l/min, delce manjše od 2 mikronov in učinkovitost vsaj 75%.

SKUPINA 5: Anestezija. Filtri bakteriološki. (PRILOGA 2)

▪ **IDENT 329479 – Filter viralno - bakteriološki**

Filter viralno - bakteriološki, elektrostatičen. Filter mora biti za dihalne volumne od 200 do 1500 ml. Volumen največ 70 ml, padec pritiska pri neuporabljenem filtru in pretoku 30l/min ne sme biti večji od 120 Pa. Povečanje padca pritiska po uporabi treh ur ne sme biti večje od 5 Pa. Luer-Lock spojka z zamaškom, ki ne sme biti ločljiv od filtra. Teža filtra največ 42 g. Preizkušen mora biti na učinkovitost filtracije TBC, Hepatitis C, Bacillus subtilis var. Niger in virus MS-2. Postopek meritev mora biti po BS EN 13328-1, bakterijsko viralna verzija (kot je opisano v Anesthesia 2000; 55:458-65). Filtracijska učinkovitost mora biti vsaj 99,999%. Vse spojke morajo biti skladne s standardom BS EN 1281-1: 1997. Preizkušen mora biti tudi s testom po standardu ISO 23328-1.

▪ **IDENT 386138 – Filter viralno - bakteriološki**

Filter viralno - bakteriološki, vlažilni, elektrostatski. Filter mora biti za dihalne volumne od 75 do 200 ml. Volumen največ 28 ml, padec pritiska pri neuporabljenem filtru in pretoku 15l/min ne sme biti večji od 93 Pa. Povečanje padca pritiska po uporabi treh ur ne sme biti večje od 17 Pa. Luer-Lock spojka z zamaškom, ki ne sme biti ločljiv od filtra. Teža filtra največ 22 g. Preizkušen mora biti na učinkovitost preprečevanja okužbe z Bacillus subtilis var. Niger in virus MS-2. Postopek meritev mora biti po BS EN 13328-1, bakterijsko viralna verzija (kot je opisano v Anesthesia 2000; 55:458-65). Filtracijska učinkovitost mora biti vsaj 99,34%. Vlaženje mora biti vsaj 30 mg H₂O/l, merjeno po ISO 9360-2:2003. Vse spojke morajo biti skladne s standardom BS EN 1281-1: 1997. Preizkušen mora biti tudi s testom s soljo po standardu ISO 23328-1.

▪ **IDENT 386146 – Filter viralno - bakteriološki**

Filter viralno - bakteriološki, vlažilni, elektrostatski. Filter mora biti za dihalne volumne od 200 do 1500 ml. Volumen največ 68 ml, padec pritiska pri neuporabljenem filtru in pretoku 30l/min ne sme biti večji od 125 Pa. Povečanje padca pritiska po uporabi treh

ur ne sme biti večje od 14 Pa. Luer-Lock spojka z zamaškom, ki ne sme biti ločljiv od filtra. Teža filtra največ 45 g. Preizkušen mora biti na učinkovitost filtracije TBC, Hepatitis C, Bacillus subtilis var. Niger in virus MS-2. Postopek meritev mora biti po BS EN 13328-1, bakterijsko viralna verzija (kot je opisano v Anesthesia 2000; 55:458-65). Filtracijska učinkovitost mora biti vsaj 99,999%. Vlaženje mora biti vsaj 28mg H₂O/l. Vse spojke morajo biti skladne s standardom BS EN 1281-1: 1997. Preizkušen mora biti tudi s testom po standardu ISO 23328-1.

▪ **IDENT 430129 – Filter viralno - bakteriološki**

Filter viralno - bakteriološki, vlažilni, elektrostatski. Filter mora biti za dihalne volumne od 75 do 200 ml, z adapterjem za respirator Bear. Volumen največ 28 ml, padec pritiska pri neuporabljenem filtru in pretoku 15l/min ne sme biti večji od 93 Pa. Povečanje padca pritiska po uporabi treh ur ne sme biti večje od 17 Pa. Luer-Lock spojka z zamaškom, ki ne sme biti ločljiv od filtra. Teža filtra največ 22 g. Preizkušen mora biti na učinkovitost preprečevanja okužbe s Bacillus subtilis var. Niger in virus MS-2. Postopek meritev mora biti po BS EN 13328-1, bakterijsko viralna verzija (kot je opisano v Anesthesia 2000; 55:458-65). Filtracijska učinkovitost mora biti vsaj 99,34%. Vlaženje mora biti vsaj 30 mg H₂O/l, merjeno po ISO 9360-2:2003. Vse spojke morajo biti skladne s standardom BS EN 1281-1: 1997. Preizkušen mora biti tudi s testom s soljo po standardu ISO 23328-1.

SKUPINA 13: ANESTEZIJA. Supraglotični pripomočki. (PRILOGA 1)

▪ **Maske laringealne:**

Maska laringealna sterilna za enkratno uporabo brez lateksa. Oblika in največji volumen mešička ter oblika podporne plošče sta enaka originalni različici. Največji volumen mešička je kot v originalni različici. Razpon teže pacienta, največji pritisk v mešičku, številka maske in največji volumen mešička morajo biti označeni na dihalni cevi na razdalji največ 3 cm od spojke. Na maski mora biti neizbrisljiv indikator položaja maske. Notranji volumen maske ne vsebuje epiglotalnih prečk in ostalih ovir. Cevka za napihovanje mešička je pritrjena na dihalno cev po celi dolžini dihalne cevi in sicer od mešička do spojke maske. Preostali del cevke za napihovanje mešička, ki ni pritrjen na dihalno cev, mora biti dolg najmanj 10 cm. Kontrolni balon za napihovanje mešička ima označeno številko maske. Dihalna cev ima klasično obliko kot v originalni različici.

▪ **Maske laringealne prilagojene uporabi v področju magnetnega polja:**

Maska laringealna sterilna za enkratno uporabo brez lateksa. Oblika in največji volumen mešička ter oblika podporne plošče sta enaka originalni različici. Največji volumen mešička je kot v originalni različici. Razpon teže pacienta, največji pritisk v mešičku, številka maske in največji volumen mešička morajo biti označeni na dihalni cevi na razdalji največ 3 cm od spojke. Maska ne vsebuje kovine. Na maski mora biti neizbrisljiv indikator položaja maske. Konica maske je oblikovana tako, da sede v ezofagus. Notranji volumen maske ne vsebuje epiglotalnih prečk. Cevka za napihovanje mešička je pritrjena na dihalno cev po celi dolžini dihalne cevi in sicer od mešička do spojke maske. Preostali del cevke za napihovanje mešička, ki ni pritrjen na dihalno cev, mora biti dolg najmanj 10 cm. Kontrolni balon za napihovanje mešička ima označeno številko maske. Ovojna in maska morata vsebovati oznako, da je maska primerna za uporabo pri magnetni resonanci.

▪ **Supraglotični pripomočki za odprtje dihalnih poti za enkratno uporabo z nenapihljivim mešičkom**

Supraglotični pripomoček za odprtje dihalne poti za enkratno uporabo brez lateksa. Mešiček ni napihljiv. Na zgornjem delu mešička je dodan jeziček, ki preprečuje

neželeno zapiranje epiglotisa v smeri sapnika. Razpon teže pacienta, velikost pripomočka morajo biti označeni na dihalni cevi na strani spojke. Na notranji strani dihalne cevi na strani spojke je ojačanje proti pregrizu. Dihalna cev je po zunanosti sploščena, kar preprečuje rotacijo supraglotičnega pripomočka v dihalni poti pacienta. Anatomija mešička je oblikovana tako, da sede v ezofagus. Od spojke do konice supraglotičnega pripomočka poteka kanal za možnost aspiracije.

▪ **IDENT 807281**

Supraglotični pripomoček za enkratno uporabo, brez lateksa. Mešiček ne sme biti napihljiv. Na zgornjem delu mešička mora biti dodan jeziček, ki preprečuje neželeno zapiranje epiglotisa v smeri sapnika. Razpon teže pacienta, velikost pripomočka morajo biti označeni na dihalni cevi na strani spojke. Na notranji strani dihalne cevi, na strani spojke mora biti ojačanje proti pregrizu. Dihalna cev mora biti po zunanosti sploščena, kar preprečuje rotacijo supraglotičnega pripomočka v dihalni poti pacienta. Anatomija mešička mora biti oblikovana tako, da sede v ezofagus. Velikost št. 1. (Intersurgical 8201 ali enakovredno).

SKUPINA 32: Brezigelne spojke, podaljški, vbodne igle s spojkami. (PRILOGA 4)

▪ **BREZIGELNE SPOJKE – velja za vse artikle:**

1. spojka ne sme omogočati preboda z iglo. Ob vvodu z iglo ne sme biti mogoča ne aspiracija in ne injiciranje.
2. pretok spojke mora biti minimalno 160 ml/min.
3. spojka mora imeti nevtralni premik oz. je lahko negativni premik največ 0,02 ml.
4. mrtvi prostor spojke (polnitveni volumen) je lahko največ 0,06 ml.
5. neodvisna, randomizirana, validirana študija, objavljena v indeksirani strokovni publikaciji s faktorjem vpliva vsaj 3 mora dokazovati:
 - a) da se kljub 7 dnevni uporabi spojke zmanjša incidenca kateterske sepse za vsaj 46%, v primerjavi z odprtim sistemom;
 - b) da se kljub 7 dnevni uporabi spojke zmanjša kolonizacija vrha katetra za vsaj 37%, v primerjavi z odprtim sistemom;
 - c) da se kljub 7 dnevni uporabi spojke zmanjša kolonizacija začetka lumna katetra za vsaj 70%, v primerjavi z odprtim sistemom;
6. vse vbodne igle, vsi sistemi in podaljški morajo biti brez Di(2 ethylhexil)phtalhata.
7. spojka ne sme imeti zamaška.
8. spojka mora biti oblikovana tako, da je dovolj, ob intermitentnem dovajanju tekočin, prebrizgavanje 1x na 24 ur.
9. spojka mora imeti za razkuževanje pred uporabo, popolnoma ravno površino.
10. vse vbodne igle, ki vsebujejo spojko morajo biti brez PVC-ja.

DODATNE ZAHTEVE:

- Izbrani ponudniki morajo v času trajanja sklenjene kupoprodajne pogodbe brezplačno dobaviti tudi celoten potreben pribor (npr.: kable, priključke, posode, ipd.), ki bo omogočal uporabo ponujenega materiala na aparatih, ki so v uporabi v UKC Maribor. Zahteva velja za celoten javni razpis.
- Za skupine 4, 9, 50, 51 in 52 morajo ponudniki ponuditi v brezplačno uporabo aparate na katerih se uporablja ponujeni potrošni material in sicer:
 - Skupina 4: vsaj 4 CPAP aparate z merilnikom koncentracije kisika,
 - Skupina 9: vsaj 4 cell saverje,
 - Skupina 50: vsaj 4 grelnike blazin kot Warm Cloud,
 - Skupina 51: vsaj 6 hemodinamskih monitorjev kot Lidco,
 - Skupina 52: vsaj 7 hemodinamskih monitorjev kot Invos.

Ponudnik ponudi svojo opremo v brezplačno uporabo za čas trajanja okvirnega sporazuma in nudi tudi brezplačno servisiranje.

Specifikacija opreme, dane v brezplačno uporabo, mora biti priložena v ponudbi (velja za skupine 4, 9, 50, 51 in 52). Naveden mora biti tip ponujene opreme, proizvajalec in količina.

SPECIFIKACIJA PONUDBE S CENAMI - za 1. obdobje

Predmet JN: **88 Medicinski potrošni material 2, 2016-2018**

CPV: 33196000

01 ABDOMINAL.OP.Elektrode COOL TIP za "Valleylab"-100%sk.

Naziv artikla	ident JN	Predv. količ.	EM	Cena brez DDV	DDV%	MDC z DDV	Cena z DDV	Vrednost z DDV	Proizvajalec
ELEKTRODA ZA 1 X UP , DOLŽ. 28 CM, ZA APARAT "LIGASURE"(COVIDIEN LS 3111 ALI ENAKOVREDNO).	661627	4	KOM						
ELEKTRODA ZA 1 X UP, DOLŽ. 23 CM, ZA APARAT" LIGASURE". (COVIDIEN LS 3091, ALI ENAKOVREDNO).	628000	10	KOM						
INSTRUMENT Z REZILOM ZA LAPAROSK. LEPLJENJE IN REZANJE ŽIL -5MM, DOLŽ. 37 CM , 1 X UP, ,ZA APARAT"LIGASURE"(COVIDIEN LS-1500 ALI ENAKOVREDNO).	661635	17	KOM						
INSTRUMENT Z REZILOM ZA LAPAROSK. LEPLJENJE IN REZANJE ŽIL-10MM, DOLŽINA 37 CM, 1 X UP, ZA APARAT" LIGASURE" (COVIDIEN LS-1037 ALI ENAKOVREDNO).	661643	2	KOM						
INSTRUMENT ZA LEPLJENJE IN REZANJE ŽIL- ZA ODPRT SISTEM OP, ZA 1X UP, DOLŽINA 20 CM, ZA APARAT "LIGASURE" (COVIDIEN LS 1020 ALI ENAKOVREDNO).	661929	8	KOM						
NEGATIVNA ELEKTRODA S KABLOM ZA APARAT COOL-TIP. (COVIDIEN DGP-HP, ALI ENAKOVREDNO).	626813	8	KOM						
RADIOFREKVENČNA ELEKTRODA , DOLŽINA 25CM ,AKTIVNA DOLŽINA 3CM,ZA APARAT COOL-TIP.(COVIDIEN ACTC 2025 ALI ENAKOVREDNO).	611476	2	KOM						
RADIOFREKVENČNA ELEKTRODA ,DOLŽINA 15CM,AKTIVNA DOLŽINA 3CM,ZA APARAT COOL-TIP.(COVIDIEN LF4318 ALI ENAKOVREDNO).	611441	29	KOM						
RADIOFREKVENČNA ELEKTRODA RF COOL KIT, 1SC=3 SETI (COVIDIEN SWTC25303 ALI ENAKOVREDNO).	710067	6	SC						
RADIOFREKVENČNA ELEKTRODA, DOLŽINA 20CM,AKTIVNA DOLŽINA 3CM ZA APARAT COOL TIP.(COVIDIEN ACT-2030 ALI ENAKOVREDNO).	611468	4	KOM						

VREDNOST SKUPAJ:**10****61.784,47 €****0,00 €****ŽIG IN PODPIS:**

SPECIFIKACIJA PONUDBE S CENAMI - za 1. obdobje

Predmet JN: **88 Medicinski potrošni material 2, 2016-2018**

CPV: 33196000

02 ABDOMINAL.OP.Dreni abdominalni-silikonski-100% sk.

Naziv artikla	ident JN	Predv. količ.	EM	Cena brez DDV	DDV%	MDC z DDV	Cena z DDV	Vrednost z DDV	Proizvajalec
DREN ABDOMINALNI CH15,DOLŽINA 50 CM,PERFORACIJE 90 MM-5 STRANSKIH ODPRTIN+CENTRALNA ,MATERIAL- SILIKON,STERILEN	402290	325	KOM						
DREN ABDOMINALNI CH18 ,DOLŽINA 50 CM,PERFORACIJE 90 CM -5 STRANSKIH ODPRTIN+CENTRALNA,MATERIAL- SILIKON,STERILEN	382698	60	KOM						
DREN ABDOMINALNI CH20,DOLŽINA 50 CM,PERFORACIJE 90 MM-5 STRANSKIH ODPRTIN+CENTRALNA,MATERIAL-SILIKON,STERILEN	383678	101	KOM						
DREN ABDOMINALNI CH21-22/50CM,SILIKONSKI,STERILEN	388033	122	KOM						
DREN ABDOMINALNI CH24 ,DOLŽINA 50 CM,PERFORACIJE 90 MM-5 STRANSKIH ODPRTIN+CENTRALNA, MATERIAL-SILIKON,STERILEN	383686	1.115	KOM						
DREN ABDOMINALNI CH26,DOLŽINA 50CM, PERFORACIJE 90 MM-5 STRANSKIH ODPRTIN+CENTRALNA, MATERIAL- SILIKON,STERILEN	408719	60	KOM						
DREN ABDOMINALNI CH30,DOLŽINA 50 CM,PERFORACIJE 90 MM-5 STRANSKIH ODPRTIN+CENTRALNA,MATERIAL- SILIKON,STERILEN	387894	20	KOM						

VREDNOST SKUPAJ:**7****2.690,78 €****0,00 €**

ŽIG IN PODPIS:

SPECIFIKACIJA PONUDBE S CENAMI - za 1. obdobje

Predmet JN: **88 Medicinski potrošni material 2, 2016-2018**

CPV: 33196000

03 ABDOMINAL.ODD.Vrečke in podloge za stomo-100% sk.

Naziv artikla	ident JN	Predv. količ.	EM	Cena brez DDV	DDV%	MDC z DDV	Cena z DDV	Vrednost z DDV	Proizvajalec
PODLOGA HIDROKOLOIDNA, DVOPLASTNA KOŽNA,OVALNE OBLIKE, Z RELIEFNIM VZORCEM, Z UŠESOM ZA ODSTRANJEVANJE,MOČNO LEPILO, BREZ KONVEKSITETE, VEL. 60MM, IZREZ 10-55MM (COLOPLAST SENSURA 10035 ALI ENAKOVREDNO)	432075	244	KOM						
PODLOGA HIDROKOLOIDNA, KOŽNA, VEL.50MM,OVALNE OBLIKE,Z RELIEFNIM VZORCEM, Z UŠESOM ZA ODSTRANJEVANJE (COLOPLAST SENSURA 10021 ALI ENAKOVREDNO)	411833	37	KOM						
PODLOGA HIDROKOLOIDNA, KOŽNA, ZA STOMO,VEL.70-80MM,OKROGLE OBLIKE, OBROČ,KI SE LAHKO PRIDRŽI ZA NEBOLEČE NAMEŠČANJE VREČKE (COLOPLAST EASIFLEX 14303 ALI ENAKOVREDNO)	411817	244	KOM						
PODLOGA HIDROKOLOIDNA,DVOPLASTNA KOŽNA,OVALNE OBLIKE,Z RELIEFNIM VZORCEM Z UŠESOM ZA ODSTRANJEVANJE, VEL. 60MM, IZREZ 10-55MM (COLOPLAST SENSURA 10031 ALI ENAKOVREDNO)	325651	162	KOM						
PODLOGA HIDROKOLOIDNA,KOŽNA ZA VDRTO STOMO,VEL.60MM,IZREZ 15-43MM,OVALNE OBLIKE,Z RELIEFNIM VZORCEM,Z UŠESOM ZA ODSTRANJEVANJE,KONVEKSNA (COLOPLAST SENSURA 11031ALI ENAKOVREDNO)	442046	41	KOM						
VREČKA DRENAŽNA,ENODELNA STERILNA,MOŽNOST PRIKLOPA NA DRENAŽNO VREČKO, OVALNA,DVOPLASTNA PODLOGA S PREGLED.OKNOM,VEL.630ML,IZREZ 10-76MM,BREZ NEPOVR.VALVULE IN BREZ GRADUAC(COLOPL.SENS.19001 ALI ENAKOV.)	443131	122	KOM						
VREČKA DRENAŽNA,STERILNA,ENODELNAPOOPERATIVNA, Z OKNOM ZA ODPIRANJE, NA IZPUST,IZREZ OD10-70MM,MOŽNOST SPOJITVE Z DRENAŽNO VREČKO,ZAPIRANJE S ČEPOM ALI SPONKO,OKROGLA,BREZ GRAD.(COLOPL.POSTOP.12808 ALI ENAKOV.)	482650	251	KOM						
VREČKA DRENAŽNA,STERILNA,POOPERATIVNA,ENODELNA,Z OKNOM ZA ODPIRANJE,NA IZPUST,IZREZ OD 10-100MM,MOŽNOST SPOJITVE Z DRENAŽNO VREČKO,ZAPIR.S ČEPOM ALI SPONKO,OKROGLA,BREZ GRADUAC.(COLOPLAST 12810 ALI EN	384461	244	KOM						
VREČKA ZA ILEOSTOMO Z IZPUSTOM,VEL.70-80MM,Z VARNOSTNIM KANALOM,ZAPIRANJE Z JEŽKOM,PROZORNA,OKROGLE OBLIKE,S FILTROM (COLOPLAST EASIFLEX 14344 ALI ENAKOVREDNO)	435759	170	KOM						
VREČKA ZA ILEOSTOMO,ENODELNA,Z IZPUSTOM,KOŽNA PODLOGA OVALNE OBLIKE,IZREZ OD 10-76MM,RELIEFNI VZOREC,ZAPIR.NA JEŽKA,VALOVIT FILTER,PROZORNA,BREZ DVOJNE ZAP.,ODPRTINA ZA STOMO NA SREDINI(COLOPLAST15570 ALI ENAKOV.)	416959	648	KOM						

SPECIFIKACIJA PONUDBE S CENAMI - za 1. obdobje

Predmet JN: **88 Medicinski potrošni material 2, 2016-2018**

CPV: 33196000

03 ABDOMINAL.ODD.Vrečke in podloge za stomo-100% sk.

Naziv artikla	ident JN	Predv. količ.	EM	Cena brez DDV	DDV%	MDC z DDV	Cena z DDV	Vrednost z DDV	Proizvajalec
VREČKA ZA ILEOSTOMO,ODPRTA,Z IZPUSTOM,PRITRJEVANJE S KLJUČAVNICO,VALOVIT FILTER,ZAPIRANJE Z JEŽKOM,PROZORNA, MEHKA TKANINA,VEL.60MM (COLOPLAST SENSURA 10386 ALI ENAKOVREDNO)	404497	292	KOM						
VREČKA ZA KOLOSTOMO,ZAPRTA,S FILTROM,VEL.70-80MM,NAMEŠČANJE Z LEPLJENJEM, Z VARNOSTNIM KANALOM,KOŽNE BARVE,OKROGLE OBLIKE (COLOPLAST EASIFLEX 14319 ALI ENAKOVREDNO)	443140	122	KOM						
VREČKA ZA KOLOSTOMO,ZAPRTA,VEL. 60MM,VALOVITI FILTER,ZAPIRANJE NA KLJUČAVNICO,PROZORNA, MEHKA TKANINA (COLOPLAST SENSURA 10186 ALI ENAKOVREDNO)	443115	49	KOM						
VREČKA ZA UROSTOMO,Z IZPUSTOM,PRITRJEVANJE S KLJUČAVNICO,NEPOVRATNI VENTIL,MOŽNA SPOJITEV Z ZBIRALNO VREČKO,S PREKATI,VEL.50MM,PROZORNA, ZAPIR.S ČEPOM (COLOPLAST SENSURA 11855 ALI ENAKOVREDNO)	560286	122	KOM						
VREČKA ZA UROSTOMO,Z IZPUSTOM,PRITRJEVANJE S KLJUČAVNICO,NEPOVRATNI VENTIL,MOŽNA SPOJITEV Z ZBIRALNO VREČKO,S PREKATI,VEL.60MM,PROZORNA,ZAPIR. S ČEPOM (COLOPLAST SENSURA 11856 ALI ENAKOVREDNO)	560294	73	KOM						

VREDNOST SKUPAJ:**15****8.014,25 €****0,00 €****ŽIG IN PODPIS:**

SPECIFIKACIJA PONUDBE S CENAMI - za 1. obdobje

Predmet JN: **88 Medicinski potrošni material 2, 2016-2018**
04 ANESTEZIJA.Dihalni sistemi in drugi pripom.-100% sk.

CPV: 33196000

Naziv artikla	ident JN	Predv. količ.	EM	Cena brez DDV	DDV%	MDC z DDV	Cena z DDV	Vrednost z DDV	Proizvajalec
BALON ZA ANESTEZ.,VOL.OD 1000 DO 1200ML,BREZ LATEXA, Z ZAŠČITNO MREŽO PROTI KOLENČENJU.(INTERSURGICAL 2810 ALI ENAKOVREDNO).	430056	33	KOM						
BALON ZA ANESTEZ.,VOL.OD 1800 DO 2000ML, BREZ LATEXA, Z ZAŠČITNO MREŽO PROTI KOLENČENJU. ZA 1X UPOR.(INTERSURG. 2820 ALI ENAKOVREDNO).	388815	41	KOM						
CEV ZA KISIK,REBRASTA,FRAGMENTIRANA NA RAZDALJI MED 160 IN 170MM,PREMER 22MM IN DOLŽINE MED 45 IN 50M.(INTERSURG. 1573 ALI ENAKOVREDNO).	221180	18	KOM						
CEVKA ZA KISIK,DOLŽINA MED 1,8- 2M,Z NOTRANJO STENO ZVEZDASTE OBLIKE ZA PREPREČEVANJE KOLENČENJA.RAZTEGLJIVE OBJEMKE NA OBEH KONCIH.(INTERSURGICAL 1174 ALI ENAKOVREDNO).	388513	5.128	KOM						
CEVKA ZA MERJENJE CO2,NOTRANJI PREM.1,2MM.VSEBUJE DODATNI LUER LOCK KOMOLČEK PREMERA 7,6MM,DOLŽINA 2,45M.(INTERSURG. 2732100 ALI ENAKOVREDNO)	386111	876	KOM						
CEVKA ZA MERJENJE CO2,NOTRANJI PREMER 1,2MM.VSEBUJE DODATNI LUER LOCK KOMOLČEK PREMERA 7,6MM.DOLŽINA 3,0M.(INTERSURG. 2734100 ALI ENAKOVREDNO).	386120	1.022	KOM						
CEVKA ZA MERJENJE CO2.NOTRANJI PREMER 1,2mm.VSEBUJE DODATNI LUER LOCK KOMOLČEK PREMERA 7,6mm.DOLŽINA 1,8m.(INTERURG. 2725100 ALI ENAKOVREDNO).	432814	1.184	KOM						
CEVKA ZA MERJENJE IN DOVAJANJE KISIKA.NOTR PREMER 3,6MM.NA ENI STRANI OBJEMKA Z NOTR. PREM.5MM IN LUERLOCK SPOJKA S KOMOLČK.PREM.7,6MM NA DRUGI STR.KOMOLČEK LOČLJIV OD CEVKE.(INTERSURG2723 ALI ENAKOV)	388343	211	KOM						
CPAP SIST.ZA TUBUS OZ.KANILO.PREVLEČEN Z BAKTERICIDNO PREVLEKO S SREBROVIMI IONI.PREIZKUŠ.NA UČINKOVITOST PREPREČEV.OKUŽBE Z MRSA IN STAPHYLOCOCCUS IN AUREUS.(INTERSURGICAL 2234001 ALI ENAKOVREDNO).	433594	41	KOM						
DRŽALO ZA CEVI BREZ KOVINSKIH DELOV Z UPOGLJIVIM NOSILCEM.DRŽALO IMA NA KONCU NOSILEC S ŠTIRIMI UTORI.DVA UTORA STA PREMERA 10MM IN DVA 15MM.(INTERSURGICAL 5905 ALI ENAKOVREDNO).	434256	2	KOM						
DRŽALO ZA CEVI BREZ KOVINSKIH DELOV. Z UPOGLJIVIM NOSILCEM,KI IMA NA KONCU NOSILEC Z DVEMA UTOROMA,PREMERA 22 MM,DVEMA UTOROMA PREMERA 15MM IN ENIM UTOROM PREM.30MM.(INTERSURG. 5904 ALI ENAKOVREDNO).	388793	4	KOM						
KATETER NOSNI ZA KISIK,DVOROZI OTROŠKI,DOLŽINA 1,8M,CEVKA IMA NOTRANJI PREMER ZVEZDASTE OBLIKE, NASTAVEK ZA PRIKLJUČITEV NA POVEZOVALNO CEV.(INTERSURG. 1163 ALI ENAKOVREDNO).	423912	2	KOM						

SPECIFIKACIJA PONUDBE S CENAMI - za 1. obdobje

Predmet JN: **88 Medicinski potrošni material 2, 2016-2018**
04 ANESTEZIJA.Dihalni sistemi in drugi pripom.-100% sk.

CPV: 33196000

Naziv artikla	ident JN	Predv. količ.	EM	Cena brez DDV	DDV%	MDC z DDV	Cena z DDV	Vrednost z DDV	Proizvajalec
KATETER NOSNI ZA KISIK,DVOROGI ZA NOVOROJENCE.DOLŽINA KATET.MED 1,8 IN 2,0M. CEVKA ZA KISIK Z NOTR.STENO ZVEZDASTE OBLIKE ZA PREPREČEVANJE KOLENČENJA. KATETER BREZ PHT-JA.(INTERSURG.1160001 ALI ENAK	832766	2	KOM						
KATETER NOSNI ZA KISIK,DVOROGI,ZA DOJENČKE, DOLŽINA KATET. MED 1,8M IN 2,0M.CEVKA ZA KISIK Z NOTR.STENO ZVEZDASTE OBLIKE ZA PREPREČEVAN.KOLENČENJA KATETER BREZ PHT-JA (INTERSURG.1164 ALI ENAKOVR.)	660132	41	KOM						
KATETER NOSNI ZA KISIK,DVOROGI,ZA NEDONOŠENČKE.DOLŽINA KATET.MED 1,8M IN 2,0M.CEVKA ZA KISIK Z NOTR.STENO ZVEZDASTE OBLIKE ZA PREPREČEV.KOLENČENJA.KATETER BREZ PHT-JA (INTERSURG.1160 ALI ENAKOVR.)	832758	2	KOM						
KATETER NOSNI ZA,KISIK DVOROGI ZA ODRASLE, DOLŽINE 1,8M Z IZBOKLINO POD NOSOM PROTI PREMIKANJU,CEVKA ZA KISIK IMA NOTRANJO STENO ZVEZDASTE OBLIKE.V UŠESNEM PREDELU MORA BITI CEV OBLAZINJENA PROTI RAZJEDAM (INTERSURG.1165002 ALI ENAKOVR.).	388734	8.392	KOM						
KOMOLČEK GIBLJIVI 22M-15F/15M.GIBLJIV OKOLI OSI NA OBEH STRANEH,KOMOLČEK NE SME VSEBOVATI ODPRTIN. (INTERSURGICAL 1897 ALI ENAKOVREDNO).	388661	29	KOM						
KONEKT KOMOLČEK FIKSNI 22M/15F IN 22M.(INTERSURGICAL 1892 ALI ENAKOVREDNO).	388572	20	KOM						
KONEKT ZA CEV-ELASTIČEN.(INTERSURG.1704 ALI ENAKOVREDNO).	334634	56	KOM						
KONEKT ZA KISIK 22M/15F S KONUSNIM NASTAVKOM 6,5MM,POSAMEZNO PAKIRAN , (INTERURGICAL 1974 ALI ENAKOVREDNO).	336777	182	KOM						
KONEKT 15M/22M.(INTERSURGICAL 1943 ALI ENAKOVREDNO).	430048	162	KOM						
KONEKT 22F-22M Z ZAMAŠKOM IN ODPRTINO 7,6MM. (INTERSURGICAL 1964 ALI ENAKOVREDNO).	388556	203	KOM						
KONEKT 22F-22m.(INTERSURGICAL 1967 ALI ENAKOVREDNO).	388432	2	KOM						
KONEKTOR T , DIMENZIJE :22F+22M+22M/15F .(INTERSURGICAL 1986 ALI ENAKOVREDNO).	429449	308	KOM						
KONEKTOR T,DIMENZIJE:22M+22M/15F+22M IN PORT ZA SESANJE 7,6MM S PRITRJENIM POKLOPCEM.(INTERSURGICAL 1984 ALI ENAKOVREDNO).	388564	1.906	KOM						

SPECIFIKACIJA PONUDBE S CENAMI - za 1. obdobje

Predmet JN: **88 Medicinski potrošni material 2, 2016-2018**
04 ANESTEZIJA.Dihalni sistemi in drugi pripom.-100% sk.

CPV: 33196000

Naziv artikla	ident JN	Predv. količ.	EM	Cena brez DDV	DDV%	MDC z DDV	Cena z DDV	Vrednost z DDV	Proizvajalec
MASKA OBLAZINJENA ZA CPAP INHALATOR- ODRASLA(S)Z VENTILOM ZA POLNJENJE,NASTAVKI ZA PRITRDITEV,PROZORNA,MEHKI ROB.(VITAL S. 9000 ALI ENAKOVREDNO).	442895	2	KOM						
MASKA ZA CPAP SISTEM. GLEJ PRILOGO 3.	532754	2	KOM						
MASKA OBLAZINJENA ,VELIKOST ONAČENA TUDI Z BARVNO OZNAKO,PROZORNA,ROB NI NAPIHLJIV IN NE VSEBUJE ZRAKA,MASKA NE VSEBUJE PVC.VELIKOST ŠT.6.(INTERSURGICAL 7096 ALI ENAKOVREDNO).	667668	2	KOM						
MASKA OBLAZINJENA ,VELIKOST OZNAČENA TUDI Z BARVNO OZNAKO,PROZORNA,ROB NI NAPIHLJIV IN NE VSEBUJE ZRAKA,MASKA NE VSEBUJE PVC,VELIKOST ŠT.4.(INTERSURGICAL 7094 ALI ENAKOVREDNO).	667641	2	KOM						
MASKA OBLAZINJENA ,VELIKOST OZNAČENA TUDI Z BARVNO OZNAKO,PROZORNA,ROB NI NAPIHLJIV IN NE VSEBUJE ZRAKA,MASKE NE VSEBUJE PVC,VELIKOST ŠT.3.(INTERSURGICAL 7093 ALI ENAKOVREDNO).	667633	2	KOM						
MASKA OBLAZINJENA ,VELIKOST TUDI Z BARVNO OZNAKO ,PROZORNA ,ROB NI NAPIHLJIV IN NE VSEBUJE ZRAKA MATERIAL NE VSEBUJE PVC,VELIKOST ŠT.0.(INTERSURGICAL 7090 ALI ENAKOVREDNO).	667609	2	KOM						
MASKA OBLAZINJENA ŠT.4 ZA ODRASLE-SREDJA Z MEŠIČKOM IN VENTILOM ZA NAPIHOVANJE-ODIŠAVLJENA, PROZORNA. (INTERSURGICAL 1124 ALI ENAKOVREDNO).	388467	2.448	KOM						
MASKA OBLAZINJENA ŠT3.Z MEŠIČKOM IN VENTILOM ZA NAPIHOVANJE.PROZORNA,ODIŠAVLJENA.(INTERURGICAL 1123 ALI ENAKOVREDNO).	437930	4.013	KOM						
MASKA OBLAZINJENA,VELIKOST ONAČENA TUDI Z BARVNO OZNAKO,PROZORNA,ROB NI NAPIHLJIV IN NE VSEBUJE ZRAKA,MATERIAL NE VSEBUJE PVC,VELIKOST ŠT.1. (INTERSURGICAL 7091 ALI ENAKOVREDNO).	667617	2	KOM						
MASKA OBLAZINJENA,VELIKOST OZNAČENA TUDI Z BARVNO OZNAKO,PROZORNA,ROB NI NAPIHLJIV IN NE VSEBUJE ZRAKA, VELIKOST ŠT.5.(INTERSURGICAL 7095 ALI ENAKOVREDNO).	667650	2	KOM						
MASKA oblazinjena,velikost označena tudi z barvno oznako,PROZORNA,ROB NI NAPIHLJIV IN NE VSEBUJE ZRAKA,MASKA NE VSEBUJE PVC,VELIKOST ŠT.2.(INTERSURGICAL 7092 ALI ENAKOVREDNO).	667625	2	KOM						
MASKA OBLAZINJENA-NEONATALNA VELIKOST 0, Z MEŠIČKOM IN VENTILOM ZA NAPIHOVANJE,ODIŠAVLJENA,PROZORNA. (INTERURGICAL 1127 ALI ENAKOVREDNO).	584991	65	KOM						

SPECIFIKACIJA PONUDBE S CENAMI - za 1. obdobje

Predmet JN: **88 Medicinski potrošni material 2, 2016-2018**
04 ANESTEZIJA.Dihalni sistemi in drugi pripom.-100% sk.

CPV: 33196000

Naziv artikla	ident JN	Predv. količ.	EM	Cena brez DDV	DDV%	MDC z DDV	Cena z DDV	Vrednost z DDV	Proizvajalec
MASKA OBLAZINJENA-ŠT.1 ZA DOJENČKE Z MEŠIČKOM IN VENTILOM ZA NAPIHOVANJE,ODIŠAVLJENA, PROZORNA.(INTERSURGICAL 1128 ALI ENAKOVREDNO).	388530	130	KOM						
MASKA OBLAZINJENA-ŠT.5 ZA ODRASLE ZMEŠIČKOM IN VENTILOM ZA NAPIHOVANJE- ODIŠAVLJENA, PROZORNA.(INTERSURGICAL 1125 ALI ENAKOVREDNO).	388459	1.192	KOM						
MASKA OBLAZINJENAŠT.2 ZA OTROKE Z MEŠIČKOM IN VENTILOM ZA NAPIHOVANJE, ODIŠAVLJENA, PROZORNA.(INTERURGICAL 1129 ALI ENAKOVREDNO).	388548	738	KOM						
MASKA ZA DOVOD 100% KISIKA ZA ODRSLE ,MASKA IMA NOSNI STIŠČEK, DOLŽINA CEVI ZA KISIK NAJMANJ 1,8M ,PROZORNA ,BREZBARVNA Z INDIKATORJEM DIHANJA (INTERSURGICAL 1202 ALI ENAKOVREDNO).	563927	697	KOM						
MASKA ZA DOVOD 100% KISIKA Z ENIM ENOSMERNIM VENTILOM IN INDIKATORJEM DIHANJA.CEVKA ZA KISIK IMA NOTRANJO STENO ZVEZDASTE OBLIKE.ZA OTROKE, (INTERSURGICAL 1292 ALI ENAKOVREDNO).	563919	16	KOM						
MASKA ZA KISIK S KONEKT.ZA MERJENJE CO2. V KOMPLETU CEV ZA KISIK Z NOTR.STENO ZVEZDASTE OBLIKE PROTI KOLENČENJU IN CEVKA ZA MONITORING CO2. (INTERSURG. 1143 ALI ENAKOVREDNO)	832855	2	KOM						
MASKA ZA KISIK ZA ODRASLE,NE VSEBUJE PVC,IMA CEVKO ZA KISIK DOLŽINE VSAJ 1,8M(INTERSURGICAL 1135 ALI ENAKOVREDNO).	750093	7.152	KOM						
MASKA ZA KISIK ZA OTROKE S STIŠČKOM IN S CEVJO,KI IMA NOTRANJO STENO ZVEZDASTE OBLIKE.(INTERSURGICAL 1196015 ALI ENAKOVREDNO).	424552	536	KOM						
MASKA ZA KISIK ZA TRAHEOSTOMO ZA ODRASLE Z VRTLJIVIM PRIKLJUČKOM. MASKA NE SME VSEBOVATI PVC-JA. (INTERSURGICAL1200050 ALI ENAKOVREDNO).	528862	2	KOM						
MASKA ZA NEBULIZER -OTROŠKA Z GIBLJIVIM KONEKTOM. (INTERSURGICAL 1148 ALI ENAKOVREDNO).	388491	1.447	KOM						
MASKA ZA NEBULIZER ZA ODRASLE BREZ PVC,S STIŠČKOM Z GIBLJIVIM NASTAVKOM 22M.(INTERSURGICAL 1108 ALI ENAKOVREDNO).	388505	1.906	KOM						
MASKA ZA NEBULIZER ZA ODRASLE,SREDNJA Z VENTILOM. (INTERSURGICAL 1101 ALI ENAKOVREDNO).	423939	1.930	KOM						
NASTAVEK ZA AEROSOL TERAPIJO ZA BOLNIKE NA VENTILATORJU,KONEKT 15M-15F Z GIBLJIVO RAZPRŠILNO ŠOBO. (INTERSURGICAL 1947001 ALI ENAKOVREDNO).	388688	20	KOM						

SPECIFIKACIJA PONUDBE S CENAMI - za 1. obdobje

Predmet JN: **88 Medicinski potrošni material 2, 2016-2018**
04 ANESTEZIJA.Dihalni sistemi in drugi pripom.-100% sk.

CPV: 33196000

Naziv artikla	ident JN	Predv. količ.	EM	Cena brez DDV	DDV%	MDC z DDV	Cena z DDV	Vrednost z DDV	Proizvajalec
NASTAVEK ZA AEROSOL TERAPIJO ZA BOLNIKE NA VENTILATORJU,KONEKT 22M/22F Z GIBLJIVO RAZPRŠILNO ŠOBO. (INTERSURGICAL1964-001 ALI ENAKOVREDNO).	611522	284	KOM						
NASTAVEK ZA TUBUS RAZTEGLJIV OD 110MM DO 170MM Z GIBLJIVIM KOMOLČKOM.MOŽNOST SP.MRTVEGA PROST OD 20ML DO 40ML.KONKT PRI DIH.SIST.22MM NOTRANJI PREMIER. (INTERSURGICAL 3512 ALI ENAKOVREDNO).	388807	5.116	KOM						
NASTAVEK ZA TUBUS RAZTEGLJIV. GLEJ PRILOGO 3.	729523	3.433	KOM						
NEBULIZER HOT TOP 72% SKUP VOLUMNA DELCEV JE PRI PRETOKU 8 L MANJŠIH OD 5 MIKR.IZHOD JE 0.50g/min. PRI PRETOKU 8L.KOMPLET ZA ODR. Z MASKO S STIŠČ. CEVKO Z NAVOJEM,SP. (INTERSU 1473015 ALI ENAKOVREDNO)	528838	5.132	KOM						
NEBULIZER HOT-TOP. PRI PRETOKU 8L/MIN MORAJO BITI DELCI MANJŠI OD 5 MIKRONOV. Z NAVOJEM ZA PRITRDITEV CEVKE (INTERSURGICAL 1471 ALI ENAKOVREDNO).	439223	527	KOM						
NEBULIZER ZA ZDRAVILA ,ZAGOTAVLJA PRI PRETOKU 8L/MIN DELCE MANJŠE OD 5 MIK.UČINKOVITOST VSAJ 74%.(INTERSURGICAL 1402 ALI ENAKOVREDNO).	388475	1.155	KOM						
NEBULIZER ZA ZDRAVILA ,90%SKUPNEGA VOLUMNA DELCEV JE PRI PRETOKU 8L/MIN MANJŠIH OD 2 MIKRONA.(INTERSURGICAL 1503 ALI ENAKOVREDNO).	388483	81	KOM						
NEBULIZER ZA ZDRAVILA S T KONEKTOM.ZAGOTAVLJA PRI PRETOKU 8L/MIN DELCE MANJŠE OD 5 MIK,UČINKOVITOST VSAJ 74%,KOMPLET S CEVKO.(INTERSURGICAL 1485 ALI ENAKOVREDNO).	388360	486	KOM						
NEBULIZER ZA ZDRAVILA Z MASKO ZA OTROKE, PRI PRET 8L /MIN,DELCI MANJŠI OD 5 MIK.IZHOD JE 0.50g/min..KOMPL.S PROZORNO MASKO S STIŠČ. IN CEVKO Z NAVOJEM,IN KONEKT ZA O2.(INTERSURG 1474 ALI ENAKOVREDNO)	528846	2	KOM						
NEBULIZER ZA ZDRAVILA ZA ALVEOLARNO DEPOZICIJO. GLEJ PRILOGO 3.	388769	1.662	KOM						
NEBULIZER ZA ZDRAVILAZ MASKO ZA ODRASLE,PRI PRETOKU 8L/MIN DELCI MANJŠI OD 5 MIKRONOV,UČINKOVITOST VSAJ 74% ,KOMPLET Z OBRAZNO MASKO,GIBLJIVIM KONEKTOM IN CEVKO. (INTERSURGICAL 1493004 ALI ENAKOVREDNO	388378	2	KOM						
ROČNI DIHALNIK KOMPLET,VOL.1L ZA OTR.VSEBUJE CEVKO ZA KISIK 2M Z NOTRANJO STENO ZVEZDASTE OBLIKE IN VREČKO ZA KISIK.KOMOLČEK Z VAROVANIM VENTIL.(INTERSURGICAL 7153 ALI ENAKOVREDNO).	425486	5	KOM						

SPECIFIKACIJA PONUDBE S CENAMI - za 1. obdobje

Predmet JN: **88 Medicinski potrošni material 2, 2016-2018**
04 ANESTEZIJA.Dihalni sistemi in drugi pripom.-100% sk.

CPV: 33196000

Naziv artikla	ident JN	Predv. količ.	EM	Cena brez DDV	DDV%	MDC z DDV	Cena z DDV	Vrednost z DDV	Proizvajalec
ROČNI DIHALNIK KOMPLET,vol.280ml,ne vsebuje lateksa,cevka ima zvezdasti notranji prem.za preprečitev mašenja,rezervoar za kisik,obrazna maska,komolček ima varovalni ventil.(INTERS 7150 ALI ENAKOVREDNO	425478	2	KOM						
ROČNI DIHALNIK KOMPLET,volumen 1500 ml,ne vsebuje lateksa,cevka za kisik ima zvezdasti notr.premer za preprečitev mašenja, ima rezervoar za kisik in obrazno masko.(INTERSURGICAL 7152 ALI ENAKOVREDNO).	388408	73	KOM						
ROČNI DIHALNIK KOMPLET,za otroke,vol.550ml,brez lateksa,cevka za kisik ima zvezdasti notr.prem.Komolček med masko in balonom z varnost.valvulo,rezervoar za kisik in obrazna maska,(INT7151 ALI ENAKOVR)	578916	2	KOM						
SISTEM DIHALNI OBOJESTRANSKO PREVLEK. Z ANTIBAKT. PREVLEKO S SREBROVIMI IONI, CEVI DOLŽINA 1,6M,PREMER 22MM,KRAK ZA BALON 0,8M; BALON 2L. Z MREŽO PROTI MAŠENJU. (INTERSURGICAL 2010102 ALI ENAKOVREDNO)	662585	2.408	KOM						
SISTEM DIHALNI KOAKSIALNI,DOLŽ.CEVI 2,4M,INSPIRATORNA CEV SE NAHAJA V EKSPIRATORNI CEVI,KRAK ZA POV.Z APAR.JE RAZTEGLJIV 0,4M,CEVKA ZA CO2 V NOT.LUMNU,BALON 2L ,Z BAKT.ZAŠČ.(INTERSU2902103 ALI ENAKOVR	711276	78	KOM						
SISTEM DIHALNI Z GRELNO ŽICO V INSPR.KRAKU IN KNDENZ.LONČKOM V EKSPIRATORNEM KRAKU.KRAK ZA POVEZAVO VLAŽILCA IN APAR.DOLG 0,4M.KOMPLET VSEBUJE DVE RAZTEGLJIVI SPOJ.22MM.(INTERS.2049002 ALI ENAKOVREDNO	505226	2	KOM						
SISTEM DIHALNI ZA OXILOG1000 Z VENILOM,KI NE VSEBUJE LATEKSA,ZA STANDARDNO VENTILACIJO, PREIZKUŠEN NA UČINKOVITOST PREPREČ.OKUŽBE Z MRSA IN STAPHYLOCOCCUS AUREUS.(INTERSURG.2080103 ALI ENAKOVREDNO).	609102	259	KOM						
SISTEM DIHALNI ZA CPAP Z MASKO-VELIKO ZA ODRASLE,CEVKA ZA MERJENJE PRITISKA,INSPIRAT.CEVJO PEM.22MM IN DVEMA CPAP VENT.(5CM H2O.20CM H2O)SISTEM INTEG.Z BAKT.PREV. (INTERSUGICAL 2230002 ALI ENAKOVREDNO)	486922	511	KOM						
SISTEM DIHALNI ZA DREGER AQUAPOR VLAŽILEC Z DVEMA KONDENZ.LONČKOMA,ODPRTINO ZA TEMPERAT.TIPALO 20MM,DOLŽINA 1,6M,PREM.CEVI 22MM,PREV.OBOJESTRANSKA.S SREBROVIM IONI.(INTERSURG.2034100 ALI ENAKOVREDN)	662593	1.350	KOM						
SISTEM DIHALNI ZA OTR. AYRES T MAPELSOM Z APL VENT.UPOR VENT. PRI ZAPRT. POLOŽAJU IN 15 L/min.PRETOKA JE 35cmH2O.KOMPLET IMA DVA BALONA:1l in 0.5l.KONEK.22M/30F. (INTERSUGICAL 2122012 ALI ENAKOVREDNO).	423017	60	KOM						
SISTEM DIHALNI, KROŽNI OTR. ZA ANESTEZIJO.REBRASTE CEVI PREM.15mm,FRAGMENTI NA 40cm,DOLŽINA 1,6m.BALON 1l,Z ZAŠČITO PROTI MAŠENJU.KRAK ZA BAL.0,8m.(INTERSURG. 4500006 ALI ENAKOVREDNO).	409898	414	KOM						

SPECIFIKACIJA PONUDBE S CENAMI - za 1. obdobje

Predmet JN: **88 Medicinski potrošni material 2, 2016-2018**

CPV: 33196000

04 ANESTEZIJA.Dihalni sistemi in drugi pripom.-100% sk.

Naziv artikla	ident JN	Predv. količ.	EM	Cena brez DDV	DDV%	MDC z DDV	Cena z DDV	Vrednost z DDV	Proizvajalec
SISTEM DIHALNI,IMPREG. Z BAKTER. PREV. Z SREB. IONI, BREZ GRELNE ŽICE, DOLŽINA CEVI 1,6M,PREMER 22MM,PRISKUŠEN NA UČINKOVITOST PREP.OK.MRSA IN STAPHILOCOCCUS AUREU. (INTERSURG.2000101 ALI ENAKOVREDNO)	388351	438	KOM						
SISTEM DIHALNI-CEVI PREMERA 22MM OBOJESTR. IMPREGNIRANE Z ANTIBAKT. PREVLEKO S SREBROVIMI IONI PROTI MRSA IN STAPHILOCOCCUS AUREUS. DOLŽ. CEVI 2,4M.(INTERSURGICAL 2010101ALI ENAKOVREDNO).	662577	827	KOM						
SISTEM DIHALNI-CEVI.ODRASLI,ZA UPORABO PRI MR PREISKAVAH (INTERSURGICAL 2010106 ALI ENAKOVREDNO).	820024	3	KOM						
SISTEM DIHALNI-CEVI.OTROŠKI,ZA UPORABO PRI MR PREISKAVAH (INTERSURGICAL 4500027 ALI ENAKOVREDNO).	820059	7	KOM						
SISTEM KROŽ.DIHALNI KOAKSIALNI,DOLŽINA 1,6M,inspiratorna cev se nahaja v ekspiratorni cevi,krak za pov.z aparatom 0,4m,cevka za CO2 V NOT.LUMNU,BALON 2L,Z BAKT.PREVL. (INTERSUR2902102 ali enakovredno)	506788	32	KOM						
VENTIL PEEP 5CM H2O PRITISKA ZA CPAP SISTEM,PROZOREN,BARVNA OZNAKA NASTAVITVE PRITISKA. (INTERSURGICAL 2205 ALI ENAKOVREDNO).	751324	186	KOM						
VENTURI VENTIL ZA KISIK 24%, POSAMEZNO PAKIRAN,NOTRANJI PREMER 22MM,KONCENTRACIJA KISIKA JE OZNAČENA Z BARVO, KI JE RAZLIČNA OD BARVE VENTILA.(INTERSURGICAL 0024 ALI ENAKOVREDNO).	388599	406	KOM						
VENTURI VENTIL ZA KISIK 28%, POSAMEZNO PAKIRAN,NOTRANJI PREMER 22MM,KONCENTRACIJA NA VENTILU OZNAČENA Z BARVO,KI JE RAZLIČNA OD BARVE VENTILA.(INTERSURGICAL 0028 ALI ENAKOVREDNO).	388602	892	KOM						
VENTURI VENTIL ZA KISIK 31%, POSAMEZNO PAKIRAN,NOTRANJI PREMER 22MM,KONCENTRACIJA KISIKA NA VENTILU JE OZNAČENA Z BARVO KI JE RAZLIČNA OD BARVE VENTILA.(INTERSURGICAL 0031 ALI ENAKOVREDNO).	388629	527	KOM						
VENTURI VENTIL ZA KISIK 35%, POSAMEZNO PAKIRAN ,NOTRANJI PREMER 22MM,KONCENTRACIJA KISIKA JE NA VENTILU OZNAČENA Z BARVO ,KI JE RAZLIČNA OD BARVE VENTILA.(INTERSURGICAL 0035 ALI ENAKOVREDNO).	388637	608	KOM						
VENTURI VENTIL ZA KISIK 40%, POSAMEZNO PAKIRAN,NOTRANJI PREMER 22MM,KONCENTRACIJA KISIKA JE NA VENTILU OZNAČENA Z BARVO,KI JE RAZLIČNA OD BARVE VENTILA.(INTERSURGICAL 0040 ALI ENAKOVREDNO).	388645	1.703	KOM						
VENTURI VENTIL ZA KISIK 50% KISIK,POSAMEZNO PAKIRAN. (INTERSURGICAL 0070 ALI ENAKOVREDNO).	695831	41	KOM						

SPECIFIKACIJA PONUDBE S CENAMI - za 1. obdobje

Predmet JN: **88 Medicinski potrošni material 2, 2016-2018**
04 ANESTEZIJA.Dihalni sistemi in drugi pripom.-100% sk.

CPV: 33196000

Naziv artikla	ident JN	Predv. količ.	EM	Cena brez DDV	DDV%	MDC z DDV	Cena z DDV	Vrednost z DDV	Proizvajalec
VENTURI VENTIL ZA KISIK 60%, POSAMEZNO PAKIRAN,NOTRANJJI PEMER 22MM,KONCENTRCIJA KISIKA JE NA KONEKTU OZNAČENA Z BARVO,KI JE RAZLIČNA OD BARVE VENTILA.(INTERSURGICAL 0060 ALI ENAKOVREDNO).	388653	973	KOM						
VLAŽILEC ZA TUBUS IN KANILO S CEVZA KISIK-NOS UMETNI.POVRAČILO VLAGE PRI VT500ml=27mgH2O/l.ZAVAROVANA ODPRTINA ZA ASPIRACIJO S POKROVOM,KI JE PRITRJAN NA ROB ODPRTINE.(INTERSURG.1874 ALI ENAKOVREDNO).	329851	211	KOM						
VLAŽILEC ZA TUBUS IN KANILO-NOS UMETNI.POVRAČILO VLAGE PRI VT500ml=27mgH2O/l,ZAVAROV.ODPRTINA ZA ASPIR.S PRITRJENIM POKR.VAROVALNI MEHANIZEM PROTI ZADUŠITVI,GIBLJIV KON.(INTERSURG.1873 ALI ENAKOVREDNO).	388394	4.298	KOM						

VREDNOST SKUPAJ:

88

301.221,39 €

0,00 €

ŽIG IN PODPIS:

PONUĐNIK: .

NAROČNIK UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER MARIBOR
Ljubljanska ulica 5, 2000 MARIBOR

Datum: 1.10.2015

Stran: 1

SPECIFIKACIJA PONUDBE S CENAMI - za 1. obdobje

Predmet JN: **88 Medicinski potrošni material 2, 2016-2018**

CPV: 33196000

05 ANESTEZIJA.Filtri bakteriološki - 100% sk.GLEJ PRIL.2

Naziv artikla	ident JN	Predv. količ.	EM	Cena brez DDV	DDV%	MDC z DDV	Cena z DDV	Vrednost z DDV	Proizvajalec
FILTER VIRALNO BAKTERIOLOŠKI. GLEJ PRILOGO 2.	329479	17.578	KOM						
FILTER VIRALNO BAKTERIOLOŠKI. GLEJ PRILOGO 2.	386138	10.086	KOM						
FILTER VIRALNO BAKTERIOLOŠKI. GLEJ PRILOGO 2.	386146	843	KOM						
FILTER VIRALNO BAKTERIOLOŠKI. GLEJ PRILOGO 2.	430129	49	KOM						

VREDNOST SKUPAJ:

4

81.561,29 €

0,00 €

ŽIG IN PODPIS:

SPECIFIKACIJA PONUDBE S CENAMI - za 1. obdobje

Predmet JN: **88 Medicinski potrošni material 2, 2016-2018**

CPV: 33196000

06 ANESTEZIJA.Igle za spinalno anest.-atravmatske-100%sk

Naziv artikla	ident JN	Predv. količ.	EM	Cena brez DDV	DDV%	MDC z DDV	Cena z DDV	Vrednost z DDV	Proizvajalec
IGLA ZA SUBARAHNOIDNO ANESTEZIJO G25 X 4 3/4"(120MM)TIPA SPROTTE S PROZORNIM LUER NASTAVKOM IN Z ODGOVARJAJOČIM INTRODUKTORJEM.(PAJUNK 051151-29A ALI ENAKOVREDNO).	508241	81	KOM						
IGLA ZA SUBARAHNOIDNO ANESTEZIJO G25X 90MM TIPA SPROTTE S PROZORNIM LUER NASTAVKOM Z INTEGRIRANO LUPO IN Z ODGOVARJAJOČIM INDUKTORJEM DOLŽINE 3CM. (PAJUNK 511151-29A ALI ENAKOVREDNO).	330272	2.635	KOM						
IGLA ZA SUBARAHNOIDNO ANESTEZIJO G27 X 90MM TIPA SPROTTE S PROZORNIM LUER NASTAVKOM Z INTEGRIRANO LUPO IN Z ODGOVARJAJOČIM INDUKTORJEM DOLŽINE 3CM. (PAJUNK 121151-27A ALI ENAKOVREDNO).	382299	2	KOM						

VREDNOST SKUPAJ:

3

31.545,11 €

0,00 €

ŽIG IN PODPIS:

SPECIFIKACIJA PONUDBE S CENAMI - za 1. obdobje

Predmet JN: **88 Medicinski potrošni material 2, 2016-2018**

CPV: 33196000

08 ANESTEZIJA.Katetri periferni venski-100% sk.

Naziv artikla	ident JN	Predv. količ.	EM	Cena brez DDV	DDV%	MDC z DDV	Cena z DDV	Vrednost z DDV	Proizvajalec
KATETER PERIFERNI VENSKI; 1 LUMNI 1,2 X 1,7MM, DOLŽINA 70CM,PRETOK 30ML/MIN/0,8ML, KANILA 1,9 X 2,3M	326364	162	KOM						
KATETER PERIFERNI VENSKI;1 LUMNI 1,5 X 2,0MM, DOLŽINA 70CM, PRETOK 50ML/MIN/1,1ML, KANILA 2,1 X 2,7M	344303	244	KOM						

VREDNOST SKUPAJ:

2

3.453,99 €

0,00 €

ŽIG IN PODPIS:

SPECIFIKACIJA PONUDBE S CENAMI - za 1. obdobje

Predmet JN: **88 Medicinski potrošni material 2, 2016-2018**

CPV: 33196000

09 ANESTEZIJA.Potrošni material za "HAEMONETICS"-100%sk.

Naziv artikla	ident JN	Predv. količ.	EM	Cena brez DDV	DDV%	MDC z DDV	Cena z DDV	Vrednost z DDV	Proizvajalec
BASIC A/C"- ZA ASPIRAT,1 X ANTIKOAGULANTNI APIRACIJSKI SISTEM ZA "CELL SAVER".(HAEMONETICS 208 ALI ENAKOVREDNO).	424722	393	KOM						
NASTAVEK ZA ASPIRACIJO,5 X 10MM-DOLŽINA 27CM, ZA "CELL SAVER" SISTEM. KODA-68175.(PFM 33093182 ALI ENAKOVREDNO).	424749	2	KOM						
STEKLENICA 225ML-SET ZA 1X UPORABO ZA "CELL SAVER". (HAEMONETICS 263 ALI ENAKOVREDNO)	424706	356	KOM						
ZBIRNI REZERVOAR ,MAKSIMALNA KAPACITETA 3000ML ZA "CELL SAVER".(HAEMONETICS 205 ALI ENAKOVREDNO).	424714	379	KOM						

VREDNOST SKUPAJ:**4****88.899,47 €****0,00 €****ŽIG IN PODPIS:**

SPECIFIKACIJA PONUDBE S CENAMI - za 1. obdobje

Predmet JN: **88 Medicinski potrošni material 2, 2016-2018**
10 ANESTEZIJA.Pripomočki za aspiracijo-100%sk.

CPV: 33196000

Naziv artikla	ident JN	Predv. količ.	EM	Cena brez DDV	DDV%	MDC z DDV	Cena z DDV	Vrednost z DDV	Proizvajalec
DRŽALO ZA POSODE, SEP-T-VAC (COVIDIEN 000844 ALI ENAKOVREDNO)	425320	2	KOM						
PRAŠEK ŽELIRNI, PAKIRANJE PO 20G, (COVIDIEN, SEP-T VAC 310557 ali enakovredno).	418323	7.297	KOM						
1200 ML FLEKSIBILNA ASPIRACIJSKA VREČKA Z HIDROFOBNI ZAPORNIM VENTILOM,ČISTA , (COVIDIEN,SEP-T-VAC ali enakovredno).	418293	661	KOM						
1200 ML POSODA ZA ASPIRACIJSKO VREČKO,ČISTA, (COVIDIEN, SEP-T VAC ali enakovredno).	418277	26	KOM						
2000 ML FLEKSIBILNA ASPIRACIJSKA VREČKA Z HIDROFOBNI ZAPORNIM VENTILOM,ČISTA , (COVIDIEN, SEP-T-VAC ali enakovredno).	418307	467	KOM						
2000 ML POSODA ZA ASPIRACIJSKO VREČKO,ČISTA, (COVIDIEN, SEP-T-VAC ali enakovredno).	418285	20	KOM						
3000 ML FLEKSIBILNA ASPIRACIJSKA VREČKA, S HIDROFOBNI ZAPORNIM VENTILOM,ČISTA , (COVIDIEN, SEP-T-VAC ali enakovredno).	420646	1.868	KOM						
3000 ML POSODA ZA ASPIRACIJSKO VREČKO,ČISTA, (COVIDIEN, SEP T VAC ali enakovredno).	399329	114	KOM						

VREDNOST SKUPAJ:

8

26.205,65 €

0,00 €

ŽIG IN PODPIS:

SPECIFIKACIJA PONUDBE S CENAMI - za 1. obdobje

Predmet JN: **88 Medicinski potrošni material 2, 2016-2018**

CPV: 33196000

11 ANESTEZIJA.Pribor za hemodinamski monitoring-Picco-100%

Naziv artikla	ident JN	Predv. količ.	EM	Cena brez DDV	DDV%	MDC z DDV	Cena z DDV	Vrednost z DDV	Proizvajalec
KATETER ARTERIJSKI TERMODILUCIJSKI 4F-DOLŽINA 16CM: (PULSION PV2014L16 ali enakovredno)	497410	93	KOM						
KATETER ARTERIJSKI TERMODILUCIJSKI 4F-DOLŽINA 22CM: (PULSION PV2014L22 ali enakovredno)	628085	2	KOM						
KATETER ARTERIJSKI TERMODILUCIJSKI 5F,DOLŽINA 20CM : (PULSION PV2015L20 ali enakovredno)	707660	2	KOM						
MONITORING SET PICCO ZA MONITORING SISTEM PICCO PLUS, (PULSION PV8115-150CM ali enakovredno)	694517	85	KOM						
MONITORING SET PICCO ZA MONITORING SISTEM PICCO:(PULSION PV8115CVP ali enakovredno)	497428	2	KOM						

VREDNOST SKUPAJ:

5

27.510,79 €

0,00 €

ŽIG IN PODPIS:

SPECIFIKACIJA PONUDBE S CENAMI - za 1. obdobje

Predmet JN: **88 Medicinski potrošni material 2, 2016-2018**

CPV: 33196000

12 ANESTEZIJA.Sistemi za merjenje tlaka-100% sk.

Naziv artikla	ident JN	Predv. količ.	EM	Cena brez DDV	DDV%	MDC z DDV	Cena z DDV	Vrednost z DDV	Proizvajalec
ADAPTER ZA ZAPRTI SISTEM ZA ODVZEM KRVİ ZA BOLNIKE, KI SO PRIKLJUČENI NA MONITORING SISTEM.(PVB HG-01 ALI ENAKOVREDNO).	487007	20.838	KOM						
SISTEM ZA INVAZIVNO MERJENJE ARTERIJSKEGA TLAKA ZA MONITORJE. BREZ LATEKSA, BARVNO OZNAČENE LINIJE.(PVB AGO005A ALI ENAKOVREDNO).	399345	2	KOM						
SISTEM ZA INVAZIVNO MERJENJE ARTERIJSKEGA TLAKA Z ZAPRTIM SISTEMOM JEMANJA VZORCEV,ZA MONITORJE. BREZ LATEKSA, BARVNO OZNAČENE LINIJE.(PVB AGO005H ALI ENAKOVREDNO).	477141	1.386	KOM						
SISTEM ZA VZPOREDNO INVAZ. MERJENJE TREH TLAKOV Z ZAPRTIM SIST. JEMANJA VZORCEV ARTER.KRVİ NA ENOJNI MANŠETI.POVEZ Z ENOJNIM KABLOM NA MONIT.BREZ LATEKSA,BARVNO OZNAČ.LINIJE (PVB AGO007H ALI ENAK.)	406031	316	KOM						
SISTEM ZA VZPOREDNO INVAZIVNO MERJENJE DVEH TLAKOV NA ENOJNI MANŠETI. ZAPRT SIST.JEMANJA VZORCEV ART.KRVİ.POVEZAVA NA MONIT.PREKO ENOJN.KABLA. BREZ LATEKSA,BARVNO OZNAČ.LINIJE (PVB AGO006H ALI ENAKOV)	406872	1.569	KOM						

VREDNOST SKUPAJ:

5

97.826,12 €

0,00 €

ŽIG IN PODPIS:

SPECIFIKACIJA PONUDBE S CENAMI - za 1. obdobje

Predmet JN: **88 Medicinski potrošni material 2, 2016-2018**

CPV: 33196000

13 ANESTEZIJA.Supraglotični pripomočki-100% sk.GLEJ PRIL.1

Naziv artikla	ident JN	Predv. količ.	EM	Cena brez DDV	DDV%	MDC z DDV	Cena z DDV	Vrednost z DDV	Proizvajalec
LARINGEALNE MASKE, I-GEL ZA INTUB.,OTROŠKE (INTERSURGICAL 8201 ALI ENAKOVREDNO.	807281	49	KOM						
LARINGEALNE MASKE, I-GEL ZA INTUB.,OTROŠKE (INTERSURGICAL 8202 ALI ENAKOVREDNO)	807303	81	KOM						
LARINGEALNE MASKE, I-GEL ZA INTUB.,OTROŠKE (INTERSURGICAL 8215 ALI ENAKOVREDNO)	807290	73	KOM						
LARINGEALNE MASKE, I-GEL ZA INTUB.,OTROŠKE (INTERSURGICAL 8225 ALI ENAKOVREDNO)	807311	89	KOM						
MASKA LARINGEALNA ŠT.1 ZA 1XUPORABO.	663085	2	KOM						
MASKA LARINGEALNA ŠT.1,5 ZA 1XUPORABO.	659452	2	KOM						
MASKA LARINGEALNA ŠT.2 ZA 1XUPORABO.	663077	2	KOM						
MASKA LARINGEALNA ŠT.2,5 ZA 1XUPORABO.	675563	2	KOM						
MASKA LARINGEALNA ŠT.3 ,ZA 1 XUPORABO.	664596	2	KOM						
MASKA LARINGEALNA ŠT.4,1X UPORABO.	664588	2	KOM						
MASKA LARINGEALNA ŠT.5,1X UPORABO.	664600	2	KOM						
MASKA LARINGEALNA ŠT:1,prilagojena uporabi v področju magnetnega polja,brez vsebnosti kovine.	424153	2	KOM						
MASKA LARINGEALNA ŠT:1,5,prilagojena uporabi v področju magnetnaga polja,brez vsebnosti kovine.	424170	2	KOM						
MASKA LARINGEALNA ŠT:2,prilagojena uporabi v področju magnetnega polja,brez vsebnosti kovine.	424161	2	KOM						
MASKA LARINGEALNA ŠT:2,5,prilagojena uporabi v področju magnetnaga polja,brez vsebnosti kovine.	424188	2	KOM						
MASKA LARINGEALNA ŠT:3,prilagojena uporabi v področju magnetnaga polja,brez vsebnosti kovine.	424196	2	KOM						
MASKA LARINGEALNA ŠT:4-,prilagojena uporabi v področju magnetnaga polja,brez vsebnosti kovine.	424200	2	KOM						
MASKA LARINGEALNA ŠT:5.prilagojena uporabi v področju magnetnaga polja,brez vsebnosti kovine.	531669	2	KOM						

SPECIFIKACIJA PONUDBE S CENAMI - za 1. obdobje

Predmet JN: **88 Medicinski potrošni material 2, 2016-2018**

CPV: 33196000

13 ANESTEZIJA.Supraglotični pripomočki-100% sk.GLEJ PRIL.1

Naziv artikla	ident JN	Predv. količ.	EM	Cena brez DDV	DDV%	MDC z DDV	Cena z DDV	Vrednost z DDV	Proizvajalec
OPTIČNI LARINGOSKOP ZA 1XUP. S KANALOM ZA VSTAV.IN UVAJ.TUBUSA.VSEBUJE BATERIJE,NOTRANJJI OPTIČNI KANAL KI OMOGOČA POGLED V SMERI KONICE TUBUSA,OGREV.PROTI KOND.ZA TUB.6-7,5.(AIRTRAQ A-021ALI ENAKOVRED.).	749109	2	KOM						
OPTIČNI LARINGOSKOP ZA 1XUP. S KANALOM ZA VSTAVITEV IN UVAJANJE TUBUSA.VSEBUJE BATERIJE,NOT.OPTIČNI KANAL KI OMOGOČA POGLED V SMERI KONICE TUBUSA.OGREV.PROTI KON.TUB.7-8.(AIRTRAQ:A-011 ALI ENAKOVREDN.).	749095	10	KOM						
OPTIČNI LARINGOSKOP ZA 1XUP.S KANALOM ZA VSTAV.IN UVAJ.TUBUSA.VSEBUJE BATERIJE,NOT.OPTIČNI KAN.KI OMOGOČA POGL.V SMERI KON.TUBUSA-OGREVAN,ZA NAZOGASTRIČ.TUBUSE.(AIRTRAQ:A-051 ALI ENAKOVREDNO).	770094	2	KOM						
OPTIČNI LARINGOSKOP ZA 1XUP.S KANALOM ZA VSTAV.IN UVAJ.TUBUSA.VSEBUJE BATERIJE,NOT.OPTOČ.KANAL KI OMOGOČA POGL.V SMERI KON.TUBUSA.OGREVAN.ZA TUBUS OD.2,5-4,00.(AIRTRAQ:A-041 ALI ENAKOVREDNO).	770086	2	KOM						
OPTIČNI LARINGOSKOP ZA 1XUP.S KANALOM ZA VSTAVITEV IN UVAJ.TUBUSA.VSEBUJE BATERIJE.NOT.OPT.KANAL OMOGOČA POGLED V SMERI KONICE TUBUSA,OGREVAN ZA TUB.4-5,5.(AIRTRAQ:A-031 ALI ENAKOVREDNO).	770078	3	KOM						
SUPRAGLOTIČNI PRIPOMOČEK ZA ODPRTJE DIHALNIH POTI ZA 1 X UPORABO Z NENAPIHLJIVIM MEŠIČKOM, VELIKOST ŠT.5.(INTERSURGICAL-I-GELO2:8705 ALI ENAKOVREDNO).	730661	345	KOM						
SUPRAGLOTIČNI PRIPOMOČEK ZA ODPRTJE DIHALNIH POTI ZA 1 X UPORABO Z NENAPIHLJIVIM MEŠIČKOM,VELIKOST ŠT:3.(INTERSURGICAL-I-GELO2:8703 ALI ENAKOVREDNO).	730645	284	KOM						
SUPRAGLOTIČNI PRIPOMOČEK ZA ODPRTJE DIHALNIH POTI ZA 1 X UPORABO Z NENAPIHLJIVIM MEŠIČKOM. VELIKOST ŠT.4.(INTERSURGICAL-I-GELO2:8704 ALI ENAKOVREDNO).	730653	1.004	KOM						

VREDNOST SKUPAJ:

26

43.682,38 €

0,00 €

ŽIG IN PODPIS:

SPECIFIKACIJA PONUDBE S CENAMI - za 1. obdobje

Predmet JN: **88 Medicinski potrošni material 2, 2016-2018**

CPV: 33196000

14 ANESTEZIJA.Tubusi endotrahealni-PVC-100% sk.

Naziv artikla	ident JN	Predv. količ.	EM	Cena brez DDV	DDV%	MDC z DDV	Cena z DDV	Vrednost z DDV	Proizvajalec
TUBUS TRAHEALNI 7,0MM-ZUNANJI PREMER DO 9,6MM, Z NIZKOT. MEŠIČKOM IN MRPHY. OČESOM-VELIKIM VOLUM,GRADUIRAN,RADIOPAČEN,KONICA ATRAUM. OBLIKOV,MATERIAL-PVC,GLADKA NOTR. POVRŠINA	477427	778	KOM						
TUBUS TRAHEALNI 7,5MM-ZUNANJI PREMER DO 10,2MM,Z NIZKOT. MEŠIČKOM IN MPRHY. OČESOM-VELIKIM VOLUM,GRADUIRAN,RADIOPAČEN,KONICA ATRAUM. OBLIKOV,MATERIAL-PVC,GLADKA NOTR. POVRŠINA,	482722	1.654	KOM						
TUBUS TRAHEALNI 8,0MM-ZUNANJI PREMER DO 11,0MM, Z NIZKOT.MEŠIČKOM IN MRPHY. OČESOM-VELIKIM VOLUM,GRADUIRAN,RADIOPAČEN,KONICA ATRAUM. OBLIK,MATERIAL-PVC,GLADKA NOTR. POVRŠINA,	477435	555	KOM						
TUBUS TRAHEALNI 8,5MM-ZUNANJI PREMER DO 11,6MM, Z NIZKOT. MEŠIČKOM MRPHY. OČESOM-VELIKIM VOLUM,GRADUIRAN,RADIOPAČEN,KONICA ATRAUM.OBLIK.MATERIAL-PVC,GLADKA NOTR. POVRŠINA,	470503	1.334	KOM						
TUBUS TRAHEALNI 9,0MM-ZUNANJI PREMER DO 12,3MM, Z NIZKOT. MEŠIČKOM IN MPRHY.-VELIKIM VOLUM,GRADUIRAN,RADIOPAČEN,KONICA ATRAUM. OBLIKOV,MATERIAL-PVC,GLADKA NOTR. POVRŠINA,	565016	49	KOM						

VREDNOST SKUPAJ:

5

3.124,56 €

0,00 €

ŽIG IN PODPIS:

SPECIFIKACIJA PONUDBE S CENAMI - za 1. obdobje

Predmet JN: **88 Medicinski potrošni material 2, 2016-2018**

CPV: 33196000

15 ANESTEZIJA.Tubusi endotrahealni-PVC silikoniziran-100% sk.

Naziv artikla	ident JN	Predv. količ.	EM	Cena brez DDV	DDV%	MDC z DDV	Cena z DDV	Vrednost z DDV	Proizvajalec
TRAK SAMOLEPILNI ZA PRITRDITEV TUBUSA.(DALE 270 ALI ENAKOVREDNO).	472379	1.691	KOM						
TUBUS TRAHEALNI 5,0MM- ZUNANJI PREMER DO 6,9MM,,Z NIZKOTLAČNIM MESIČKOM IN VELIKIM VOLUM, MRPHY. OČESOM,GRADUIRAN,RADIOPAČEN,ATRAUMATSKA KONICA-PVC-SILIKONIZ.GLADKA NOTRA.POVRŠ,	344907	73	KOM						
TUBUS TRAHEALNI 5,5MM-ZUNANJI PREMER DO 7,5MM,Z NIZKOTLAČNIM MESIČKOM IN VELIKIM VOLUM, MRPHY. OČESOM,GRADUIRAN,RADIOPAČEN,ATRAUMATSKA KONICA-PVC-SILIKONIZ.GLADKA POVRŠINA,	325902	81	KOM						
TUBUS TRAHEALNI 6.0MM-ZUNAJI PREMER DO 8,2MM,Z NIZKOTL. MESIČKOM IN VELIKIM VOLUM, Z MRPHY. OČESOM,GRADUIRAN,RADIOPAČEN,ATRAUM. KONICA -PVC-SILIKONIZ.GLADKA NOTRAN POVRŠINA,	344893	65	KOM						
TUBUS TRAHEALNI 6.5MM-ZUNAJI PREMER DO 8,8MM,Z NIZKOT. MESIČKOM IN VELIKIM VOLUM, Z MRPHY. OČESOM,GRADU.,RADIOPAČEN,ATRAUM. KONICA- PVC-SILIKONIZIRAN. GLADKA NOTRA. POVRŠINA,	344842	49	KOM						
TUBUS TRAHEALNI 7,0MM-ZUNANJI PREMER DO 9,6MM,Z NIZKOTL. MESIČKOM IN VELIKIM VOLUM. IN MRPHY. OČESOM,GRADUIRAN,RADIOPAČEN,ATRAUM. KONICA-PVC -SILIKONIZ.GLADKA NOTR. POVRŠINA,	629197	81	KOM						
TUBUS TRAHEALNI 7.5MM-ZUNANJI PREMER DO 10,2MM,Z NIZKOT. MESIČKOM IN VELIKIM VOLUM,GRADUIRAN,MRPHY. OČESOM,RADIOPAČEN,ATRAUM. KONICA-PVC-SILIKON. GLADKA NOTRANJA POVRŠINA,	629219	25	KOM						
TUBUS TRAHEALNI 8,0MM-ZUNANJI PREMER DO 11,0MM,,Z NIZKOTL. MESIČKOM IN VELIKIM VOLUM, MPRHY. OČESOM,GRADUIRAN,RADIOPAČEN,ATRAUMA KONICA-PVC-SILIKON.GLADKA NOTRANJA POVRŠINA,	629227	33	KOM						
TUBUS TRAHEALNI 8.5MM-ZUNANJI PREMER DO 11,6MM, Z NIZKOTL.MESIČKOM IN VELIKIM VOLUM, MRPHY. OČESOM,GRADUIRAN,RADIOPAČEN,ATRAUM. KONICA-PVC -SILIKON.GLADKA NOTRANJA POVRŠINA,	629235	73	KOM						
TUBUS TRAHEALNI 9.0MM-ZUNANJI PREMER DO 12,3MM, Z NIZKOTL. MESIČKOM IN VELIKIM VOLUM, MRPHY. OČESOM,GRADUIRAN,RADIOPAČEN,ATRAUM. KONICA-PVC-SILIKON.GLADKA NOTRANJ POVRŠINA,	629243	65	KOM						
VODILO ZA TUBUS 2,0-3,5MM.(SMITHS-PORTEX 100/120/100 ALI ENAKOVREDNO).	432911	33	KOM						

SPECIFIKACIJA PONUDBE S CENAMI - za 1. obdobje

Predmet JN: **88 Medicinski potrošni material 2, 2016-2018**

CPV: 33196000

15 ANESTEZIJA.Tubusi endotrahealni-PVC silikoniziran-100% sk.

Naziv artikla	ident JN	Predv. količ.	EM	Cena brez DDV	DDV%	MDC z DDV	Cena z DDV	Vrednost z DDV	Proizvajalec
VODILO ZA TUBUS 4,0MM/335MM. GLADKA NOTRANJ POVRŠINA, OB ENAKEM PREMURU LUMNA TUBUSA ČIM MANJŠI ZUNANJI PREMER.	432903	138	KOM						
VODILO ZA TUBUS 6,5-10MM. GLADKA NOTRANJ POVRŠINA, OB ENAKEM PREMURU LUMNA TUBUSA ČIM MANJŠI ZUNANJI PREMER.	432890	356	KOM						

VREDNOST SKUPAJ:

13

13.099,90 €

0,00 €

ŽIG IN PODPIS:

SPECIFIKACIJA PONUDBE S CENAMI - za 1. obdobje

Predmet JN: **88 Medicinski potrošni material 2, 2016-2018**

CPV: 33196000

16 ANESTEZIJA.Tubusi endotraheal.ojačani z jekleno žic.100%*s*

Naziv artikla	ident JN	Predv. količ.	EM	Cena brez DDV	DDV%	MDC z DDV	Cena z DDV	Vrednost z DDV	Proizvajalec
TUBUS SPIRALNI 5,0MM-ZUNANJI PREMER DO 7,3MM;GRADUIRAN,Z NIZKOTLAČNIM-VELIKIM MEŠIČKOM,ZA ORALNO IN NASALNO INTUBACIJO,ATRAUM. KONICA , MATERIAL PVC.GLADKA NOTR.POVRŠINA,	384569	29	KOM						
TUBUS SPIRALNI 5,5MM-ZUNANJI PREMER 8,0MM;GRADUIRAN,Z NIZKOT.-VELIKIM MEŠIČKOM,ZA ORALNO IN NASALNO INTUBACIJO,ATRAUM. KONICA , MATERIAL PVC.GLADKA NOTRANJA POVRŠINA,	384577	29	KOM						
TUBUS SPIRALNI 6,0MM-ZUNANJI PREMER DO 8,7MM;GRADUIRAN,Z NIZKOT.-VELIKIM MEŠIČKOM,ZA ORALNO IN NASALNO INTUBACIJO,ATRAUM. KONICA , MATERIAL PVC.GLADKA NOTRANJA POVRŠINA,	344885	29	KOM						
TUBUS SPIRALNI 6,5MM-ZUNANJI PREMER 9,4MM;GRADUIRAN,Z NIZKOT.-VELIKIM MEŠIČKOM,ZA ORALNO IN NASALNO INTUBACIJO,ATRAUM. KONICA , MATERIAL PVC.GLADKA NOTRA. POVRŠINA,	344877	73	KOM						
TUBUS SPIRALNI 7,0MM-ZUNANJI PREMER DO 10,0MM;GRADUIRAN,Z NIZKOT.-VELIKIM MEŠIČKOM,ZA ORALNO IN NASALNO INTUBACIJO,ATRAUMA. KONICA , MATERIAL PVC.GLADKA NOTRAN. POVRŠINA,	343102	341	KOM						
TUBUS SPIRALNI 7,5MM-ZUNANJI PREMER DO 10,4MM;GRADUIRAN,Z NIZKOT.-VELIKIM MEŠIČKOM,ZA ORALNO IN NASALNO INTUBACIJO,ATRAUM. KONICA,MATERIAL PVC.GLADKA NOTR. POVRŠINA,	318477	665	KOM						
TUBUS SPIRALNI 8,0MM-ZUNANJI PREMER 11,0MM;GRADUIRAN,Z NIZKOT.-VELIKIM MEŠIČKOM,ZA ORALNO IN NASALNO INTUBACIJO ,ATRAUM. KONICA,MATERIAL PVC.GLADKA NOTRANJA POVRŠINA,	343099	410	KOM						
TUBUS SPIRALNI 8,5MM-ZUNANJI PREMER DO 11,8MM;GRADUIRAN,Z NIZKOT.-VELIKIM MEŠIČKOM,ZA ORALNO IN NASALNO INTUBACIJO,ATRAUMATSKA KONICA , MATERIAL PVC. GLADKA NOTR. POVRŠINA,	344869	616	KOM						
TUBUS SPIRALNI 9,0MM-ZUNANJI PREMER DO 12,3MM;GRADUIRAN,Z NIZKOT.-VELIKIM MEŠIČKOM,ZA ORALNO IN NASALNO INTUBACIJO,ATRAUM. KONICA,MATERIALPVC. GLADKA NOTRANJA POVRŠINA,	342947	2	KOM						

VREDNOST SKUPAJ:

9

13.975,78 €

0,00 €

ŽIG IN PODPIS:

SPECIFIKACIJA PONUDBE S CENAMI - za 1. obdobje

Predmet JN: **88 Medicinski potrošni material 2, 2016-2018**

CPV: 33196000

17 ANESTEZIJA.Tubusi endotraheal.in traheostom.-silikon.-100%

Naziv artikla	ident JN	Predv. količ.	EM	Cena brez DDV	DDV%	MDC z DDV	Cena z DDV	Vrednost z DDV	Proizvajalec
TUBUS ENDOTRHEALNI, ZA LASERSKE POSEGE V ORL OBMOČJU. VELIKOST 4; 5 IN 6 MM (MEDTRONIC 7060100... ALI ENAKOVREDNO).	821381	4	KOM						
TUBUS 2,5 ;ENDOTRAHEALNI,SILIKONSKI,SPIRALNI,GRADUIRAN,RADIOPAČEN,S SILIKONSKIM MEŠIČKOM , GLADKA NOTRA. POVRŠINA, OB ENAKEM PREMERU LUMNA TUBUSA ČIM MANJŠI ZUN. PREMER.(BIVONA 35W25 ALI ENAKOVREDNO).	426652	2	KOM						
TUBUS 3,0 ;ENDOTRAHEALNI,SILIKONSKI,SPIRALNI,GRADUIRAN,RADIOPAČEN, S SILIKONSKIM MEŠIČKOM , GLADKA NOTR. POVRŠINA, OB ENAKEM PREMERU LUMNA TUBUSA ČIM MANJŠI ZUNANJI PREM.(BIVONA 35W30 ALI ENAKOVREDNO).	426717	2	KOM						
TUBUS 3,5 ;ENDOTRAHEALNI,SILIKONSKI,SPIRALNI,GRADUIRAN,RADIOPAČEN, S SILIKONSKIM MEŠIČKOM , GLADKA NOTRANJA POVRŠINA,OB ENAKEM PREMERU LUMNA TUBUSA ČIM MANJŠI ZUNANJI PREME. (BIVONA 35W35 ALI ENAKOVREDNO).	301752	33	KOM						
TUBUS 4,0 ;ENDOTRAHEALNI,SILIKONSKI,SPIRALNI,GRADUIRAN,RADIOPAČEN, S SILIKONSKIM MEŠIČKOM , GLADKA NOTR. POVRŠINA, OB ENAKEM PREMERU LUMNA TUBUSA ČIM MANJŠI ZUNANJI PREM.(BIVONA 35W40 ALI ENAKOVREDNO).	426725	16	KOM						
TUBUS 4,5 ;ENDOTRAHEALNI,SPIRALNI,GRADUIRAN,RADIOPAČEN,S SILIKONSKIM MEŠIČKOM , GLADKA NOTRANJA POVRŠINA, OB ENAKEM PREMERU LUMNA TUBUSA ČIM MANJŠI ZUNANJI PREMER. (BIVONA 35W45 ALI ENAKOVREDNO).	500135	33	KOM						

VREDNOST SKUPAJ:

6

11.973,03 €

0,00 €

ŽIG IN PODPIS:

SPECIFIKACIJA PONUDBE S CENAMI - za 1. obdobje

Predmet JN: **88 Medicinski potrošni material 2, 2016-2018**

CPV: 33196000

18 ANESTEZIJA.Tubus guedel-100% sk.

Naziv artikla	ident JN	Predv. količ.	EM	Cena brez DDV	DDV%	MDC z DDV	Cena z DDV	Vrednost z DDV	Proizvajalec
GUEDEL VELIKOST 0, PRIPOMOČEK ZA OHRANJANJE DIHALNIH POTI.IZDELAN IZ ENEGA DELA BREZ DODATNIH SESTAVNIH DELOV .BARVNA OZNAKA VELIKOSTI,POSAMEZNO PAKIRAN,ČIST. (INTERSURGICAL 1110055 ALI ENAKOVREDNO).	423041	2	KOM						
GUEDEL VELIKOST 00, PRIPOMOČEK ZA OHRANJANJE DIHALNIH POTI.IZDELAN IZ ENAGA DELA BREZ DODATNIH SESTAVNIH DELOV,BARVNA OZNAKA VELIKOSTI,POSAMEZNO PAKIRAN,ČIST. (INTERSURGICAL 1100050 ALI ENAKOVREDNO).	423050	2	KOM						
GUEDEL VELIKOST 000, PRIPOMOČEK ZA OHRANJANJE DIHALNIH POTI.IZDELAN IZ ENEGA DELA BREZ DODATNIH SESTAVNIH DELOV,BARVNA OZNAKA VELIKOSTI,POSAMEZNO PAKIRAN,ČIS. (:INTERSURGICAL 1000035 ALI ENAKOVREDNO).	439576	2	KOM						
GUEDEL VELIKOST 1-ZA OHRANJANJE DIHALNIH POTI.IZDELAN IZ ENEGA DELA BREZ DODATNIH SESTAVNIH DELOV.BARVNA OZNAKA VELIKOSTI, POSAMEZNO PAKIRAN,ČIST.(INTERSURGICAL 1111065 ALI ENAKOVREDNO).	423033	2	KOM						
GUEDEL VELIKOST 2-PRIPOMOČEK ZA OHRANJANJE DIHALNIH POTI.IZDELAN IZ ENEGA SAMEGA DELA BREZ DODATNIH SESTAVNIH DELOV.BARVNA OZNAKA VELIKOSTI,POSAMEZNO PAKIRAN,ČIST. (INTERSURG.1112080 ALI ENAKOVREDNO).	388785	2.838	KOM						
GUEDEL VELIKOST 3-PRIPOMOČEK ZA OHRANJANJE DIHALNIH POTI.IZDELAN IZ ENEGA DELA BREZ DODATNIH SESTAVNIH DELOV.BARVNA OZNAKA VELIKOSTI,POSAMEZNO PAKIRAN,ČIST. (INTERSURGICAL 1113090 ALI ENAKOVREDNO).	421715	1.476	KOM						
GUEDEL VELIKOST 4-PRIPOMOČEK ZA OHRANJANJE DIHALNIH POTI.IZDELAN IZ ENEGA DELA BREZ DODATNIH SESTAVNIH DELOV.BARVNA OZNAKA VELIKOSTI ,POSAMEZNO PAKIRAN,ČIST. (INTERSURGICAL 1114100 ALI ENAKOVREDNO).	421723	65	KOM						

VREDNOST SKUPAJ:**7****5.084,54 €****0,00 €****ŽIG IN PODPIS:**

SPECIFIKACIJA PONUDBE S CENAMI - za 1. obdobje

Predmet JN: **88 Medicinski potrošni material 2, 2016-2018**

CPV: 33196000

19 ANESTEZIJA.Tubusi rae-PVC-100%sk.

Naziv artikla	ident JN	Predv. količ.	EM	Cena brez DDV	DDV%	MDC z DDV	Cena z DDV	Vrednost z DDV	Proizvajalec
TUBUS RAE ORAL 4,0;ORALNI Z VELIKIM MEŠIČKOM-NIZKIM TLAKOM, UKRIVLJEN ZA OP POSEG NA OBRAZU,VRATU IN V USTIH,RADIOPAČEN,GRDUIRAN,ATRAVMATSKA KONICA-PVC	318485	41	KOM						
TUBUS RAE ORAL 4,5;ORALNI Z VELIKIM MEŠIČKOM-NIZKIM TLAKOM, UKRIVLJEN ZA OP.POSEG NA OBRAZU,VRATU IN V USTIH,RADIOPAČEN, GRADUIRAN, ATRAVMATSKA KONICA-PVC	342904	154	KOM						
TUBUS RAE ORAL 5,0;ORALNI Z VELIKIM MEŠIČKOM-NIZKIM TLAKOM, UKRIVLJEN ZA OP.POSEG NA OBRAZU VRATU IN V USTIH,RADIOPAČEN,GRADUIRAN, ATRAVMATSKA KONICA-PVC	344788	97	KOM						
TUBUS RAE ORAL 5,5;ORALNI Z VELIKIM MEŠIČKOM-NIZKIM TLAKOM, UKRIVLJEN ZA OP.POSEG NA OBRAZU,VRATU IN V USTIH,RADIOPAČEN,GRADUIRAN, ATRAVMATSKA KONICA-PVC	342882	65	KOM						
TUBUS RAE 6.0-8.0MM ;NAZALNI Z VELIKIM MEŠIČKOM-NIZKIM TLAKOM, UKRIVLJEN ZA OP. POSEG NA VRATU,OBRAZU IN V UST,RADIOPAČEN, GRADUIRAN, ATRAUM. KONICA-PVC	426695	41	KOM						

VREDNOST SKUPAJ:**5****4.431,10 €****0,00 €****ŽIG IN PODPIS:**

SPECIFIKACIJA PONUDBE S CENAMI - za 1. obdobje

Predmet JN: **88 Medicinski potrošni material 2, 2016-2018**

CPV: 33196000

21 MEDICIN.REHABIL.Elektrode za aparat "BIEGLER"-100% sk.

Naziv artikla	ident JN	Predv. količ.	EM	Cena brez DDV	DDV%	MDC z DDV	Cena z DDV	Vrednost z DDV	Proizvajalec
ELEKTRODA HERPEX-ANODA 13MM ZA APARAT "BIEGLER".(BIEGLER FE1003013 ALI ENAKOVREDNO).	342157	41	KOM						
ELEKTRODA HERPEX-ANODA 25MM ZA APARAT "BIEGLER".(BIEGLER FE 1003025 ALI ENAKOVREDNO).	561541	130	KOM						
ELEKTRODA HERPEX-KATODA ZA APARAT "BIEGLER".(BIEGLER FE103026 ALI ENAKOVREDNO).	254550	956	KOM						

VREDNOST SKUPAJ:

3

9.789,82 €

0,00 €

ŽIG IN PODPIS:

SPECIFIKACIJA PONUDBE S CENAMI - za 1. obdobje

Predmet JN: **88 Medicinski potrošni material 2, 2016-2018**
22 NEVROKIR.OP.Implantati "Cervios Chronos"-100%sk.

CPV: 33196000

Naziv artikla	ident JN	Predv. količ.	EM	Cena brez DDV	DDV%	MDC z DDV	Cena z DDV	Vrednost z DDV	Proizvajalec
CERVIKALNI MEDVREtenČNI IMPLANTI-CERVIOS CHRONOS 5MM, 870.931S (SYNTHES ali enakovredno).	707180	2	KOM						
CERVIKALNI MEDVREtenČNI IMPLANTI-CERVIOS CHRONOS 6MM,KLIN.CER.KL.(SYNTHES 870.922S ali enakovredno).	705560	6	KOM						
CERVIKALNI MEDVREtenČNI IMPLANTI-CERVIOS CHRONOS 7MM,KLIN.CER.KL.(SYNTHES 870.923S ali enakovredno).	705578	7	KOM						
CERVIKALNI MEDVREtenČNI IMPLANTI-CERVIOS CHRONOS 8MM,KLIN.CER.KL.(SYNTHES 870.924S ali enakovredno).	705586	2	KOM						
CERVIKALNI MEDVREtenČNI IMPLANTI-CERVIOS CHRONOS 8MM,ZAOB.CER.KL.(SYNTHES 870.934S ali enakovredno).	705527	2	KOM						
CERVIKALNI MEDVREtenČNI IMPLANTI-CERVIOS CHRONOS 9MM,KLIN.CER.KL.(SYNTHES 870.925S ali enakovredno).	705594	2	KOM						
CERVIKALNI MEDVREtenČNI IMPLANTI-CERVIOS CHRONOS 9MM,ZAOB.CER.KL.(SYNTHES 870.935S ali enakovredno).	705535	2	KOM						
CERVIKALNI MEDVREtenČNI IMPLANTI-CERVIOS CHRONOS 10MM,KLIN.CER.KL.(SYNTHES 870.926S ali enakovredno).	705608	2	KOM						
CERVIKALNI MEDVREtenČNI IMPLANTI-CERVIOS CHRONOS 10MM,ZAOB.CER.KL.(SYNTHES 870.936S ali enakovredno).	705543	2	KOM						
CERVIKALNI MEDVREtenČNI IMPLANTI-CERVIOS CHRONOS,5MM,KLIN.CER.KL.(SYNTHES 870.921 ali enakovredno).	705551	5	KOM						
CERVIKALNI MEDVREtenČNI IMPLANTI-CERVIOS CHRONOS,5MM,ZAOB.CERV.KL.(SYNTHES 870.931 ali enakovredno).	705489	7	KOM						
CERVIKALNI MEDVREtenČNI IMPLANTI-CERVIOS CHRONOS,6MM,ZAOB.CERV.KL.(SYNTHES 870.932 ali enakovredno).	705497	5	KOM						
CERVIKALNI MEDVREtenČNI IMPLANTI-CERVIOS CHRONOS,7MM,ZAOB.CERV.KL.(SYNTHES 870.933 ali enakovredno).	705519	2	KOM						

VREDNOST SKUPAJ:

13

31.396,28 €

0,00 €

ŽIG IN PODPIS:

SPECIFIKACIJA PONUDBE S CENAMI - za 1. obdobje

Predmet JN: **88 Medicinski potrošni material 2, 2016-2018**
23 NEVROKIR.OP.Osteokonduktivni nadomestki-100%sk.

CPV: 33196000

Naziv artikla	ident JN	Predv. količ.	EM	Cena brez DDV	DDV%	MDC z DDV	Cena z DDV	Vrednost z DDV	Proizvajalec
CHRONOS BLOK 12,5 X 12,5 X 10MM. (SYNTHES 07.720.045 ali enakovredno).	731706	2	KOM						
CHRONOS BLOK 20 X 20 X 10MM.(SYNTHES 07.720.047 ali enakovredno).	731714	2	KOM						
CHRONOS GRANULE DIA.0.5-0.7MM.(SYNTHES 710.000S ali enakovredno).	419982	2	KOM						
CHRONOS GRANULE DIA.0.7-1.4MM.(SYNTHES 710.001S ali enakovredno).	418773	2	KOM						
CHRONOS GRANULE DIA.0.7-1.4MM.(SYNTHES710.002S ali enakovredno).	418790	2	KOM						
CHRONOS GRANULE DIA.1,4-2,8MM.(SYNTHES 710-019S ali enakovredno).	710610	4	KOM						
CHRONOS GRANULE DIA.1.4-2.8MM.(SYNTHES 710.014S ali enakovredno).	327760	5	KOM						
CHRONOS GRANULE DIA.2,8-5,6MM.(SYNTHES 710-026S ali enakovredno).	710628	2	KOM						
CHRONOS GRANULE DIA.2.8-5.6MM.(SYNTHES 710.025S ali enakovredno).	671444	2	KOM						
CHRONOS INJECT 10,0CCM.(SYNTHES 710.067S ali enakovredno).	731765	2	KOM						
CHRONOS INJECT 2,5CCM.(SYNTHES 710.065S ali enakovredno).	731749	2	KOM						
CHRONOS INJECT 5,0CCM.(SYNTHES 710.066S ali enakovredno).	731757	2	KOM						

VREDNOST SKUPAJ:

12

6.937,94 €

0,00 €

ŽIG IN PODPIS:

SPECIFIKACIJA PONUDBE S CENAMI - za 1. obdobje

Predmet JN: **88 Medicinski potrošni material 2, 2016-2018**
24 NEVROKIR.OP.Nevrokirurške vatices-100%sk.

CPV: 33196000

Naziv artikla	ident JN	Predv. količ.	EM	Cena brez DDV	DDV%	MDC z DDV	Cena z DDV	Vrednost z DDV	Proizvajalec
NEVROKIRURŠKE VATICE 10 X 30MM,BREZ RTG NITI , BREZ DODATKA ZA PRIJEMANJE S PRIJEMALKO, MATERIAL BOMBAŽ SOFT , SC = 200KOM	658669	4	SC						
NEVROKIRURŠKE VATICE 13 X 25MM,BREZ RTG NITI , BREZ DODATKA ZA PRIJEMANJE S PRIJEMALKO, MATERIAL BOMBAŽ SOFT , SC =200KOM	658642	2	SC						
NEVROKIRURŠKE VATICE 13 X 38MM,BREZ RTG NITI, BREZ DODATKA ZA PRIJEMANJE S PRIJEMALKO, MATERIAL BOMBAŽ SOFT , SC =200KOM	658677	2	SC						
NEVROKIRURŠKE VATICE 13 X 51MM,BREZ RTG NITI, BREZ DODATKA ZA PRIJEMANJE S PRIJEMALKO, MATERIAL BOMBAŽ SOFT , SC=200KOM	658626	23	SC						
NEVROKIRURŠKE VATICE 15 X 50MM,BREZ RTG NITI, BREZ DODATKA ZA PRIJEMANJE S PRIJEMALKO, MATERIAL BOMBAŽ SOFT , SC=200KOM	658634	7	SC						
NEVROKIRURŠKE VATICE 76X152MM,BREZ RTG NITI,BREZ DODATKA ZA PRIJEMANJE S PRIJEMALKO, MATERIAL BOMBAŽ SOFT. SC=200KOM	658685	2	SC						

VREDNOST SKUPAJ:

6

4.258,10 €

0,00 €

ŽIG IN PODPIS:

SPECIFIKACIJA PONUDBE S CENAMI - za 1. obdobje

Predmet JN: **88 Medicinski potrošni material 2, 2016-2018**
25 ORL IN MFK OP. Kanile traheostomijske.-100%sk.

CPV: 33196000

Naziv artikla	ident JN	Predv. količ.	EM	Cena brez DDV	DDV%	MDC z DDV	Cena z DDV	Vrednost z DDV	Proizvajalec
KANILA TRAHEOSTOMIJSKA 6,0; SILIKONSKI,S PENASTO POLNJENIM SILIKONSKIM MEŠIČKOM , GLADKA NOTRANJA POVRŠINA, OB ENAKEM PREMERU LUMNA TUBUSA ČIM MANJŠI ZUNANJI PREMER. (BIVONA 850160 ALI ENAKOVREDNO).	383775	2	KOM						
KANILA TRAHEOSTOMIJSKA 7,0; SILIKONSKI,ARMIRAN,S PENASTO POLNJENIM SILIKONSKIM MEŠIČKOM , GLADKA NOTR. POVRŠINA, OB ENAKEM PREMERU LUMNA TUBUSA ČIM MANJŠI ZUNANJI PREME.(BIVONA 850170 ALI ENAKOVREDNO).	383805	5	KOM						
KANILA TRAHEOSTOMIJSKA 8,0; SILIKONSKI,ARMIRAN,S PENASTO POLNJENIM SILIKONSKIM MEŠIČKOM , GLADKA NOTRAN. POVRŠINA, OB ENAKEM PREMERU LUMNA TUBUSA ČIM MANJŠI ZUNANJI PREM.(BIVONA 850180 ALI ENAKOVREDNO).	383813	49	KOM						
KANILA TRAHEOSTOMIJSKA 9,0; SILIKONSKI,ARMIRAN,S PENASTO POLNJENIM SILIKONSKIM MEŠIČKOM , GLADKA NOTR. POVRŠINA, OB ENAKEM PREMERU LUMNA TUBUSA ČIM MANJŠI ZUNANJI PREMER.(BIVONA 850190 ALI ENAKOVREDNO)	402427	4	KOM						
KANILA TRAHEOSTOMIJSKA 9,5; SILIKONSKI,ARMIRAN,S PENASTO POLNJENIM SILIKONSKIM MEŠIČKOM , GLADKA NOTR. POVRŠINA, OB ENAKEM PREMERU LUMNA TUBUSA ČIM MANJŠI ZUNANJI PREME.(BIVONA 850195 ALI ENAKOVREDNO)	408824	4	KOM						

VREDNOST SKUPAJ:

5

9.103,38 €

0,00 €

ŽIG IN PODPIS:

SPECIFIKACIJA PONUDBE S CENAMI - za 1. obdobje

Predmet JN: **88 Medicinski potrošni material 2, 2016-2018**

CPV: 33196000

26 OTROŠKI ODD. Tubusi trahealni,pvc,silikon.-100%sk.

Naziv artikla	ident JN	Predv. količ.	EM	Cena brez DDV	DDV%	MDC z DDV	Cena z DDV	Vrednost z DDV	Proizvajalec
TUBUS TRAHEALNI 2,0MM;BREZ MEŠIČKA,GRADUIRAN, ATRAVMATSKA KONICA,RADIOPAČEN- PVC-SILIKONIZIRAN. GLADKA NOTRANJA POVRŠINA, OB ENAKEM PREMERU LUMNA TUBUSA ČIM MANJŠI ZUNANJI PREMER.	220515	56	KOM						
TUBUS TRAHEALNI 2,5MM;BREZ MEŠIČKA,GRADUIRAN, ATRAVMATSKA KONICA,RADIOPAČEN - PVC-SILIKONIZIRAN. gLADKA NOTRANJA POVRŠINA, OB ENAKEM PREMERU LUMNA TUBUSA ČIM MANJŠI ZUNANJI PREMER.	344915	89	KOM						
TUBUS TRAHEALNI 3,0MM;BREZ MEŠIČKA,GRADUIRAN, ATRAVMATSKA KONICA,RADIOPAČEN - PVC-SILIKONIZIRAN. gLADKA NOTRANJA POVRŠINA, OB ENAKEM PREMERU LUMNA TUBUSA ČIM MANJŠI ZUNANJI PREMER.	342866	89	KOM						
TUBUS TRAHEALNI 3,5MM;BREZ MEŠIČKA,GRADUIRAN, ATRAVMATSKA KONICA,RADIOPAČEN - PVC-SILIKONIZIRAN. GLADKA NOTRANJA POVRŠINA, OB ENAKEM PREMERU LUMNA TUBUSA ČIM MANJŠI ZUNANJI PREMER.	385832	25	KOM						
TUBUS TRAHEALNI 4,5MM;BREZ MEŠIČKA,GRADUIRAN,RADIOPAČEN,ATRAUMATSKA KONICA-PVC-SILIKONIZIRAN. GLADKA NOTRANJA POVRŠINA, OB ENAKEM PREMERU LUMNA TUBUSA ČIM MANJŠI ZUNANJI PREMER.	477117	8	KOM						
TUBUS TRAHEALNI 4.0MM;BREZ MEŠIČKA,GRADUIRAN,RADIOPAČEN, ATRAUMATSKA KONICA-PVC-SILIKONIZIRAN. GLADKA NOTRANJA POVRŠINA, OB ENAKEM PREMERU LUMNA TUBUSA ČIM MANJŠI ZUNANJI PREMER.	477109	12	KOM						

VREDNOST SKUPAJ:

6

292,73 €

0,00 €

ŽIG IN PODPIS:

SPECIFIKACIJA PONUDBE S CENAMI - za 1. obdobje

Predmet JN: **88 Medicinski potrošni material 2, 2016-2018**

CPV: 33196000

31 Brizgalke. LUER-TRIDELNE.-100% sk.

Naziv artikla	ident JN	Predv. količ.	EM	Cena brez DDV	DDV%	MDC z DDV	Cena z DDV	Vrednost z DDV	Proizvajalec
BRIZGALKA LUER ZA 1XUP. 1 ML-TUBERKULINSKA SKALA(DOBRO ČITLJIVA),TRIDELNA-BREZ LATEKSA	407399	12.162	KOM						
BRIZGALKA LUER ZA 1XUP. 2 ML-2,5 ML,TRIDELNA-BREZ LATEKSA,OZNAKE ČITLJIVE,ODPORNE NA IZBRIS	327930	162.162	KOM						
BRIZGALKA LUER ZA 1XUP. 3 ML,TRIDELNA-BREZ LATEKSA,OZNAKE ČITLJIVE,ODPORNE NA IZBRIS	478237	162.162	KOM						
BRIZGALKA LUER ZA 1XUP. 5 ML,TRIDELNA-BREZ LATEKSA,OZNAKE ČITLJIVE,ODPORNE NA IZBRIS	327948	234.162	KOM						
BRIZGALKA LUER ZA 1XUP.10 ML,TRIDELNA-BREZ LATEKSA,OZNAKE ČITLJIVE,ODPORNE NA IZBRIS	143405	335.594	KOM						
BRIZGALKA LUER ZA 1XUP.20 ML ,TRIDELNA-BREZ LATEKSA,OZNAKE ČITLJIVE,ODPORNE NA IZBRIS	327956	206.757	KOM						
BRIZGALKA LUER ZA 1XUP.30ML,TRIDELNA-BREZ LATEKSA,OZNAKE ČITLJIVE,ODPORNE NA IZBRIS	485217	730	KOM						
BRIZGALKA S KATETERSKIM NASTAVKOM-50ML,ZA 1 X UP.TRIDELNA-BREZ LATEKSA,OZNAKA ČITLJIVA,ODPORN NA IZBRIS	301655	22.670	KOM						
BRIZGALKA LUER ZA 1XUP. 1ML,INSULINSKA SKALA-100 I.U.,DOBRO ČITLJIVA,TRI-DELNA,BREZ LATEKSA	482218	26.757	KOM						

VREDNOST SKUPAJ:

9

45.675,54 €

0,00 €

ŽIG IN PODPIS:

SPECIFIKACIJA PONUDBE S CENAMI - za 1. obdobje

Predmet JN: **88 Medicinski potrošni material 2, 2016-2018**

CPV: 33196000

32 Brezigelne spojke,podaljški,vbodne igle s spojk.-100%sk.GL.PR.4

Naziv artikla	ident JN	Predv. količ.	EM	Cena brez DDV	DDV%	MDC z DDV	Cena z DDV	Vrednost z DDV	Proizvajalec
DVOKANALI DEBEL.PODALJŠEK,Z DVEMA SPOJK.,KI JU NI MOGOČE ODSTRANITI.DOLŽ.12-13CM.VOL. MED 0,70-0,80ML (ICU MED. 011-C2205 ali enakovredno).	693995	41	KOM						
ICU BREZIGELNA SPOJKA, PROZORNA (TRANSPARENTNA).(ICU MEDICAL 011-MC100 ALI ENAKOVREDNO).	832952	4.540	KOM						
ICU CEV ZA ASPIRACIJOZDRAVIL S 5 MIKROMETR.FILTROM DOLŽ.MED 6 IN 6,5 CM.PREMERA MED 2,5 IN 2,7MM.(ICU MEDICAL 011-CS-35 ALI ENAKOVREDNO).	833029	41	KOM						
ICU VMESNIK BREZIGELNI ZA ZAPORO BRIZGALKE ALI INFUZ.SISTEMA.PROZORNO OHIŠJE .PRETOK MED 125 IN 130 ML/MIN.MRTVI PROSTOR MAX.0,1ML.VMESNIK SE MORA OB ODK LOPU ZAPRETI (ICU MEDICAL CH2000 ALI ENAKOV.)	833045	8	KOM						
ICU VMESNIK ZA ČRPALKE.Z DVOKANALNO IGLO,ZRAČNI FILTER S POKROVOM,DVEMA SPOJKAMA ZA DOSTOP BREZ IGLE,Z ROBERTOVO ZAPONKO.DOLŽ. MED 30 IN32CM.POLNI TV.VOL.MED2 IN 2,5ML(ICU MEDICAL 011-H2923 ALI ENA.).	832987	1.784	KOM						
ICU-CLAVE INFUZIJSKI GRAVITACIJSKI SISTEM, OBARVAN, Z ENIM DOSTOPOM.PROZOREN DEL KOMORE,KI OMOGOČA NADZOR PRETOKA, DRUGI DEL KOMORE JE V CELOTI OBARAVAN(ICU MEDICAL 011-H2334 ALI ENAKOVREDNO).	829935	81	KOM						
ICU-CLAVE PODALJŠEK Z VBODNO IGLO, MIKRO CLAVE KONEKTOM, HIDROFOBNI FILTROM IN ZRAČENJEM (ICU MEDICAL 011-H1702 ALI ENAKOVREDNO).	829919	3.243	KOM						
ICU-CLAVE TANKA VBODNA IGLA (ICU MEDICAL 011-CS-53, ALI ENAKOVREDNO).	693898	2.148	KOM						
ICU-CLAVE VBODNA IGLA Z ZAŠČITNIM POKROVOM (ICU MEDICAL 011-CV-100 ALI ENAKOVREDNO).	693987	41	KOM						
ICU-CLAVE VBODNA IGLA, S CLAVE KONEKTOM IN DVEMA ZATIČKOMA (ICU MEDICAL 011-CS-50 ALI ENAKOVREDNO).	829943	689	KOM						
ICU-CLAVE VBODNA IGLA, S CLAVE KONEKTOM IN ZRAČNIM TER FILTROM ZA DELCE (ICU MEDICAL 011-CS-52 ALI ENAKOVREDNO).	829897	608	KOM						
ICU-CLAVE VMESNIK S ŠTIRIMI CLAVE KONEKTI, ZA INFUZIJSKO ČRPALKO (ICU MEDICAL 011-H2924 ALI ENAKOVREDNO).	829927	162	KOM						
PODALJŠEK DVOKANALNI (Y), Z 2 X MIKRO CLAVE SPOJKAMA, KI JU NI MOGOČE ODSTRANITI (ICU MED.011-MC3316 ali enakovredno).	694088	1.217	KOM						

SPECIFIKACIJA PONUDBE S CENAMI - za 1. obdobje

Predmet JN: **88 Medicinski potrošni material 2, 2016-2018**

CPV: 33196000

32 Brezigelne spojke,podaljški,vbodne igle s spojk.-100%sk.GL.PR.4

Naziv artikla	ident JN	Predv. količ.	EM	Cena brez DDV	DDV%	MDC z DDV	Cena z DDV	Vrednost z DDV	Proizvajalec
PODALJŠEK ENOKANALNI Z NEPROZORNO SPOJKO, Z MOŽNOSTJO ZAPORE.VOL.MED 0,25 IN 0,30ML.DOLŽ. MED 17,5 IN 18 CM.(ICU MEDICAL 011-MC3302 ALI ENAKOVREDNO).	832995	575	KOM						
PODALJŠEK ENOKANALNI, S SPOJKO, KI JE NI MOGOČE ODSTRANITI.DOLŽINA PODALJŠKA 17 DO 18 CM,VOL.0.60 DO 0,65 ML (ICU MEDIC.011-C2005 ali enakovredno).	693910	41	KOM						
PODALJŠEK S TREMI KONEKTI ZA DOSTOP BREZ IGLE,VOL.1,3-1,5ML,DOLŽ.24-25 CM.KONEKTI SI SLEDIJO V LINJI,PRVI PRETOK V OBE STRANI,OSTALA DVA PA OMOGOČATA SAMO INJICIRANJE T.(011-C4329-ICU ali enakovredno).	694118	81	KOM						
SPOJKA ZA DOSTOP BREZ IGLE S KONICO ZA PREBOD INF. STEKL.-OBARVANA (ICU MED.011-C3300G ali enakovredno).	693952	15.365	KOM						
SPOJKA ZA DOSTOP BREZ IGLE Z BARVNO OZNAKO,ZA ZAPIRANJE IN UPORABO KANALA,KI JE ŽE ZAPRT Z DRUGIM ZAPIRALOM KI NE VSEBUJE SPOJKE CLAVE, (011-C3300RR,ICU M. ali enakovredno).	694100	9.567	KOM						
SPOJKA ZA DOSTOP BREZ IGLE Z VBODNO KONICO S FILTROM ZA PREBOD INFUZIJSKIH STEKLENIC-TUDI ZA CITOSTATIKE, (ICU MEDICAL 011-CS-10B ali enakovredno).	693979	3.259	KOM						
SPOJKA ZA DOSTOP BREZ IGLE Z VBODNO KONICO S FILTROM 0.2 MIK.(ICU MEDICAL 011-CS-51 ali enakovredno).	693871	2.554	KOM						
SPOJKA ZA DOSTOP BREZ IGLE Z VBODNO KONICO Z NEPOVRATNO VALVULO, (ICU MEDICAL 011-CS-55 ali enakovredno).	693901	41	KOM						
SPOJKA ZA DOSTOP BREZ IGLE,NEPROZORNA.POLNITV.VOL.SPOJKE MAX. 0,035ML. PRETOK DO 620ML/MIN. (ICU MEDICAL D1000 ALI ENAKOVREDNO).	831590	41	KOM						
SPOJKA ZA DOSTOP BREZ IGLE,PROZORNA, Z FLUORESC.BARVNO OZNAKO VIDNO V TEMI.POLNITV.VOL. MAX. 0,1ML.PRETOK DO 100ML/MIN. (ICU MEDICAL 011-NC100 ALI ENAKOVREDNO)	694061	3.081	KOM						
ŠTIRIKANALNI PODALJŠEK S ŠTIRIMI SPOJK.ZA DOSTOP BREZ IGLE,DOLŽINA PODALJŠKA 19 DO 21CM,LL, VOL. MED 0,80 IN 1,00ML. (ICU MEDICAL 011-H2742 ali enakovredno).	694053	284	KOM						
T-PODALJŠEK S CLAVE KONEKTOM,S SPOJKO ZA DOSTOP BREZ IGLE,KI JE NI MOGOČE PREBOSTI Z IGLO.IMETI MORA MOŽNOST ZAPORE PRETOKA.7 DNEVNA UPOR.DOLŽ.PODALJ.12-13CM,VOL.0,3ML.(ICU MED.011-CT-3306 ali enakov.)	693880	284	KOM						
TROKANALNI DEBEL.PODALJ. S TREMI SPOJK.,KI JIH NI MOGOČE ODSTRANIT.DOLŽ,15-15,5CM,VOL.MED 1,25-1,30ML (ICU MED. 011-CU-1362 ali enakovredno).	693928	1.500	KOM						

SPECIFIKACIJA PONUDBE S CENAMI - za 1. obdobje

Predmet JN: **88 Medicinski potrošni material 2, 2016-2018**

CPV: 33196000

32 Brezigelne spojke,podaljški,vbodne igle s spojk.-100%sk.GL.PR.4

Naziv artikla	ident JN	Predv. količ.	EM	Cena brez DDV	DDV%	MDC z DDV	Cena z DDV	Vrednost z DDV	Proizvajalec
---------------	----------	---------------	----	---------------	------	-----------	------------	----------------	--------------

TROKANALNI PODALJŠEK S TREMI SPOJK.,KI JIH NI MOGOČE
ODSTRANITI.DOLŽINA 17,5 DO 18CM, VOL.MED 0,65 IN 0,70ML (ICU
MEDICAL 011-MC3323 ALI ENAKOVREDNO).

694002 1.217 KOM

VREDNOST SKUPAJ:

27

142.912,89 €

0,00 €

ŽIG IN PODPIS:

SPECIFIKACIJA PONUDBE S CENAMI - za 1. obdobje

Predmet JN: **88 Medicinski potrošni material 2, 2016-2018**

CPV: 33196000

33 Dreni pvc in rezervoarji za drenažo op.ran-100%sk.

Naziv artikla	ident JN	Predv. količ.	EM	Cena brez DDV	DDV%	MDC z DDV	Cena z DDV	Vrednost z DDV	Proizvajalec
DREN REDON CH 6 ,PERFORACIJA 70MM-DOLŽINA 50CM /PVC,STERILEN, RTG NITKA	402281	81	KOM						
DREN REDON CH 8,PERFORACIJA 140MM-DOLŽINA 50CM /PVC,STERILEN, RTG NITKA	344648	162	KOM						
DREN REDON CH10, PERFORACIJA 150MM-DOLŽINA 50CM /PVC,STERILEN, RTG NITKA	387886	567	KOM						
DREN REDON CH12 ,PERFORACIJA 150MM-DOLŽINA 50CM /PVC,STERILEN	383660	1.217	KOM						
DREN REDON CH14,PERFORACIJA 150MM-DOLŽINA 50CM /PVC,STERILEN	382116	1.136	KOM						
DREN REDON CH16 ,PERFORACIJA 150MM-DOLŽINA 50CM /PVC,STERILEN	218308	648	KOM						
IGLA REDON CH 8-16,LEGIRANO JEKLO,RAVNA Z UPOGNJENO KONICO SULIČASTE OBLIKE/NESTERINA	425923	8	KOM						
REDIVAC, 30 DO 50ML ,HARMONIKA, KOMPL.Z DRENOM CH6 IN VODILNO IGLO ZA DREN,VACUUM 80MM/Hg,STERILEN	219053	138	KOM						
REDON PLASTENKA 400ML+50ML VARN. VOL,INTIGRIRAN INDIKAT.VAKUMA Z GRADUACIJO MIN-MAX,VACUUM 2000 Pa,POVEZ. CEV S PROZOR. KONEKT. ZA REDON DREN,Z LL PRIKL.NA PLASTENKO,NOSILEC,STERILNO (PRIMED 24502 ALI ENAKOVREDNO)	342190	519	KOM						
REDON PLASTENKA 600ML+50ML VARNOSTNI VOLUMEN,INTEGRIRAN INDIK. VACUUMA Z GRADUAC.MIN-MAX,VAKUM 2000 Pa,POVEZOVALNA CEV S PROZOR.KONEKT. ZA REDON DREN,Z LL PRIKL. NA PLASTENKO,NOSILEC,STERILNO (PRIMED 24504 ALI ENAKOVREDNO)	342181	3.527	KOM						
REDON PLASTENKA- 150ML,HARMONIKA,VACUUM 140MM/Hg,S POVEZOVALNO CEVJO IN KONEKTOM, STERILEN	329819	162	KOM						

VREDNOST SKUPAJ:

11

7.030,57 €

0,00 €

ŽIG IN PODPIS:

SPECIFIKACIJA PONUDBE S CENAMI - za 1. obdobje

Predmet JN: **88 Medicinski potrošni material 2, 2016-2018**

CPV: 33196000

34 Dreni silikon.+rezervoarji za drenažo op.ran-100%

Naziv artikla	ident JN	Predv. količ.	EM	Cena brez DDV	DDV%	MDC z DDV	Cena z DDV	Vrednost z DDV	Proizvajalec
DREN S TROKARJEM 10 FR,SILIKONSKI,PLOŠATI,RADIOPAČEN, ŽLEBIČAST PO CELOTNI DOLŽINI. MOŽNOST PRIKLOPA NA RAZPISANA 100 ML IN 450 ML REZERVOARJA.(J&J 2215 ali enakovredno).	381870	49	KOM						
DREN S TROKARJEM 15 FR,SILIKONSKI,OKROGLI-PLOŠČATI,BLAKE 3/16", DOLŽ. 3/ 4 ŽLEBIČAST. MOŽNOST PRIKLOPA NA VSE TRI RAZPIS. TIPE REZERVOARJEV: 100, 150, 450ML. (J&J2229 ali enakovredno).	381888	138	KOM						
DREN S TROKARJEM 19FR,SILIKONSKI,OKROGLI (JOHNSON&JOHNSON.2231 ALI ENAKOVREDNO).MOŽNOST PRIKLOPA NA VSE 3 RAZPIS.REZERVOARJE ZA SUKCIJO JOHNSON 2160, 2161 IN 2162.	381861	97	KOM						
DREN SILIKONSKI 10MM PLOŠČATI,BLAKE,RADIOPAČEN,ŽLEBAST PO CELOTNI DOLŽINI,MOŽNOST PRIKLOPA NA RAZPISANA 100 ,150 IN 450ML REZERVOAR, (J&J2214 ali enakovredno).	381853	16	KOM						
DREN 24FR,SILIKON,okrogle oblike s 3/16 trokarjem, (J&J2234 ali enakovredno).	695696	97	KOM						
DREN 7MM,SILIKONSKI,PLOŠČATI,BLAKE , S 3/16 TROKARJEM, ŽLEBIČAST PO CELOTNI DOLŽINI. MOŽNOST PRIKLOPA NA VSE TRI RAZPISANE TIPE REZERVOARJEV: 100,150,450 ML. (J&J 2212 ali enakovredno).	338281	633	KOM						
REZERVOAR ZA SUKCIJO- 100ML,OKROGLI, Z NEPOVRATNIM VENTILOM, (J&J 2160 ali enakovredno).	381837	105	KOM						
REZERVOAR ZA SUKCIJO- 150ML,PLOŠČATI, Z Y KONEKTOM IN NEPOVRATNIM VENTILOM, (J&J 2161 ali enakovredno).	381845	33	KOM						
REZERVOAR ZA SUKCIJO- 450ML,PLOŠČATI, Z Y KONEKTOM IN NEPOVRATNIM VENTILOM, (J&J 2162 ali enakovredno).	322148	219	KOM						

VREDNOST SKUPAJ:**9****36.326,09 €****0,00 €****ŽIG IN PODPIS:**

SPECIFIKACIJA PONUDBE S CENAMI - za 1. obdobje

Predmet JN: **88 Medicinski potrošni material 2, 2016-2018**
35 Elektrode.kabli+ostali pripom.za"VALLEYLAB".-100%sk.

CPV: 33196000

Naziv artikla	ident JN	Predv. količ.	EM	Cena brez DDV	DDV%	MDC z DDV	Cena z DDV	Vrednost z DDV	Proizvajalec
ELEKTRODA EDGE -NOŽ,DOLŽINA 16,51CM, AKTIVNA DOLŽINA 5,1MM, IZOLIRANA,(COVIDIEN E1455-6 ali enakovredno).	485012	1.095	KOM						
ELEKTRODA EDGE -NOŽ,DOLŽINA 6,99CM,AKTIVNA DOLŽINA 2,8CM,IZOLIRANA,STERILNA,(COVIDIEN E1450 X ali enakovredno).	484997	1.459	KOM						
ELEKTRODA NEVTRALNA ZA VF.KIR.NOŽ, 1XUP, DVODELNA S HYDROGELOM, BREZ KABLA, OMOGOČATI MORA DOBRO PRILEGANJE IN NEODSTOPAJE OD PODLAGE,(COVIDIEN E7509 ali enakovredno).	565911	7.541	KOM						
ELEKTRODA ZA EL NOŽ, ZA VEČKRATNO UPORABO (COVIDIEN E1020 ALI ENAKOVREDNO).	580775	8	KOM						
ELEKTRODA ZA EL.NOŽ (COVIDIEN E1455B-4 ALI ENAKOVREDNO).	485004	101	KOM						
ELEKTRODA ZA EL.NOŽ ZA VEČKRATNO UPORABO (COVIDIEN E1003 ALI ENAKOVREDNO).	486558	2	KOM						
KABEL ZA BIPOLARNO PINCETO , DOLŽINA 3.6M, (COVIDIEN E0018 ali enakovredno).	567841	4	KOM						
KABEL ZA NEGATIVNO ELEKTRODO, E0560 ali enakovredno	566942	18	KOM						
KABEL ZA NEGATIVNO ELEKTRODO. (COVIDIEN E0560E ali enakovredno).	606154	13	KOM						
PODALJŠEK ZA ELEKTROKIR.NOŽ. (COVIDIEN E1502 ali enakovredno).	507008	2	KOM						
ROČNIK ZA VF ELEKTROKIRURŠKI NOŽ S 4,6M SILIKONSKIM KABLOM IN STAINLEESS STEEL ELEKTRODO-NOŽ, NESTERILEN, (COVIDIEN E 2100 ali enakovredno).	486540	154	KOM						

VREDNOST SKUPAJ:

11

69.393,79 €

0,00 €

ŽIG IN PODPIS:

SPECIFIKACIJA PONUDBE S CENAMI - za 1. obdobje

Predmet JN: **88 Medicinski potrošni material 2, 2016-2018**

CPV: 33196000

36 Kanile varne.-100%sk.

Naziv artikla	ident JN	Predv. količ.	EM	Cena brez DDV	DDV%	MDC z DDV	Cena z DDV	Vrednost z DDV	Proizvajalec
Kanila venska varnostna G14-2,2 X 50-52mm,pretok 314-343ml/min. (BRAUN 4269225S ali enakovredno).	755621	325	KOM						
Kanila venska varnostna G16-1,7-1,8 X 50-52mm,pretok 196-208 ml/min. (BRAUN 4269179S ali enakovredno).	755630	244	KOM						
Kanila venska varnostna G17-1,5 X 45mm,pretok 128 ml/min.(BRAUN 4269152S ali enakovredno).	755648	446	KOM						
Kanila venska varnostna G18-1,3 X 45mm,pretok 96-100 ml/min.(BRAUN 4269136S ali enakovredno).	755656	1.581	KOM						
Kanila venska varnostna G20-1,1 X 32-33mm ,pretok 61-63 ml/min. (BRAUN 4269110S ali enakovredno).	755664	3.406	KOM						
Kanila venska varnostna G22-0,9 X 25mm,pretok 36-38 ml/min.(BRAUN 4269098S ali enakovredno).	755672	2.554	KOM						
Kanila venska varnostna G24-0,7-0,8 X 16-19mm ,pretok 22-24 ml/min. (BRAUN 4269071S ali enakovredno).	755699	244	KOM						

VREDNOST SKUPAJ:**7****5.521,13 €****0,00 €**

ŽIG IN PODPIS:

SPECIFIKACIJA PONUDBE S CENAMI - za 1. obdobje

Predmet JN: **88 Medicinski potrošni material 2, 2016-2018**

CPV: 33196000

37 Kanile venozne.-100% sk.

Naziv artikla	ident JN	Predv. količ.	EM	Cena brez DDV	DDV%	MDC z DDV	Cena z DDV	Vrednost z DDV	Proizvajalec
KANILA NEOFロン 24G 0,7 X 19MM,DVOVHODNA ,MATERIAL: PTFE,APIROGEN (B&D391350 ali enakovredno)	318442	3.365	KOM						
KANILA NEOFロン 26G 0,6X19MM,DVOVHODNA,MATERIAL:PTFE,APIROGEN (B&D391349 ALI ENAKOVREDNO)	765449	162	KOM						
KANILA VENOZNA G18 -1,2MM X 45MM DVOVHODNA-POLIURETAN,PRETOK 96ML/MIN.,DOBRO GIBLJIV METULJČEK Z LUKNJICAMI,LATEX-FREE	526754	3.243	KOM						
KANILA VENOZNA G20 -1,0MM X 32MM DVOVHODNA-POLIURETAN,PRETOK 61ML/MIN.,DOBRO GIBLJIV METULJČEK Z LUKNJICAMI,LATEX FREE	526746	21.162	KOM						
KANILA VENOZNA G22-0,8MM X 25MM DVOVHODNA-POLIURETAN,PRETOK 36ML/MIN.,DOBRO GIBLJIV METULJČEK,LATEX-FREE	526738	5.190	KOM						
KANILA VENOZNA 0.8 X 25MM- G22,dvovhodna,MATERIAL-PTFE, APIROGEN, (B&D 391451 ali enakovredno).	318434	20.473	KOM						
KANILA VENOZNA 1.0 X 32 MM-G20,DVOVHODNA,MATERIAL-PTFE, APIROGEN, (B&D 391452 ali enakovredno).	235687	30.608	KOM						
KANILA VENOZNA 1.2 X 45MM G18,DVOVHODNA ,MATERIAL- PTFE, APIROGEN, (B&D 391453 ali enakovredno).	344362	11.757	KOM						
KANILA VENOZNA 1.4 X 45MM-G17,DVOVHODNA ,MATERIAL-PTFE, APIROGEN, (B&D 391454 ali enakovredno).	342726	2.108	KOM						
KANILA VENOZNA 1.7 X 45MM- G16,DVOVHODNA ,MATERIAL-PTFE, APIROGEN, (B&D 391455 ali enakovredno).	342718	3.406	KOM						
MANDREN ZA VENOZNO KANILO G18-1,2MM-DOLŽINA 45MM-POLIURETAN,KOMPATIBILEN S KANILO NA ID:526754.	526720	41	KOM						
MANDREN ZA VENOZNO KANILO G20-1,0MM -DOLŽINA 33MM-POLIURETAN,KOMPATIBILEN S KANILO NA ID:526746.	526762	527	KOM						
MANDREN ZA VENOZNO KANILO G22-0,8MM-DOLŽINA 25MM-POLIURETAN,KOMPATIBILEN S KANILO NA ID:526738.	526711	244	KOM						
VENOZNA IGLA Z METULJČKOM,19G-1.0 X 25 MM,DOLŽINA POVEZOVALNE CEVI-30CM,LATEX FREE,LL,ZAMAŠEK	384097	81	KOM						
VENOZNA IGLA Z METULJČKOM,21G- 0.8 X 20MM,DOLŽINA POVEZOVALNE CEVI-30CM,LATEX FREE,LL,ZAMAŠEK	387096	3.243	KOM						
VENOZNA IGLA Z METULJČKOM,22G- 0,7 X 20MM,DOLŽINA POVEZOVALNE CEVI-30CM,LATEX FREE,LL,ZAMAŠEK	436950	567	KOM						
VENOZNA IGLA Z METULJČKOM,23G- 0,6 X 17MM,DOLŽINA POVEZOVALNE CEVI-30CM,LATEX FREE,LL,ZAMAŠEK	143499	1.217	KOM						

SPECIFIKACIJA PONUDBE S CENAMI - za 1. obdobje

Predmet JN: **88 Medicinski potrošni material 2, 2016-2018**

CPV: 33196000

37 Kanile venozne.-100% sk.

Naziv artikla	ident JN	Predv. količ.	EM	Cena brez DDV	DDV%	MDC z DDV	Cena z DDV	Vrednost z DDV	Proizvajalec
VENOZNA IGLA Z METULJČKOM,25G-0,5 X 17MM ,DOLŽINA POVEZOVALNE CEVI-30CM,LATEX FREE,LL,ZAMAŠEK	423904	162	KOM						
ZAMAŠEK ZA IV.KANILO Z MOŽNOTJO DODATNE APLIKACIJE,BREZ LATEXA	219045	16.054	KOM						
ZAMAŠEK ZA IV.KANILO,LUER LOCK	408514	42.811	KOM						

VREDNOST SKUPAJ:

20

39.308,39 €

0,00 €

ŽIG IN PODPIS:

SPECIFIKACIJA PONUDBE S CENAMI - za 1. obdobje

Predmet JN: **88 Medicinski potrošni material 2, 2016-2018**

CPV: 33196000

38 Katetri urinski s temperatur.senzorjem+kabli.-100%sk.

Naziv artikla	ident JN	Predv. količ.	EM	Cena brez DDV	DDV%	MDC z DDV	Cena z DDV	Vrednost z DDV	Proizvajalec
KABEL ADAPTACIJSKI ZA TEMPARATURNI KATETER,ZA MONITOR "DRAGER".	567353	2	KOM						
KABEL ADAPTACIJSKI ZA TEMPARATURNI KATETER,ZA MONITOR" HP"	567361	8	KOM						
KATETER URINSKI DVOPOTNI FOLEY CH14,,BALONSKI BALON 5-15 ML, DOLŽINA 40-45 CM, ,SILIKONSKI, S TEMPERATURNIM SENZORJEM, KONICA NAJMANJ Z DVEMA OČESOMA	442941	255	KOM						
KATETER URINSKI DVOPOTNI FOLEY CH16 ,BALONSKI, BALON 5-15ML, DOLŽINA 40-45 CM, SILIKONSKI,S TEMPERATURNIM SENZORJEM, KONICA NAJMANJ Z DVEMA OČESOMA	442950	267	KOM						
KATETER URINSKI DVOPOTNI FOLEY CH18 , BALONSKI, BALON 5-15ML, DOLŽINA 40-45 CM, KONICA Z NAJMANJ DVEMA OČESOMA, SILIKONSKI,S TEMPERATURNIM SENZORJEM	442968	150	KOM						

VREDNOST SKUPAJ:

5

4.839,00 €

0,00 €

ŽIG IN PODPIS:

SPECIFIKACIJA PONUDBE S CENAMI - za 1. obdobje

Predmet JN: **88 Medicinski potrošni material 2, 2016-2018**

CPV: 33196000

39 Papir za EKG in EEG aparate.-100% sk.

Naziv artikla	ident JN	Predv. količ.	EM	Cena brez DDV	DDV%	MDC z DDV	Cena z DDV	Vrednost z DDV	Proizvajalec
FOLIJA TERMALNA ZA VIDEOPRINTER.(MITSUBISHI K65HM ali enakovredno).	388262	549	KOM						
FOLIJA VIDEOPRINTER 210MM. (Sony UPP-210HD ali enakovredno)	608378	33	KOM						
FOLIJA 110MM X 18M ZA VIDEOPRINTER "SONY". (Sony UPP110HG ali enakovredno).	482234	154	KOM						
PAPIR CTG TERMO 150 X 100MM, BREZ LUKNJIC, 1 ZAV = 150 LISTIČEV.(DIAGRAM HALB. 1501-HP1911A ali enakovredno).	399698	292	ZAV						
PAPIR CTG TERMO 152 X 100 MM, Z LUKNJICAMI, 1 ZAV = 50 LISTIČEV.(DIAGRAM HALB.HP9270-0630 ali enakovredno).	244767	16	ZAV						
PAPIR CTG 152X90X160 LISTOV.(DIAGRAM HALB. DAO4305 ali enakovredno).	488259	381	KOM						
PAPIR EKG TERMO 130 X 135 MM X 370 LISTIČEV. ZA APARAT EK53. (DIAGRAM HALB. EK53 (15) ali enakovredno).	241369	8	ZAV						
PAPIR EKG TERMO 210 X 300MM, POTISKAN, 1 ZAV = 150 LISTIČEV. (DIAGRAM HALBACH 110 ali enakovredno).	411876	466	ZAV						
PAPIR EKG TERMO 210 X 300MM, 2/3 POTISKAN, 1 ZAV = 200 LISTIČEV.(DIAGRAM HALBACH 2/3-88).	406562	12	ZAV						
PAPIR EKG TERMO 90 X 90MM ZA APARAT MIKROSMART 22616702. 1ZAV= 360 LISTIČEV.(DIAGRAM HALB. Microsmart 209 ali enakovredno).	427802	16	ZAV						
PAPIR EKG TERMO, ZA APARAT "SCHILLER AT-2/AT102 " Dim: 210MM X 280MM, 1 ZAV = 240 LISTIČEV.(DIAGRAM HALBACH EKG TERMO AT2/AT102 ali enakovredno).	478059	316	ZAV						
PAPIR TERMO ROLA- ŠIRINA 110MM,NOTRANJI PREMIER ODPRTINE 12MM,ZUNANJI PREMIER ROLE 45MM,DOLŽINA 25M-NEPOTISKAN	399680	39	SVT						
PAPIR TERMO ROLA- ŠIRINA 50MM,NOTRANJI PREMIER ODPRTINE 16MM, ZUNANJI PREMIER 50MM-POTISKAN	442011	73	SVT						
PAPIR TERMO ROLA- ŠIRINA 50MM,NOTRANJI PREMIER ODPRTINE 16MM,ZUNANJI PREMIER ROLE 50MM-NEPOTISKAN	405965	25	SVT						
PAPIR TERMO ROLA- ŠIRINA 57MM,NOTRANJI PREMIER ODPRTINE 12MM, ZUNANJI PREMIER ROLE 45MM,-NEPOTISKAN	382493	178	SVT						
TONER+PAPIR ZA SONY (SONY UPC 21L ali enakovredno).	666424	9	SC						

VREDNOST SKUPAJ:**16****17.917,61 €****0,00 €**

ŽIG IN PODPIS:

SPECIFIKACIJA PONUDBE S CENAMI - za 1. obdobje

Predmet JN: **88 Medicinski potrošni material 2, 2016-2018**
40 Preveleke za RTG.-100% sk.

CPV: 33196000

Naziv artikla	ident JN	Predv. količ.	EM	Cena brez DDV	DDV%	MDC z DDV	Cena z DDV	Vrednost z DDV	Proizvajalec
PREVLEKA ZA EKRAN , MAT.: PE STERILIZ. S PLINOM ETTO, PRAVOKOTNE OBLIKE ENA STRAN FIKSNO ZAPRTA , DRUGA Z GUMICO ZA TESNITEV, 80CM X 110 CM , RT II.(MI-SAN 12103611ali enakovredno).	425605	2.035	KOM						
PREVLEKA ZA EKRAN , MAT.: PE , POLKROŽNE OBLIKE Z GUMICO ZA TESNITEV, 65CMX125CM, OBSEG 160 CM, PREMIER 80 CM, GLOBINA 80 CM, STERILNA , RTG I.(MI-SAN 121036103 ali enakovredno).	425591	754	KOM						
PREVLEKA ZA EKRAN , MAT.: PE STERILEN, STOŽASTE OBLIKE, DIMENZIJE KROG PREMIERA 35 CM, VIŠINA 30 CM, ENA STRAN ZAPRTA, DRUGA Z GUMI TESNILOM , RTG IV,(MI-SAN SBM-122008 ali enakovredno).	580201	292	KOM						
PREVLEKA ZA EKRAN MONITORJA "AKSIOM", DOLŽINA 1,6 M IN 30-40CM GLOBINE, RTG VI.(MI-SAN 121042910 ali enakovredno).	580228	608	KOM						
PREVLEKA ZA EKRAN RTG VII. ZA APARAT SIREMOBIL ISO-C SIMENS.(MI-SAN 121045447 ali enakovredno).	580236	2	KOM						
PREVLEKA ZA EKRAN TRAUMAT.OP BLOK- RTG ZA APARAT Y 9053 PROIZ. SIMMENS 5146886 , RTG V.(MI-SAN SBM ali enakovredno).	580210	770	KOM						

VREDNOST SKUPAJ:

6

25.226,40 €

0,00 €

ŽIG IN PODPIS:

SPECIFIKACIJA PONUDBE S CENAMI - za 1. obdobje

Predmet JN: **88 Medicinski potrošni material 2, 2016-2018**

CPV: 33196000

41 Sistemi za IVAC črpalke.-100% sk.

Naziv artikla	ident JN	Predv. količ.	EM	Cena brez DDV	DDV%	MDC z DDV	Cena z DDV	Vrednost z DDV	Proizvajalec
BRIZGALKA LL 50ML , ZA ALARIS INJEKTOMAT IVAC 700. (CAREFUSION 30602N ali enakovredno).	478580	49	KOM						
SISTEM ZA IVAC ČRPALKE;TIP- 591,597 IN 598.(CAREFUSION G59793 ali enakovredno).	402109	2.514	KOM						
SISTEM ZA IVAC ČRPALKE;TIP- 591,597 IN 598- ZATEMNJEN. (CAREFUSION G59643 ali enakovredno).	284556	211	KOM						
SISTEM ZA IVAC ČRPALKE;TIP- 591,597 IN 598.(CAREFUSION G59693 ali enakovredno).	426474	3.649	KOM						
SISTEM ZA IVAC ČRPALKE;TIP- 701,711 IN 770- ZATEMNJEN, VIDEN PRETOK (CAREFUSION G30453V ali enakovredno).	436135	1.540	KOM						
SISTEM ZA IVAC ČRPALKE;TIP- 701,711,770 IN P7000.(CAREFUSION G30402 ali enakovredno).	422363	10.622	KOM						
SISTEM INFUZIJSKI S 15 MIKRONSKIM FILTROM,APIROGEN,STERILEN, ZA IVAC ČRPALCO SE 2 GOLD, (CAREFUSION 72303 ali enakovredno).	528803	3.609	KOM						
SISTEM INFUZIJSKI-ONKOLOŠKI, ZA IVAC ČRPALCO "ALARIS GP".ZATEMNJEN, BREZ LATEKSA (CAREFUSION 60951E ali enakovredno).	830704	41	KOM						
SISTEM ZA ENOSTAVNE INFUZIJSKE ČRPALKE Z Y PORTOM (ZA GP). (CAREFUSION 60693E ali enakovredno).	749630	325	KOM						
SISTEM ZA ENOSTAVNE INFUZIJSKE ČRPALKE-NAVADNI (ZA GP). (CAREFUSION 60593 ali enakovredno).	749621	1.378	KOM						
SISTEM ZA PERFUZOR, NAVADNI, ZA APARAT ASENA GH. (CAREFUSION G40015 ali enakovredno).	749605	162	KOM						

VREDNOST SKUPAJ:**11****118.131,30 €****0,00 €****ŽIG IN PODPIS:**

SPECIFIKACIJA PONUDBE S CENAMI - za 1. obdobje

Predmet JN: **88 Medicinski potrošni material 2, 2016-2018**
42 Skalpel.-100% sk.

CPV: 33196000

Naziv artikla	ident JN	Predv. količ.	EM	Cena brez DDV	DDV%	MDC z DDV	Cena z DDV	Vrednost z DDV	Proizvajalec
SKALPELI ZA 1XUP FIG 10;DRŽALO UMETNA MASA,STERILEN,OVOJ MORA IMETI DOBRO VIDNO OZNAKO VELIKOSTI IN DATUM STERILNOSTI,DOBRO ODPIRANJE OVOJA V VSEH SLOJIH	143502	1.322	KOM						
SKALPELI ZA 1XUP FIG 11;DRŽALO UMETNA MASA,STERILEN,OVOJ MORA IMETI DOBRO VIDNO OZNAKO VELIKOSTI IN STERILNOSTI,DOBRO SE MORA ODPIRATI V VSEH SLOJIH	389773	2.140	KOM						
SKALPELI ZA 1XUP FIG 15;DRŽALO UMETNA MASA,STERILEN,OVOJ MORA IMETI DOBRO VIDNO OZNAKO VELIKOSTI IN STERILNOSTI.DOBRO SE MORA ODPIRATI V VSEH SLOJIH	389781	941	KOM						
SKALPELI ZA 1XUP FIG 20;DRŽALO UMETNA MASA,STERILEN,OVOJ MORA IMETI DOBRO VIDNO OZNAKO VELIKOSTI IN DATUM STERILNOSTI,DOBRO SE MORA ODPIRATI V VSEH SLOJIH	389790	333	KOM						
SKALPELI ZA 1XUP FIG 22;DRŽALO UMETNA MASA,STERILEN,OVOJ MORA IMETI DOBRO VIDNO OZNAKO VELIKOSTI IN STERILNOSTI,DOBRO SE MORA ODPIRATI V VSEH SLOJIH	389803	41	KOM						
SKALPELI- REZILA FIG.10,STAINLEESS STEEL,STERILNA.OVOJ MORA IMETI DOBRO VIDNO OZNAKO VELIKOSTI IN STERILNOSTI,DOBRO SE MORA ODPIRATI V VSEH SLOJIH	344621	13.865	KOM						
SKALPELI- REZILA FIG.11,STAINLEESS STEEL,STERILNA,OVOJ MORA IMETI DOBRO VIDNO OZNAKO VELIKOSTI IN STERILNOSTI,DOBRO SE MORA ODPIRATI V VSEH SLOJIH	381551	17.838	KOM						
SKALPELI- REZILA FIG.12,STAINLEESS STEEL,STERILNA,OVOJ MORA IMETI DOBRO VIDNO OZNAKO VELIKOSTI IN STERILNOSTI,DOBRO SE MORA ODPIRATI V VSEH SLOJIH	238481	1.540	KOM						
SKALPELI- REZILA FIG.15,STAINLESS STEEL,STERILNA, OVOJ MORA IMETI DOBRO VIDNO OZNAKO VELIKOSTI IN STERILNOSTI.DOBRO SE MORA ODPIRATI V VSEH SLOJIH	344613	16.865	KOM						
SKALPELI- REZILA FIG.20,STAINLESS STEEL,STERILNA,OVOJ MORA IMETI DOBRO VIDNO OZNAKO VELIKOSTI IN STERILNOSTI,DOBRO SE MORA ODPIRATI V VSEH SLOJIH	344605	12.648	KOM						
SKALPELI- REZILA FIG.22,STAINLESS STEEL,STERILNA,OVOJ MORA IMETI DOBRO VIDNO OZNAKO VELIKOSTI IN STERILNOSTI,DOBRO SE MORA ODPIRATI V VSEH SLOJIH	382434	1.217	KOM						

VREDNOST SKUPAJ:

11

4.893,11 €

0,00 €

ŽIG IN PODPIS:

SPECIFIKACIJA PONUDBE S CENAMI - za 1. obdobje

Predmet JN: **88 Medicinski potrošni material 2, 2016-2018**

CPV: 33196000

43 Zapestnice.-100% sk.

Naziv artikla	ident JN	Predv. količ.	EM	Cena brez DDV	DDV%	MDC z DDV	Cena z DDV	Vrednost z DDV	Proizvajalec
TRAK IDENTIFIKACIJSKI ZA UMRLE/EKOLOŠKI.Z DVE MA KARTONČKOMA,MATERIAL EKOLOŠKI PVC 460	484083	2.311	KOM						
TRAK ZA OZNAČEVANJE POSTELJE,MATERIAL EKOLOŠKI PVC	486663	1.217	KOM						
ZAPESTNICA BELA MALA ,MATERIAL: MEHEK PROZOREN EKOLOŠKI POLIURETAN.Z GUMBOM, KI MORA BITI SESTAVNI DEL ZAPESTNICE. Z VODOODPORNIM KARTONČKOM, ZA PODATKE PACIENTA.	329878	1.987	KOM						
ZAPESTNICA MODRA MALA,MATERIAL: MEHEK EKOLOŠKI POLIURETAN. Z GUMBOM, KI MORA BITI SESTAVNI DEL ZAPESTNICE. Z VODOODPORNIM KARTONČKOM, ZA PODATKE PACIENTA.	328472	3.040	KOM						
ZAPESTNICA MODRA VELIKA , MATERIAL EKOLOŠKI PVC.Z GUMBOM, KI MORA BITI SESTAVNI DEL ZAPESTNICE. Z VODOODPORNIM KARTONČKOM, ZA PODATKE PACIENTA.	328464	21.487	KOM						
ZAPESTNICA RDEČA VELIKA,MATERIAL EKOLOŠKI PVC.Z GUMBOM, KI MORA BITI SESTAVNI DEL ZAPESTNICE. Z VODOODPORNIM KARTONČKOM, ZA PODATKE PACIENTA.	329860	18.852	KOM						
ZAPESTNICA ZA NOVOROJENČKA IN MAMICO-V KOMPLETU. MATERIAL: MEHKI EKOLOŠKI PVC.	221473	1.865	PAR						

VREDNOST SKUPAJ:**7****24.434,88 €****0,00 €****ŽIG IN PODPIS:**

SPECIFIKACIJA PONUDBE S CENAMI - za 1. obdobje

Predmet JN: **88 Medicinski potrošni material 2, 2016-2018**

CPV: 33196000

44 Zbiralniki za ostre predmete.-100% sk.

Naziv artikla	ident JN	Predv. količ.	EM	Cena brez DDV	DDV%	MDC z DDV	Cena z DDV	Vrednost z DDV	Proizvajalec
ZBIRALNIK ZA OSTRE PREDMETE,VOLUMEN 1,5 L , POKROV ZA VARNOST ZAPIRANJE,MATERIAL: POLYPROPYLEN	342624	3.770	KOM						
ZBIRALNIK ZA OSTRE PREDMETE,VOLUMEN 3,5 L, POKROV ZA VARNOST ZAPIRANJE,MATERIAL-POLYPROPYLEN	342637	2.717	KOM						
ZBIRALNIK ZA OSTRE PREDMETE,VOLUMEN 5,5-6,0 L, POKROV ZA VARNOST ZAPIRANJE, MATERIAL: POLYPROPYLEN	329568	648	KOM						
ZBIRALNIK ZA OSTRE PREDMETE,VOLUMEN- 5 L ,OKROGLE OBLIKE,VIŠINA 42CM,ŠIRINA ODPRTINE 13,5CM,ŠIRINA DNA 11CM,VARNO ZAPIRANJE, MATERIAL.: POLYPROPYLEN	335070	486	KOM						
ZBIRALNIK ZA OSTRE PREDMETE,VOLUMEN: 0,5-0,6 L; POKROV ZA VARNOST ZAPIRANJE,MATERIAL: POLYPROPYLEN	385085	2.229	KOM						

VREDNOST SKUPAJ:

5

11.687,85 €

0,00 €

ŽIG IN PODPIS:

SPECIFIKACIJA PONUDBE S CENAMI - za 1. obdobje

Predmet JN: **88 Medicinski potrošni material 2, 2016-2018**

CPV: 33196000

50 ANESTEZIJA.Grelne blazine.100%sk.

Naziv artikla	ident JN	Predv. količ.	EM	Cena brez DDV	DDV%	MDC z DDV	Cena z DDV	Vrednost z DDV	Proizvajalec
BLAZINA GRELNA in za prep.preležanin,55 X200CM,prevlečena z netkano tkanino ki vpija tekočino,preh.za rtg žarke,s trakovi za pričv.na op.mizo,za priklop na aparat.(KANMED OT-600-222 ali enakovredno).	322806	648	KOM						
BLAZINA GRELNA in za prepr.preležanin,50 X 110CM,prevlečena z netkano tkanino ,ki vpija tekočino,prehodna za rtg žarke,s trakovi za pričv.na op.mizo,za priklop na apar.(KANMED OT-600-211 ali enakovred	328405	422	KOM						

VREDNOST SKUPAJ:

2

86.727,65 €

0,00 €

ŽIG IN PODPIS:

SPECIFIKACIJA PONUDBE S CENAMI - za 1. obdobje

Predmet JN: **88 Medicinski potrošni material 2, 2016-2018**

CPV: 33196000

51 ANESTEZIJA.Kartice,senzorji za hemodinam.mon.Lidco-100%sk.

Naziv artikla	ident JN	Predv. količ.	EM	Cena brez DDV	DDV%	MDC z DDV	Cena z DDV	Vrednost z DDV	Proizvajalec
LIDCO-RAPID STAND.KARTICA ZA UMERJANJE (LIDCO-LI10507 ALI ENAKOVREDNO)	808369	251	KOM						
LIDCO-SENSOR ZA LICL. (LIDCO CM-10 ALI ENAKOVREDNO).	694525	49	KOM						
LIDCO-SET ZA APLIKACIJO.(LIDCO CM50-044 ALI ENAKOVREDNO).	694533	37	KOM						

VREDNOST SKUPAJ:

3

81.081,57 €

0,00 €

ŽIG IN PODPIS:

PONUDBNIK: .

NAROČNIK UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER MARIBOR
Ljubljanska ulica 5, 2000 MARIBOR

Datum: 1.10.2015

Stran: 1

SPECIFIKACIJA PONUDBE S CENAMI - za 1. obdobje

Predmet JN: **88 Medicinski potrošni material 2, 2016-2018**

CPV: 33196000

52 ANESTEZIJA.Senzor za hemodinam.monitor Invos.100%sk.

Naziv artikla	ident JN	Predv. količ.	EM	Cena brez DDV	DDV%	MDC z DDV	Cena z DDV	Vrednost z DDV	Proizvajalec
---------------	----------	---------------	----	---------------	------	-----------	------------	----------------	--------------

SENZOR NIRS KOMPATIBILEN Z INVOS MONITORJEM (SOMANETICS
SAFB-SMX10 ALI ENAKOVREDNO)

VREDNOST SKUPAJ:

1

98.119,42 €

0,00 €

ŽIG IN PODPIS:

VZOREC OKVIRNEGA SPORAZUMA

sklenjen med:

UNIVERZITETNIM KLINIČNIM CENTROM MARIBOR, Ljubljanska ulica 5, 2000 Maribor, ki ga zastopa direktor prim. doc. dr. Gregor PIVEC, dr. med. (v nadaljevanju: naročnik), identifikacijska številka naročnika za DDV: SI56644817, matična številka naročnika: 5054150

in gospodarskim subjektom:

.....,
ki ga zastopa direktor
(v nadaljevanju: stranka sporazuma), identifikacijska številka stranke sporazuma za DDV:
....., matična številka stranke sporazuma:

I SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen

Ta okvirni sporazum (v nadaljevanju: sporazum) sklepajo naročnik in naslednji stranke okvirnega sporazuma:

1.
2.
3.
-
-
- N.

Naročnik in stranke tega sporazuma ugotavljajo, da je naročnik izvedel postopek oddaje javnega naročila za dobavo blaga »MEDICINSKI POTROŠNI MATERIAL 2«, objavljen na portalu javnih naročil, datum objave 26.10.2015, številka objave JN7526/2015 in v Uradnem listu EU, datum objave 30.10.2015, številka objave 2015/S 211-382425, po odprtem postopku v skladu s 25. členom Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 12/13, 19/14 in 90/14 - ZDU-1I; v nadaljevanju: ZJN-2) z namenom sklenitve okvirnega sporazuma v skladu s šestim odstavkom 32. člena ZJN-2.

2. člen

Naročnik in stranke sporazuma sklepajo ta sporazum za posamezne sklope blaga, opredeljene v Seznamu blaga s cenami (v nadaljevanju: Seznam).

Ponudba, št., z dne, Seznam iz tega člena in razpisna dokumentacija so sestavni del tega sporazuma.

Sestavni del tega sporazuma je tudi seznam podizvajalcev iz točke 1.5.2 Navodil ponudnikom za izdelavo ponudb.

3. člen

S tem sporazumom se naročnik in stranke okvirnega sporazuma dogovorijo o splošnih in posebnih pogojih izvajanja okvirnega sporazuma.

4. člen

Ta sporazum se sklepa za obdobje treh let, in sicer od 01.01.2016 do 31.12.2018.

II PREDMET SPORAZUMA

5. člen

Predmet tega sporazuma so stalne nabave blaga iz 2. člena tega sporazuma, ki jih naročnik po obsegu in času ne more vnaprej določiti.

Naročnik in stranke sporazuma se izrecno dogovorijo, da bo naročnik v času trajanja tega sporazuma v posameznem obdobju iz 6. člena tega sporazuma od najugodnejšega ponudnika (prodajalca) kupoval le tiste vrste in količine blaga, ki ga bo potreboval v tem obdobju. Naročnik se ne zavezuje posameznemu ponudniku oddati določene količine blaga.

III IZVAJANJE SPORAZUMA – PREDLOŽITEV PONUDB

6. člen

Naročnik je čas trajanja tega sporazuma iz 4. člena razdelil na naslednja obdobja:

- od 01.01.2016 do 31.12.2016 (prvo obdobje),
- od 01.01.2017 do 31.12.2017 (drugo obdobje),
- od 01.01.2018 do 31.12.2018 (tretje obdobje).

Naročnik bo določen čas pred začetkom vsakega obdobja iz predhodnega odstavka tega člena odpiral konkurenco med strankami tega sporazuma tako, da bo stranke sporazuma pozval k predložitvi ponudb za tiste skupine blaga, za katere je sklenjen sporazum. V posameznem obdobju bo naročnik med tistimi strankami tega sporazuma, ki bodo predložile ponudbe, izbral najugodnejšega ponudnika na podlagi meril iz razpisne dokumentacije.

Ponudbe bo treba predložiti v roku in na način, opredeljen v povabilu k predložitvi ponudb za posamezno obdobje.

Odpiranje ponudb za posamezno obdobje bo naročnik izvedel v kraju in času, določenem v povabilu k predložitvi ponudb. Odpiranja ponudb se bodo lahko udeležile le stranke tega sporazuma, ki bodo predložile ponudbo.

Naročnik bo tiste stranke sporazuma, ki bodo na podlagi povabila naročnika k predložitvi ponudb predložile ponudbo, pisno obvestil o svoji odločitvi o oddaji posameznega naročila na podlagi ponovnega odpiranja konkurence med sklenitelji okvirnega sporazuma.

Z najugodnejšim ponudnikom bo naročnik sklenil kupoprodajno pogodbo.

Naročnik bo ponovno odpiral konkurenco, za preostali čas do izteka veljavnosti obdobja, med ostalimi sklenitelji okvirnega sporazuma, v naslednjih primerih:

- če izbrani ponudnik ne bo želel skleniti pogodbe,
- če bo naročnik prekinil kupoprodajno pogodbo z izbranim ponudnikom,
- če bo izbrani ponudnik odstopil od pogodbe.

V primeru, da bo naročnik za posamezne skupine blaga sklenil sporazum s samo eno stranko sporazuma, naročnik ne bo odpiral konkurence za te skupine blaga. Te skupine blaga bodo v Seznamu ustrezno označene.

IV CENE

7. člen

Naročnik si pridržuje pravico, da bo v primeru, ko ugotovi, da je stranka sporazuma za blago, ki je predmet tega sporazuma, v času trajanja tega sporazuma znižala cene ali so jih znižali drugi ponudniki, ki ponujajo istovrstno blago ob drugih primerljivih pogojih, poskušal s stranko sporazuma dogovoriti ustrezno znižanje cene iz okvirnega sporazuma.

Cene za posamezne vrste blaga iz ponudbe so fiksne v času trajanja posamezne pogodbe, sklenjene za posamezno obdobje iz 6. člena tega sporazuma.

Cene za vrste blaga iz zadnjega odstavka 6. člena tega sporazuma so fiksne za več čas trajanja tega sporazuma. Sprememba cene je možna v skladu s 1. in 2. točko 6. člena Pravilnika o načinih valorizacije denarnih obveznosti, ki jih v večletnih pogodbah dogovarjajo pravne osebe javnega sektorja (Uradni list RS, št. 1/04), oz. po predpisu, ki ta pravilnik nadomešča. Stranki sporazuma kot podlago za valorizacijo uporabita indeks cen življenjskih potrebščin.

V ceni posameznega blaga so zajeti vsi stroški (carinski, špediterski, prevozni in drugi morebitni stroški), vsi popusti in rabati ter davek na dodano vrednost. Cene veljajo ddp skladišče naročnika, razloženo.

V primeru spremembe zakona, ki ureja davek na dodano vrednost, s katerim se spremeni davčna stopnja za vrste blaga iz ponudbe v času trajanja sporazuma, se lahko cene iz ponudbe korigirajo izključno v višini nastale davčne spremembe.

V NAROČANJE BLAGA IN DOBAVNI ROK

8. člen

Naročnik bo posamezne vrste blaga, ki jih bo potreboval v času trajanja sporazuma, kupoval od izbrane stranke sporazuma na podlagi izstavljenih pisnih naročilnic. Naročnik bo v naročilnici opredelil vrste in količine blaga.

Izbrani ponudnik se zavezuje, da bo blago dobavil najkasneje v roku petih (5) dni oz. v nujnih primerih v roku 24-ih ur po prejemu naročila ter da bo po vsakem posameznem naročilu dobavil celotno količino naročenega blaga.

Blago je treba dostaviti ddp Univerzitetni klinični center Maribor – razloženo v prostore skladišče naročnika.

Izbrani ponudnik se zavezuje, da bo na svoje stroške poskrbel za odvoz celotne embalaže, ki bo predmet dostave blaga.

VI PREVZEM BLAGA

9. člen

Naročnik se obvezuje prevzeti naročeno blago v celoti na podlagi dobavnice. Dobavnica mora biti napisana v slovenskem jeziku in mora obvezno vsebovati številko naročilnice.

Dobavljeno blago po dobavnici mora imeti enak naziv kot naročeno, enako enoto mere, enako kataloško številko in naveden ident naročnika.

Količinski prevzem blaga se opravi ob prevzemu, kakovostni pa v uzančnih rokih.

Stranka sporazuma se zavezuje, da bo pravočasno in sprotno seznanjal naročnika o spremembi kataloške številke obstoječega artikla.

VII KAKOVOST BLAGA

10. člen

Kakovost blaga mora ustrezati obstoječim standardom in deklarirani kakovosti na embalaži blaga.

VIII PLAČILNI POGOJI

11. člen

Naročnik bo skupno vrednost prejetega blaga plačal stranki sporazuma na transakcijski račun št. v roku 30 dni od datuma prejema pravilno izstavljenega računa po prevzemu blaga (datum zapadlosti računa).

Stranka sporazuma mora vse račune pošiljati naročniku izključno v elektronski obliki (e-račun), skladno z Zakonom o opravljanju plačilnih storitev za proračunske uporabnike (Uradni list RS, št. 59/10 in 111/13).

V primeru zamude s plačilom bo naročnik plačal zakonske zamudne obresti.

Naročnik bo izvršil neposredna plačila podizvajalcem, kot je opredeljeno v točki 1.5.2 Navodil ponudnikom za izdelavo ponudbe in v roku iz prvega odstavka tega člena.

IX SKRBNIK SPORAZUMA

12. člen

Skrbnik sporazuma za naročnika je:

Skrbnik sporazuma za sklenitelja sporazuma je:

X ZAVAROVANJE OBVEZNOSTI

13. člen

Stranka sporazuma bo morala ob podpisu kupoprodajne pogodbe in/oz. sporazuma kot instrument zavarovanja predložiti naročniku:

- menično izjavo in lastno podpisano menico s pooblastilom v višini 5% od vrednosti, kupoprodajne pogodbe oz. sporazuma če bo vrednost višja od 50.000,00 EUR brez DDV in nižja od 134.000,00 EUR brez DDV. Stranka sporazuma mora zagotoviti, da bo ves čas trajanja kupoprodajne pogodbe oz. sporazuma menica unovčljiva; oz.
- garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 5% od vrednosti kupoprodajne pogodbe oz. sporazuma, če bo vrednost enaka ali višja od 134.000,00 EUR brez DDV.

Veljavnost instrumentov iz predhodnih alinej tega člena mora biti še najmanj 10 dni od določenega obdobja veljavnosti kupoprodajne pogodbe oz. sporazuma.

V primeru vnovčitve menice oz. garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, bo morala stranka sporazuma vnovčeno menico oz. garancijo ustrezno nadomestiti z novo.

V primeru, da stranka sporazuma za unovčenje menice na računu nima dovolj sredstev, bo naročnik z njo prekinil kupoprodajno pogodbo oz. sporazum.

Naročnik bo menico oz. garancijo unovčil, če naročeno blago pri posamezni dobavi:

- ne bo odgovarjalo standardom in kvaliteti,
- ne bo prejel v roku in v količinah, opredeljenih v naročilnici,
- v primeru drugih kršitev tega sporazuma.

XI ODSTOP OD SPORAZUMA

14. člen

Naročnik bo vse pripombe v zvezi z izvrševanjem tega sporazuma sporočal strankam sporazuma v pisni obliki. Če stranke pri naslednjih dobavah ne upoštevajo upravičenih pripomb naročnika, lahko naročnik stranko izključi iz tega sporazuma. O izključitvi iz sporazuma naročnik pisno obvesti stranko.

Naročnik lahko odstopi od tega sporazuma, če stranka sporazuma:

- neutemeljeno zavrne naročilo,
- zamuja z izvedbo naročila,
- nekvalitetno izvaja naročilo.

15. člen

V primerih, ko naročnik nabavlja potrošni material za obstoječo opremo, se stranki sporazuma ob podpisu tega sporazuma sporazumeta, da se lahko ta sporazum prekine predčasno, v kolikor bi naročnik obstoječo opremo, na kateri se uporabljajo materiali, ki so predmet tega sporazuma, nadomestil z novo.

V takem primeru stranka sporazuma do naročnika ne bo uveljavljala kakršnihkoli zahtevkov zaradi predčasne prekinitve tega sporazuma in s tem posledično manjših dobavljenih količin od okvirnih.

XII KONČNE DOLOČBE

16. člen

Sporazum prične veljati z dnem podpisa stranke sporazuma in naročnika, ter ko stranka sporazuma izroči naročniku instrument zavarovanja iz 13. člena tega sporazuma.

17. člen

Pogoji tega sporazuma so veljavni za čas trajanja sporazuma.

Sporazum se lahko spremeni ali dopolni s pisnim aneksom, ki ga sprejmejo in podpišejo vse stranke sporazuma. Če katerakoli od določb sporazuma je ali postane neveljavna, to ne vpliva na ostale določbe sporazuma. Neveljavna določba se nadomesti z veljavno, ki mora čimbolj ustrezati namenu, ki ga je želela doseči neveljavna določba.

18. člen

V primeru, da se ugotovi, da je pri izvedbi javnega naročila, na podlagi katerega je podpisan ta sporazum ali pri izvajanju tega sporazuma kdo v imenu ali na račun druge stranke sporazuma, predstavniku ali posredniku naročnika ali drugega organa ali organizacije iz javnega sektorja obljubil, ponudil ali dal kakšno nedovoljeno korist za pridobitev tega posla ali za sklenitev tega posla pod ugodnejšimi pogoji ali za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je organu ali organizaciji iz javnega sektorja povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku organa, posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku, posredniku, je ta sporazum ničen.

19. člen

Morebitne spore iz tega sporazuma, ki jih stranke ne bi mogle rešiti sporazumno, rešuje stvarno pristojno sodišče v Mariboru.

20. člen

Sporazum je sestavljen v enakih izvodih, od katerih prejme vsaka stranka po en izvod.

Št.

V, dne

V Mariboru, dne

Stranka sporazuma:

.....

Naročnik:

UKC MARIBOR

Direktor:

.....

Direktor UKC:

prim. doc. dr. Gregor PIVEC, dr. med.

VZOREC KUPOPRODAJNE POGODBE

sklenjen med:

UNIVERZITETNIM KLINIČNIM CENTROM MARIBOR, Ljubljanska ulica 5, 2000 Maribor, ki ga zastopa direktor prim. doc. dr. Gregor PIVEC, dr. med. (v nadaljevanju: kupec), identifikacijska številka kupca za DDV: SI56644817, matična številka kupca: 5054150

in gospodarskim subjektom:

.....,
ki ga zastopa direktor
(v nadaljevanju: prodajalec), identifikacijska številka prodajalca za DDV:
matična številka prodajalca:

1. člen

Pogodbeni stranki uvodoma ugotavljata, da je med prodajalcem in kupcem sklenjen okvirni sporazum, št., z dne, za dobavo blaga iz javnega naročila »MEDICINSKI POTROŠNI MATERIAL 2«, objavljenega na portalu javnih naročil, datum objave 26.10.2015, številka objave JN7526/2015 in v Uradnem listu EU, datum objave 30.10.2015, številka objave 2015/S 211-382425.

2. člen

Kupec je s pisnim povabilom št., z dne (v nadaljevanju: povabilo), pozval prodajalca k predložitvi ponudbe za dobavo blaga, opredeljenega v povabilu.

Na podlagi prodajalčeve specifikacije ponudbe s cenami, št., z dne (v nadaljevanju: ponudba) ter na podlagi meril za izbiro ponudb, opredeljenih v razpisni dokumentaciji predmetnega naročila, je kupec izbral prodajalca za dobavo blaga iz skupin, opredeljenih v Seznamu blaga s cenami (v nadaljevanju: Seznam) za obdobje od do

Ponudba, Seznam in razpisna dokumentacija so sestavni del te kupoprodajne pogodbe (v nadaljevanju: pogodba).

Sestavni del te pogodbe je tudi seznam podizvajalcev, predložen v skladu s točko 1.5.2 Navodil ponudnikom za izdelavo ponudbe.

3. člen

Prodajalec in kupec se dogovorita, da bo kupec v obdobju, za katerega se sklepa ta pogodba, kupoval od prodajalca le tiste vrste in količine blaga iz Seznama, ki ga bo potreboval v tem obdobju, po cenah iz prodajalčeve ponudbe.

4. člen

Prodajalec bo kupcu dobavljal posamezne vrste blaga na podlagi pisnih naročilnic.

Kupec bo v naročilnici opredelil vrste in količine blaga.

Prodajalec se zavezuje, da bo blago dobavil najkasneje v roku petih (5) dni oz. v nujnih primerih v roku 24-ih ur po prejemu naročila ter da bo po vsakem posameznem naročilu dobavil celotno količino naročenega blaga.

Blago je treba dostaviti ddp Univerzitetni klinični center Maribor – razloženo v prostore skladišče kupca.

Prodajalec se zavezuje, da bo na svoje stroške poskrbel za odvoz celotne embalaže, ki je predmet dostave blaga.

5. člen

Kupec se obvezuje prevzeti naročeno blago v celoti na podlagi dobavnice. Dobavnica mora biti napisana v slovenskem jeziku in mora obvezno vsebovati številko naročilnice.

Dobavljeno blago po dobavnici mora imeti enak naziv kot naročeno, enako enoto mere, enako kataloško številko in naveden ident kupca.

Količinski prevzem blaga se opravi ob prevzemu, kakovostni pa v uzančnih rokih.

6. člen

Kakovost blaga mora ustrezati obstoječim standardom in deklarirani kakovosti na embalaži blaga.

7. člen

V času trajanja te pogodbe bo kupec od prodajalca kupoval posamezne vrste blaga po cenah iz ponudbe iz 2. člena te pogodbe.

Kupec si pridržuje pravico, da bo v primeru, ko ugotovi, da je prodajalec za blago, ki je predmet te pogodbe, v času trajanja te pogodbe znižal cene ali so jih znižali drugi ponudniki, ki ponujajo istovrstno blago ob drugih primerljivih pogojih, poskušal s prodajalcem dogovoriti ustrezno znižanje pogodbene cene.

V ceni posameznega blaga so zajeti vsi stroški (carinski, špediterski, prevozni in drugi morebitni stroški), vsi popusti in rabati ter davek na dodano vrednost. Cene veljajo ddp skladišče kupca, razloženo.

V primeru spremembe zakona, ki ureja davek na dodano vrednost, s katerim se spremeni davčna stopnja za vrste blaga iz prodajalčeve specifikacije ponudbe s cenami v času trajanja pogodbe, lahko prodajalec spremeni cene iz svoje ponudbe izključno v višini nastale davčne spremembe.

Skupna vrednost posameznih vrst blaga se izračuna tako, da se cena blaga pomnoži s številom dobavljenega blaga.

Skupna vrednost dobavljenega blaga se izračuna tako, da se seštejejo skupne vrednosti vsega dobavljenega blaga, izračunane na način iz predhodnega odstavka tega člena. Gene iz ponudbe so fiksne v času trajanja te pogodbe.

Gene iz ponudbe so fiksne v času trajanja te pogodbe.

8. člen

Kupec bo skupno vrednost prejetega blaga plačal prodajalcu na transakcijski račun št. v roku 30 dni od datuma prejema pravilno izstavljenega računa po prevzemu blaga (datum zapadlosti računa).

Prodajalec mora vse račune pošiljati kupcu izključno v elektronski obliki (e-račun), skladno z Zakonom o opravljanju plačilnih storitev za proračunske uporabnike (Uradni list RS, št. 59/10 in 111/13).

V primeru zamude s plačilom bo kupec plačal prodajalcu zakonske zamudne obresti.

Kupec bo izvršil neposredna plačila podizvajalcem, kot je opredeljeno v točki 1.5.2 Navodil ponudnikom za izdelavo ponudbe in v roku iz prvega odstavka tega člena.

9. člen

Prodajalec bo moral ob podpisu pogodbe kot instrument zavarovanja predložiti naročniku:

- menično izjavo in lastno podpisano menico s pooblastilom v višini 5% od vrednosti, pogodbe, če bo vrednost višja od 50.000,00 EUR brez DDV in nižja od 134.000,00 EUR brez DDV. Prodajalec mora zagotoviti, da bo ves čas trajanja pogodbe menica unovčljiva; oz.
- garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 5% od vrednosti pogodbe, če bo vrednost enaka ali višja od 134.000,00 EUR brez DDV.

Veljavnost instrumentov iz predhodnih alinej tega člena mora biti še najmanj 10 dni od določenega obdobja veljavnosti pogodbe.

V primeru vnovčitve menice oz. garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, bo moral prodajalec vnovčeno menico oz. garancijo ustrezno nadomestiti z novo.

V primeru, da prodajalec za unovčenje menice na računu nima dovolj sredstev, bo kupek z njim prekinil pogodbo.

Kupec bo menico oz. garancijo unovčil, če naročeno blago pri posamezni dobavi:

- ne bo odgovarjalo standardom in kvaliteti,
- ne bo prejel v roku in v količinah, opredeljenih v naročilnici,
- v primeru drugih kršitev te pogodbe.

10. člen

Ta pogodba se sklepa za obdobje od do in začne veljati z dnem podpisa obeh pogodbenih strank, in ko prodajalec kupcu predloži menico oz. garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti iz 9. člena te pogodbe.

11. člen

V primeru neizpolnjevanja obveznosti prodajalca po tej pogodbi, lahko kupec to pogodbo razdre.

12. člen

V primerih, ko kupec nabavlja potrošni material za obstoječo opremo, se pogodbeni stranki ob podpisu te pogodbe sporazumeta, da se lahko ta pogodba prekine predčasno, v kolikor bi kupec obstoječo opremo, na kateri se uporabljajo materiali, ki so predmet te pogodbe, nadomestil z novo.

V takem primeru prodajalec do naročnika ne bo uveljavljala kakršnihkoli zahtevkov zaradi predčasne prekinitve te pogodbe in s tem posledično manjših dobavljenih količin od okvirnih.

13. člen

V primeru, da se ugotovi, da je pri izvedbi javnega naročila, na podlagi katerega je podpisana ta pogodba ali pri izvajanju te pogodbe kdo v imenu ali na račun prodajalca, predstavnika ali posredniku kupca ali drugega organa ali organizacije iz javnega sektorja obljubil, ponudil ali dal kakšno nedovoljeno korist za pridobitev tega posla ali za sklenitev tega posla pod ugodnejšimi pogoji ali za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je organu ali organizaciji iz javnega sektorja povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku organa, posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku, posredniku, je ta pogodba nična.

14. člen

Morebitne spore iz te pogodbe, ki jih pogodbeni stranki ne bi mogli rešiti sporazumno, rešuje stvarno pristojno sodišče v Mariboru.

15. člen

Pogodba je napisana v dveh enakih izvodih, od katerih prejme vsaka od pogodbenih strank po en izvod.

Št.

V, dne

V Mariboru, dne

Prodajalec:

.....

Kupec:

UKC MARIBOR

Direktor:

.....

Direktor UKC:

prim. doc. dr. Gregor PIVEC, dr. med.

PONUDNIK

.....

.....

.....

IZJAVA O IZPOLNJEVANJU POGOJEV

S to izjavo se dokazuje izpolnjevanje tistih pogojev iz točke 2.12 Navodil ponudnikom za izdelavo ponudbe, za katere je naročnik pri posameznem pogoju navedel, da zadostuje predložitev te izjave, t.j. OBR-8.

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da:

1. kot ponudnik ali naš zakoniti zastopnik, v kolikor gre za pravno osebo, nismo bili ali naš zakoniti zastopnik pravnomočno obsojeni zaradi naslednjih kaznivih dejanj, ki so opredeljena v Kazenskem zakoniku (Uradni list RS, št. 50/12 – uradno prečiščeno besedilo; v nadaljnjem besedilu: KZ-1):
 - sprejemanje podkupnine pri volitvah (157. člen KZ-1),
 - goljufija (211. člen KZ-1),
 - protipravno omejevanje konkurence (225. člen KZ-1),
 - povzročitev stečaja z goljufijo ali nevestnim poslovanjem (226. člen KZ-1),
 - oškodovanje upnikov (227. člen KZ-1),
 - poslovna goljufija (228. člen KZ-1),
 - goljufija na škodo Evropske unije (229. člen KZ-1),
 - preslepitev pri pridobitvi in uporabi posojila ali ugodnosti (230. člen KZ-1),
 - preslepitev pri poslovanju z vrednostnimi papirji (231. člen KZ-1),
 - preslepitev kupcev (232. člen KZ-1),
 - neupravičena uporaba tuje oznake ali modela (233. člen KZ-1),
 - neupravičena uporaba tujega izuma ali topografije (234. člen KZ-1),
 - ponaređitev ali uničenje poslovnih listin (235. člen KZ-1),
 - izdaja in neupravičena pridobitev poslovne skrivnosti (236. člen KZ-1),
 - zloraba informacijskega sistema (237. člen KZ-1),
 - zloraba notranje informacije (238. člen KZ-1),
 - zloraba trga finančnih instrumentov (239. člen KZ-1),
 - zloraba položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti (240. člen KZ-1),
 - nedovoljeno sprejemanje daril (241. člen KZ-1),
 - nedovoljeno dajanje daril (242. člen KZ-1),
 - ponaređanje denarja (243. člen KZ-1),
 - ponaređanje in uporaba ponaređenih vrednotnic ali vrednostnih papirjev (244. člen KZ-1),
 - pranje denarja (245. člen KZ-1),
 - zloraba negotovinskega plačilnega sredstva (246. člen KZ-1),
 - uporaba ponaređenega negotovinskega plačilnega sredstva (247. člen KZ-1),
 - izdelava, pridobitev in odtujitev pripomočkov za ponaređanje (248. člen KZ-1),
 - davčna zatajitev (249. člen KZ-1),
 - tihotapstvo (250. člen KZ-1),
 - izdaja tajnih podatkov (260. člen KZ-1),
 - jemanje podkupnine (261. člen KZ-1),
 - dajanje podkupnine (262. člen KZ-1),

- sprejemanje koristi za nezakonito posredovanje (263. člen KZ-1),
 - dajanje daril za nezakonito posredovanje (264. člen KZ-1),
 - hudodelsko združevanje (294. člen KZ-1);
2. na dan, ko poteče rok za oddajo ponudb, nismo bili izločeni iz postopkov oddaje javnih naročil zaradi uvrstitve v evidenco ponudnikov z negativnimi referencami iz 77.a člena ZJN-2, 81.a člena ZJNVETPS oziroma 73. člena ZJNPOV;
 3. na dan, ko je bila oddana ponudba, v skladu s predpisi države, v kateri imamo sedež, ali predpisi države naročnika, nimamo zapadle, neplačane obveznosti v zvezi s plačili prispevkov za socialno varnost ali v zvezi s plačili davkov v vrednosti 50 eurov ali več;
 4. nismo v postopku prisilne poravnave ali ni bil za nas podan predlog za začetek postopka prisilne poravnave in sodišče o tem predlogu še ni odločilo;
 5. nismo v stečajnem postopku ali ni bil za nas podan predlog za začetek stečajnega postopka in sodišče o tem predlogu še ni odločilo;
 6. nismo v postopku prisilnega prenehanja, ali ni bil za nas podan predlog za začetek postopka prisilnega prenehanja in sodišče o tem predlogu še ni odločilo, z našimi posli iz drugih razlogov upravlja sodišče ali smo opustili poslovno dejavnost ali smo v katerem koli podobnem položaju;
 7. smo registrirani pri pristojnem sodišču ali drugemu organu; **Opomba!**
 8. smo vpisani na Seznam imetnikov dovoljenja za opravljanje dejavnosti prometa na debelo pri Javni agenciji RS za zdravila in medicinske pripomočke;
 9. zagotavljamo razpisane vrste in količine blaga za katere oddajamo ponudbo.
 10. imajo vse ponujene vrste blaga CE oznako, ki jo bomo na zahtevo naročnika dokazali s predložitvijo ustreznih dokumentov.

Opomba k točki 7:

Ustrezno izpolnite:

V sodnem registru smo vpisani pod vložno številko oz. pod številko vpisa pri Davčnem uradu, številka

Ta izjava je sestavni del ponudbe, s katero se prijavljamo za javno naročilo za dobavo medicinskega potrošnega materiala 2.

Javno naročilo je bilo objavljeno na portalu javnih naročil, datum objave 26.10.2015, številka objave JN7526/2015 in v Uradnem listu EU, datum objave 30.10.2015, številka objave 2015/S 211-382425.

Dne:

Žig in podpis ponudnika:

.....

PODIZVAJALEC

.....

IZJAVA O IZPOLNJEVANJU POGOJEV PODIZVAJALCEV

S to izjavo se dokazuje izpolnjevanje tistih pogojev iz točke 2.12 Navodil ponudnikom za izdelavo ponudbe, za katere je naročnik pri posameznem pogoju navedel, da zadostuje predložitev te izjave, t.j. OBR-8.1.

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da:

- na dan ko je bila oddana ponudba v skladu s predpisi države, v kateri imamo sedež, ali predpisi države naročnika nimamo zapadlih, neplačanih obveznosti v zvezi s plačili prispevkov za socialno varnost ali v zvezi s plačili davkov v vrednosti 50 eurov ali več.

Ta izjava je sestavni del ponudbe, s katero se kot podizvajalec ponudnika

prijavljamo za javno naročilo za dobavo medicinskega potrošnega materiala 2.

Javno naročilo je bilo objavljeno na portalu javnih naročil, datum objave 26.10.2015, številka objave JN7526/2015 in v Uradnem listu EU, datum objave 30.10.2015, številka objave 2015/S 211-382425.

Dne:

Žig in podpis podizvajalca:

.....

SOGLASJE ZA PRIDOBITEV OSEBNIH PODATKOV

1. Podatki o ponudniku:

Naziv ponudnika:

Ulica:

Poštna številka in kraj:

ID za DDV: Matična številka:

2. Podatki o zakonitih zastopnikih¹:

2.1 Zakoniti zastopnik:

Ulica:

(naslov stalnega prebivališča)

Poštna številka in kraj:

Matična številka (EMŠO):

2.2 Zakoniti zastopnik:

Ulica:

(naslov stalnega prebivališča)

Poštna številka in kraj:

Matična številka (EMŠO):

Univerzitetnemu kliničnemu centru Maribor, Ljubljanska ulica 5, 2000 Maribor, kot naročniku, dajemo soglasje skladno s šestim odstavkom 41. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 12/13, 19/14 in 90/14 - ZDU-1I, v nadaljevanju ZJN-2), da za potrebe javnega naročila za dobavo medicinskega potrošnega materiala 2, objavljenega na portalu javnih naročil, datum objave 26.10.2015, številka objave JN7526/2015 in v Uradnem listu EU, datum objave 30.10.2015, številka objave 2015/S 211-382425, pridobi naslednje podatke:

- od ministrstva, pristojnega za pravosodje, da kot ponudnik nismo bili, niti naši zakoniti zastopniki, pravnomočno obsojeni zaradi kaznivih dejanj, opredeljenih v prvem odstavku 42. člena ZJN-2,
- od sodišča potrdilo, da nismo v postopku prisilne poravnave, ali ni bil za nas podan predlog za začetek postopka prisilne poravnave in sodišče o tem predlogu še ni odločilo,
- od sodišča potrdilo, da nismo v stečajnem postopku ali ni bil za nas podan predlog za začetek stečajnega postopka in sodišče o tem predlogu še ni odločilo,
- od sodišča potrdilo, da nismo v postopku prisilnega prenehanja, ali ni bil za nas podan predlog za začetek postopka prisilnega prenehanja in sodišče o tem predlogu še ni odločilo, z našimi posli iz drugih razlogov upravlja sodišče ali smo opustili poslovno dejavnost ali smo v katerem koli podobnem položaju.

1. Žig:

(podpis zakonitega zastopnika)

¹ V primeru, da ima ponudnik več zastopnikov, kot jih predvideva ta obrazec, je treba na lastnem obrazcu vpisati podatke o vseh zastopnikih.

2. Kraj in datum:
(podpis zakonitega zastopnika)

Ta izjava je sestavni del ponudbe, s katero se prijavljamo za javno naročilo za dobavo medicinskega potrošnega materiala 2.

Javno naročilo je bilo objavljeno na portalu javnih naročil, datum objave, številka objave in v Uradnem listu EU, datum objave, številka objave

GARANCIJA ZA RESNOST PONUDBE

Naziv banke/zavarovalnice:

Kraj in datum:

Upravičenec:

Garancija št.:

V skladu z javnim naročilom, objavljenim na portalu javnih naročil, datum objave 26.10.2015, številka objave JN7526/2015 in v Uradnem listu EU, datum objave 30.10.2015, številka objave 2015/S 211-382425, za dobavo blaga »**MEDICINSKI POTROŠNI MATERIAL 2**« za potrebe naročnika Univerzitetni klinični center Maribor (t.j. upravičenca te garancije), je ponudnik (naročnik garancije) dolžan za resnost svoje ponudbe na javnem naročilu, priskrbeti upravičencu garancijo v višini 4.000,00 EUR.

Banka/zavarovalnica se zavezuje, da bo plačala navedeni znesek v naslednjih primerih:

- če ponudnik umakne ali spremeni ponudbo v času njene veljavnosti;
- če ponudnik v zahtevanem času ne podpiše okvirnega sporazuma oz./in pogodbe;
- če ponudnik v zahtevanem času ne predloži menične izjave z menico oz. garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

Zavezujemo se, da bomo v 15 dneh po prejemu naročnikovega prvega pisnega zahtevka plačali naročniku zgoraj navedeni znesek brez kakršnega koli dodatnega utemeljevanja, če v svojem zahtevku navede, da mu zahtevani znesek pripada zaradi izpolnitve enega ali vseh zgoraj navedenih primerov in navede, za kateri primer ali primera gre.

Ta garancija se znižuje za vsak, po tej garanciji unovčeni znesek.

Ta garancija velja vse dotlej, dokler izbrani ponudnik ne sklene okvirnega sporazuma oz./in pogodbe z naročnikom in mu ne izroči garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, vendar pa najkasneje do dd.mm.2016.

Če od vas ne prejmemo nikakršnega zahtevka za izplačilo garantiranega zneska do dd.mm.2016, ta garancija preneha veljati ne glede na to, ali nam je vrnjena.

Ta garancija ni prenosljiva.

Morebitne spore med upravičencem in banko/zavarovalnico rešuje stvarno pristojno sodišče v Mariboru.

Banka/zavarovalnica
(žig in podpis)